

Navodila za uporabo

Volista

Avtorske pravice

Vse pravice pridržane. Prepovedano je kopiranje, spreminjanje ali prevajanje teh navodil, ne da bi za to pridobili predhodno pisno dovoljenje, če ni drugače določeno z zakonom o avtorski pravicah.

© Copyright 2023

Maquet SAS

Pravica do tehničnih sprememb pridržana

Če izdelek pozneje nadgradimo ali dopolnimo, se lahko slike in tehnični podatki, uporabljeni v teh navodilih, razlikujejo od dejanskega stanja naprave.

V20 16.04.2024



Kazalo

1	Uvod	7
1.1	Uvod	7
1.2	Odgovornost	7
1.3	Drugi dokumenti, povezani s tem izdelkom	7
1.4	Podatki o dokumentu	8
1.4.1	Okrajšave	8
1.4.2	Simboli, uporabljeni v dokumentu	8
1.4.2.1	Sklicevanje	8
1.4.2.2	Številčne oznaake	8
1.4.2.3	Ravnanje in rezultati	8
1.4.2.4	Meniji in gumbi	9
1.4.2.5	Ravni nevarnosti.....	9
1.4.2.6	Navedbe	9
1.4.3	Definicije	9
1.4.3.1	Skupine oseb.....	9
1.4.3.2	Vrste svetilk	10
1.5	Simboli na izdelku in embalaži	10
1.6	Pregled izdelka	11
1.6.1	Sestavni deli.....	13
1.6.1.1	Kupole	13
1.6.1.2	Nosilec zaslona, vgrajen v pripomoček	16
1.6.1.3	Nosilec kamere, vgrajen v pripomoček	17
1.6.2	Možnosti.....	18
1.6.2.1	Stenska nadzorna plošča	18
1.6.2.2	Spremenljiva barvna temperatura	19
1.6.2.3	Volista VisioNIR (samo na VSTII)	20
1.6.2.4	Dodatne možnosti za FHS0/MHS0	21
1.6.2.5	Možnosti za XHS0.....	22
1.6.2.6	Možnost za XHD1	23
1.6.2.7	Možnosti za podporo kamere	24
1.6.3	Dodatna oprema	25
1.6.3.1	Kamere	25
1.6.3.2	Nosilec za ročico	26
1.6.3.3	LMD* (samo na Volista VSTII)	27
1.6.3.4	Svinčene plošče	28
1.7	Etiketa s podatki o pripomočku.....	29
1.8	Pomembni standardi.....	30
1.9	Informacije o predvideni uporabi	33
1.9.1	Predvidena uporaba.....	33
1.9.2	Navedbe.....	33
1.9.3	Predvideni uporabniki	33
1.9.4	Neustrezna uporaba	33
1.9.5	Kontraindikacije.....	33
1.10	Osnovno delovanje	33



1.11 Klinične koristi.....	33
1.12 Garancija	34
1.13 Življenska doba izdelka.....	34
1.14 Navodila o tem, kako zmanjšati vpliv na okolje	34
2 Informacije, povezane z varnostjo.....	36
2.1 Okoljski pogoji	36
2.2 Varnostna navodila	36
2.2.1 Varna uporaba izdelka.....	36
2.2.2 Elektrika	37
2.2.3 Optika.....	37
2.2.4 Okužba.....	37
3 Kontrolni vmesnik.....	38
3.1 Upravljalne tipkovnice kupole	39
3.2 Stenska upravljalna tipkovnica (samo za VCSII).....	40
3.3 Zaslolu na dotik	41
4 Uporaba.....	44
4.1 Dnevni pregledi.....	44
4.2 Upravljati svetilke.....	49
4.2.1 Vključiti/izklučiti svetilke	49
4.2.1.1 Na tipkovnici nadzorne plošče na kupoli ali steni.....	49
4.2.1.2 Z zaslona na dotik	51
4.2.2 Nastaviti svetilke	52
4.2.2.1 Na tipkovnici nadzorne plošče na kupoli ali steni.....	52
4.2.2.2 Z zaslona na dotik	53
4.2.3 Ambientalne svetilke	54
4.2.3.1 Na tipkovnici nadzorne plošče na kupoli ali steni.....	54
4.2.3.2 Z zaslona na dotik	55
4.2.4 AIM (samo na Volista VSTII).....	56
4.2.5 Volista VisioNIR* (samo na Volista VSTII).....	57
4.2.6 Sinhronizacija kupol	58
4.2.6.1 S tipkovnico stenske nadzorne plošče	58
4.2.6.2 Z zaslona na dotik	59
4.2.7 LMD (samo na Volista VSTII z zaslonom na dotik).....	60
4.2.8 Zaznamki (samo z zaslonom na dotik)	61
4.2.8.1 Izbrati/shraniti med zaznamke.....	61
4.2.8.2 Tovarniške prednastavite	63
4.3 Postaviti svetilko	63
4.3.1 Montaža sterilizabilne ročice	63
4.3.1.1 Namestite in odstranite sterilizabilno ročico STG PSX 01.....	64
4.3.1.2 Namestite in odstranite sterilizabilno ročico STG HLX 01.....	65
4.3.1.3 Namestiti in odstraniti ročico tipa DEVON®/DEROYAL®**	66
4.3.1.4 Namestiti in odstraniti sterilizabilno ročico STG PSX 01	67
4.3.2 Nastaviti kupolo.....	68
4.3.3 Primeri prestavljanja	71



4.4	Montirati/demontirati sistem za hitro zaklepanje „Quick Lock“ naprave (kamera ali nosilec za ročice)	73
4.4.1	Najprej določite položaj naprave.....	73
4.4.1.1	Na kamери „Quick Lock“.....	73
4.4.1.2	Na kupoli	74
4.4.2	Montaža naprave na kupolu.....	74
4.4.3	Demontaža naprave.....	75
4.4.4	Nosilec za ročico na „Quick Lock“.....	76
4.5	Uporabljati kamero	77
4.5.1	Brezžični videosistem	77
4.5.1.1	Uparjenje kamere	77
4.5.1.2	Zagon uparjenega sistema.....	78
4.5.2	Upravljanje kamero	78
4.5.2.1	S tipkovnico kupole ali stenske nadzorne plošče (samo zum).....	78
4.5.2.2	Z zaslona na dotik	79
4.5.3	Usmeriti kamero.....	82
4.6	Določiti položaj nosilca zaslona	82
4.6.1	Uporabite in namestite podporo zaslona	82
4.6.2	Primeri preddoločitve položaja nosilcev zaslonov.....	85
4.7	Določiti položaj nosilca kamere	86
4.7.1	Namestite kamero na podporo kamere SC.....	86
4.7.2	Uporaba podpore kamere	86
4.8	Nastavite in funkcije	88
4.8.1	Svetlost zaslona.....	89
4.8.2	Datum, ura in funkcije kronometra/merilnika časa	90
4.8.3	Funkcija kronometer/merilnik časa (samo na zaslolu na dotik)	91
4.8.3.1	Kronometer.....	92
4.8.3.2	Merilnik časa	93
4.8.4	Ročica TILT.....	94
4.8.5	Informacije	95
4.9	Pomožne baterije.....	96
4.9.1	Svetlobni indikatorji	96
4.9.2	Opravite teste baterij.....	97
4.9.2.1	Preko stenske upravljalne tipkovnice (samo na VCSII).....	97
4.9.2.2	Z zaslona na dotik	98
5	Okvare in nepravilnosti v delovanju.....	99
5.1	Alarmne signalne svetilke	99
5.1.1	Signalne svetilke so na tipkovnici kupole in na stenski tipkovnici	99
5.1.2	Signalne oznake na zaslolu na dotik	99
5.2	Možne okvare in nepravilnosti	100
6	Čiščenje/razkuževanje/steriliziranje	102
6.1	Čiščenje in razkuževanje sistema	102
6.1.1	Čiščenje naprave	102
6.1.2	Razkuževanje naprave	103
6.1.2.1	Razkužila, ki jih lahko uporabite	103
6.1.2.2	Dovoljene aktivne snovi.....	103



6.2	Čiščenje in steriliziranje ročic Maquet Sterigrip	104
6.2.1	Priprava za čiščenje	104
6.2.2	Ročno čiščenje	104
6.2.3	Čiščenje v pralno razkuževalni napravi	104
6.2.4	Sterilizacija ročic Maquet Sterigrip	105
7	Vzdrževanje	106
8	Tehnične lastnosti	107
8.1	Optične lastnosti kopol VSTII	107
8.2	Optične lastnosti kopol VCSII	109
8.3	Električne lastnosti	110
8.3.1	Električne lastnosti VSTII	110
8.3.2	Električne lastnosti VCSII	111
8.4	Mehanske lastnosti	112
8.4.1	Svetilke	112
8.4.2	Moč	112
8.4.3	Podpora zaslona(-ov)	113
8.4.4	Mehanska združljivost	113
8.5	Videolastnosti	114
8.5.1	Tehnične lastnosti kamer in sprejemnikov	114
8.6	Druge lastnosti	115
8.7	Izjava o elektromagnetni združljivosti	116
8.7.1	FCC DEL 15 (le za ZDA)	117
9	Ravnanje z odpadki	118
9.1	Odlaganje embalaže	118
9.2	Izdelek	118
9.3	Električni in elektronski sestavni deli	118

1 Uvod

1.1 Uvod

V zdravstveni ustanovi ste se odločili za inovativno medicinsko tehnologijo Getinge. Hvala za vaše zaupanje.

Getinge je vodilni svetovni proizvajalec medicinske opreme za operacijske dvorane, hibridne operacijske dvorane, prostore za indukcijsko in intenzivno zdravljenje ter prenestitve in prevažanje pacientov. Getinge v razvojnem procesu na prvem mestu preuči in nato sledi potrebam zdravstvenega osebja in pacientov. Getinge zagotavlja varne, učinkovite in ekonomične rešitve za odpravo omejitev v zdravstvenih ustanovah.

Poslanstvo Getinge je zadovoljiti potrebe pacientov in zdravstvenega osebja, zato s svojimi strokovnimi izkušnjami in znanjem o operacijskih svetilkah, stropnih stativih in večpredstavnostnih rešitvah razvija kakovostno in inovativno dejavnost. Operacijske svetilke Getinge so vsesvetovno prepozname po svoji obliki in inovativnosti.

1.2 Odgovornost

Spremembe na izdelku

Narediti ni dovoljeno nobene spremembe, ne da bi predhodno za to pridobili dovoljenje Getinge.

Skladna uporaba opreme

Družba Getinge ni odgovorna za škodo, neposredno ali posredno, nastalo zaradi opravil in dejanj, ki niso skladna z navodili za uporabo.

Montaža in vzdrževanje

Montažo, vzdrževanje in demontaže lahko opravijo samo strokovno usposobljeni delavci, ki imajo za to dovoljenje družbe Getinge.

Usposabljanje za uporabo opreme

Usposabljanje izvede neposredno na opremi delavec, ki ima za to dovoljenje družbe Getinge.

Združljivost z drugimi medicinskimi pripomočki

Namestite samo na medicinske pripomočke, za katere je bila izdana homologacija v skladu s standardom IEC 60601-1 ali UL 60601-1.

Podatki o združljivosti so v poglavju Tehnične lastnosti [► Stran 107].

V tem poglavju je pregled opreme, ki je združljiva s pripomočkom.

V primeru neželenega dogodka

O vseh resnih neželenih dogodkih, povezanih s pripomočkom, obvestite proizvajalca in pristojni organ v državi članici, v katerih je uporabnik in/ali pacient.

1.3 Drugi dokumenti, povezani s tem izdelkom

- Priporočila za montažo Volista (ref. ARD01786)
- Navodilo za montažo Volista (ref. ARD01784)
- Navodilo za vzdrževanje Volista (ref. ARD01780)
- Navodilo za popravilo Volista (ref. ARD01782)
- Navodilo za demontažo Volista (ref. ARD01785)

1.4

Podatki o dokumentu

Ta priročnik o uporabi je pripravljen za uporabnike izdelka, nadzornike in administrativne delavce v bolnišnici. Namen priročnika je seznaniti uporabnike o zasnovi, varnosti in delovanju izdelka. Vsebina priročnika je razdeljena v več poglavij.

Pomnite:

- Pred prvo uporabo izdelka natančno preberite cela navodila za uporabo.
- Obvezno in dosledno ravnajte in upoštevajte navodila za uporabo.
- Ta dokument hranite v bližini opreme.

1.4.1

Okrajšave

AIM	Avtomatsko upravljanje osvetljenosti (Automatic Illumination Management)
CEM	Elektromagneta združljivost
DF	Dvojne vilice (Double Fork)
FSP*	Program stabilnosti pretoka (Flux Stability Program)
HD	Visoka ločljivost (High Definition)
IFU	Navodilo za uporabo (Instruction For Use)
IP	Stopnja zaščite (Indice Protection)
LED	Svetleče dioda (Light Emitting Diode)
LMD	Luminance Management Device (Naprava za upravljanje svetilnosti)
NIR	Bližnja infrardeča (Near InfraRed)
SF	Enojne vilice (Single Fork)
VCSII	Volista Access II
VSTII	Volista StandOP II
WB	Ravnovesje beline (White Balance)

1.4.2

Simboli, uporabljeni v dokumentu

1.4.2.1

Sklicevanje

Sklic na posamezne strani v priročniku označuje simbol »►«.

1.4.2.2

Številčne oznaake

Številčne oznaake na slikovnih prikazih in v besedilih so v okvirčku 1.

1.4.2.3

Ravnanje in rezultati

Ravnanje uporabnika je določeno s številčnim vrstnim redom posameznih dejanj; simbol »➤« označuje rezultat ukrepa.

Primer:

Predpogoji:

- Ročica, ki se lahko sterilizira, je združljiva z izdelkom.

1. Namestite ročico na podporo.
➤ Zasliši se klik.
2. Zavrtite ročico, tako da zaslišite drugi klik, ko se ročica zaskoči.

1.4.2.4 Meniji in gumbi

Imena menijev in gumbov so **siva**.

Primer:

1. Pritisnite na gumb **Shrani**.

➤ Spremembe so shranjene in na zaslonu se odpre menu **Priljubljene**.

1.4.2.5 Ravni nevarnosti

V varnostnih navodilih je opis posamezne nevarnosti in predlagan ukrep za zaščito. Varnostna navodila so prednostno razvrščena v tri ravni:

Simbol	Stopnja nevarnosti	Pomen
	NEVARNOST!	Označuje verjetna smrtna nevarnost ali nevarnost resnih telesnih poškodb, ki lahko vodijo v smrt.
	OPOZORILO!	Označuje verjetno nevarnost telesne poškodbe, zdravstveno tveganje ali večje škode na opremi, ki nadalje pomeni nevarnost za telesne poškodbe.
	POZOR!	Označuje verjetno nevarnost škode na opremi.

Tab. 1: ravni nevarnosti v varnostnih navodilih

1.4.2.6 Navedbe

Simbol	Narava navedbe	Pomen
	NAPOTEK	Dodatna pomoč ali uporabne informacije, ki ne zajemajo nevarnost telesnih poškodb ali škode na opremi.
	OKOLJE	Podatki in informacije o reciklirjanju in ustreznom odlaganju odpadkov

Tab. 2: Vrste navedb v dokumentu

1.4.3 Definicije

1.4.3.1 Skupine oseb

Uporabniki

- Uporabniki so osebe z dovoljenjem za uporabo opreme, ki so ga pridobile na podlagi svoje strokovne usposobljenosti ali opravljenega usposabljanja pri pooblaščeni osebi.
- Uporabniki so odgovorni za varnost uporabe opreme ter za spoštovanje namena uporabe.

Usposobljeno osebje:

- Usposobljeno osebje so osebe, ki so pridobile ustrezena znanja in spretnosti s specializiranim usposabljanje na področju medicinske tehnologije ali osebe z zadostnimi strokovnimi izkušnjami in znanjem o varnostnih predpisih, ki veljajo za izbrano nalogu.
- V državah, v katerih je medicinsko-tehnična dejavnost predmet certificiranja, je treba pridobiti potrdilo o strokovni usposobljenosti osebja.

1.4.3.2 Vrste svetilk**Manjše operacijske svetilke**

Enojna svetilka v okolju pacienta v operacijski dvorani, ki omogoča, ob morebitni odpovedi svetilk, prekinitve operacije za zdravljenje in diagnosticiranje, ne da bi nastala nevarnost za pacienta.

Sistem operacijskih svetilk

Kombinacija več operacijskih svetilk za pomoč pri operaciji za zdravljenje in diagnosticiranje v operacijskih dvoranah. Sistem operacijskih svetilk mora biti varen pred izpadom in zagotoviti ustrezeno osvetljenost patientovega telesa, tudi ob prvi odpovedi.

Primer: kombinacija dveh ali več operacijskih svetilk tvori sistem operacijskih svetilk.

Asortiment Volista*

Od najmanj invazivnih do rutinskih postopkov, Volita Getinge je popoln in inovativen assortiment kupol. Ta assortiment gradi na dveh modelih:


- Serija VCSII Volista (Volista Access 2. generacija)
- Serija VCSII Volista (Volista StandOP 2. generacija)

1.5 Simboli na izdelku in embalaži

	Upoštevati navodila za uporabo (IEC 60601-1:2012)		Znamka medicinskih pripomočkov (MD)
	Upoštevati navodila za uporabo (IEC 60601-1:2005)		Edinstveni identifikator pripomočka
	Upoštevati navodila za uporabo (IEC 60601-1:1996)		Oznaka CE (Evropa)
	Proizvajalec + datum proizvodnje		Označke UL (Kanada in ZDA)
	Ref. označka proizvoda		Označke UR (Kanada in ZDA)
	Serijska št. proizvoda		Smer za ovojnino
	Vhod AC		Lomljivo; rokovati previdno
	Vhod DC		Umakniti z dežja


	Izhod		Temperatura za skladiščenje
	V pripravljenosti		Vlažnost za skladiščenje
	Ne zavreči med običajne odpadke		Zračni tlak za skladiščenje
	Nevarnost uščipa		

1.6 Pregled izdelka

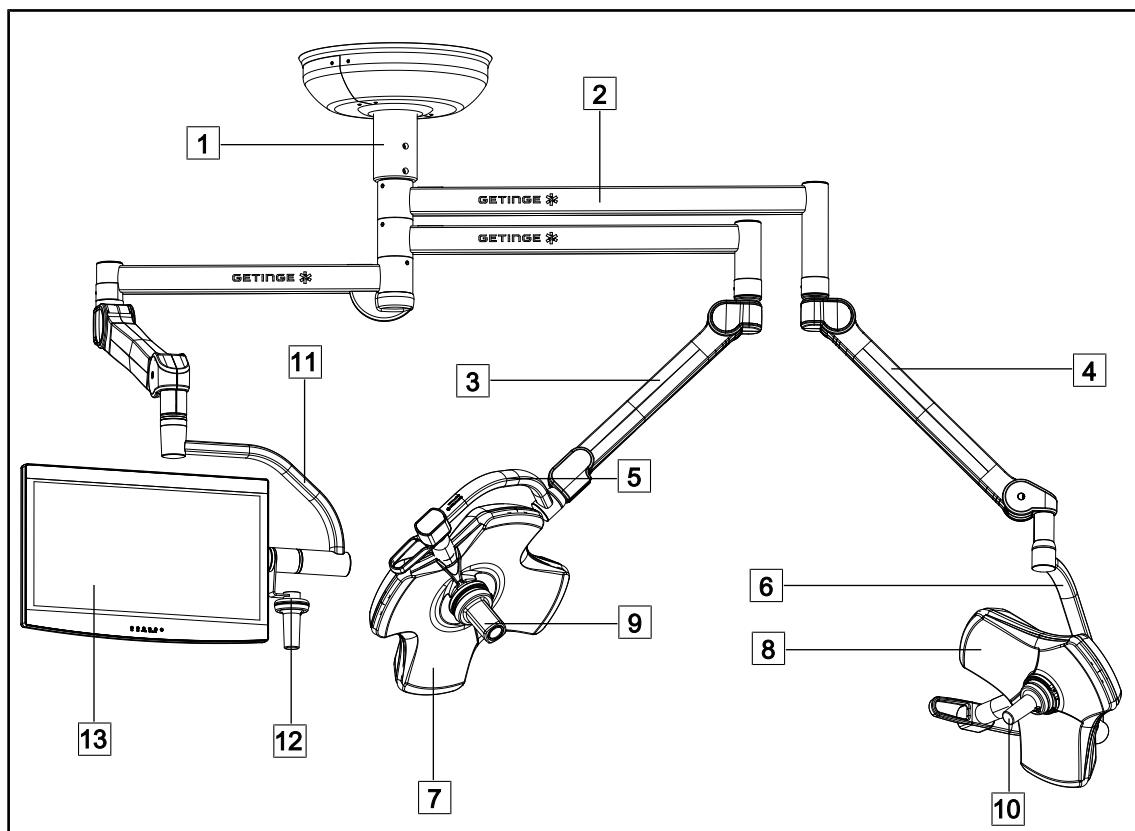

Sl. 1: Primer konfiguracije: VSTII64SFDF

- | | |
|----------------------|---|
| [1] Cev za obešanje | [8] Kupola VSTII 400 |
| [2] Nosilna roka | [9] Kamera |
| [3] Vzmetna roka SF | [10] Sterilizabilna ročica |
| [4] Vzmetna roka DF | [11] Nosilec zaslona |
| [5] Enojni lok | [12] Možnost: ročica za nosilec zaslona |
| [6] Dvojni lok | [13] Zaslon |
| [7] Kupola VSTII 600 | |

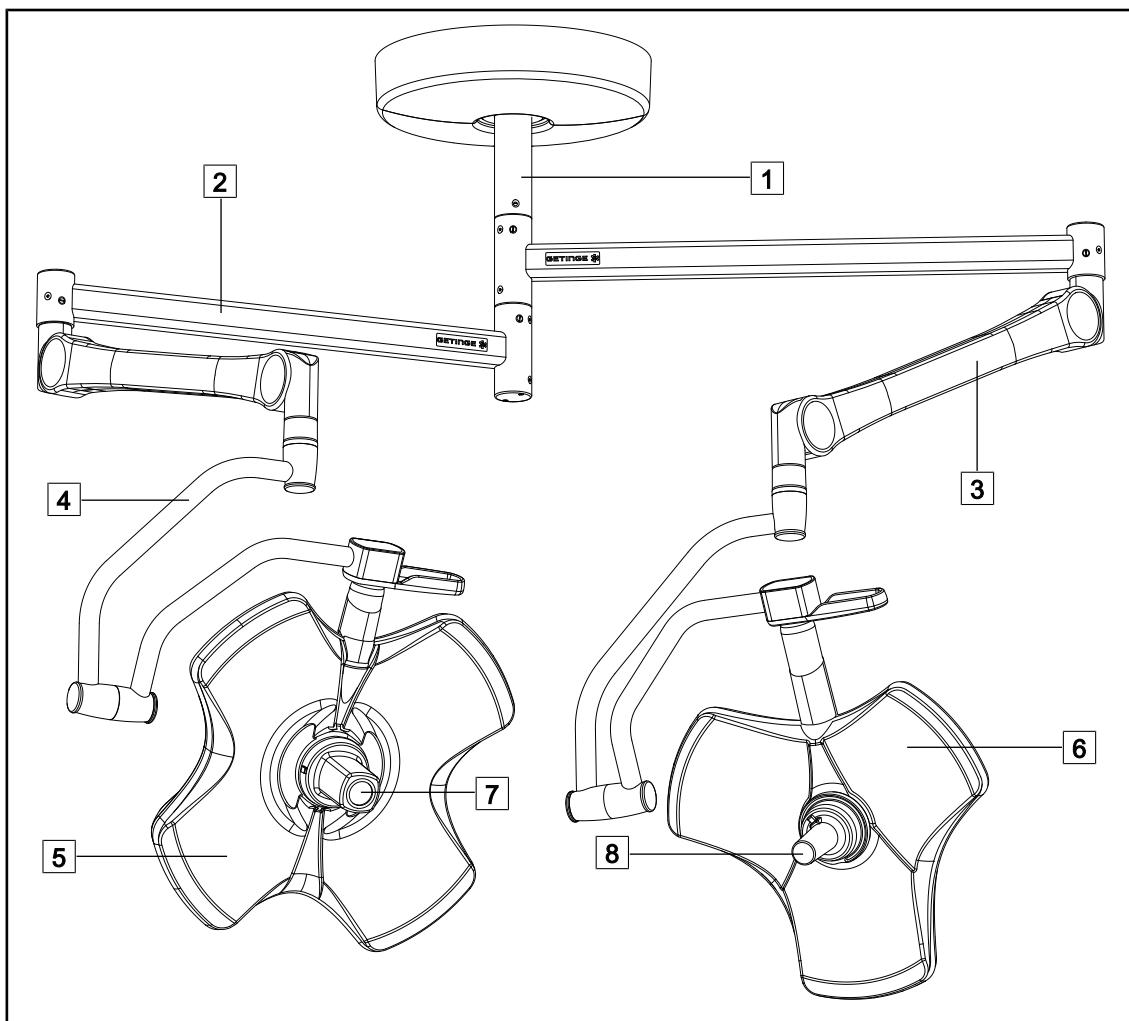


Sl. 2: Primer konfiguracije: VCSII64DF

- [1] Cev za obešanje
- [2] Nosilna roka
- [3] Vzmetna roka
- [4] Lok

- [5] Kupola VSII 600
- [6] Kupola VSII 400
- [7] Kamera
- [8] Sterilizabilna ročica

1.6.1 Sestavnici deli

1.6.1.1 Kupole

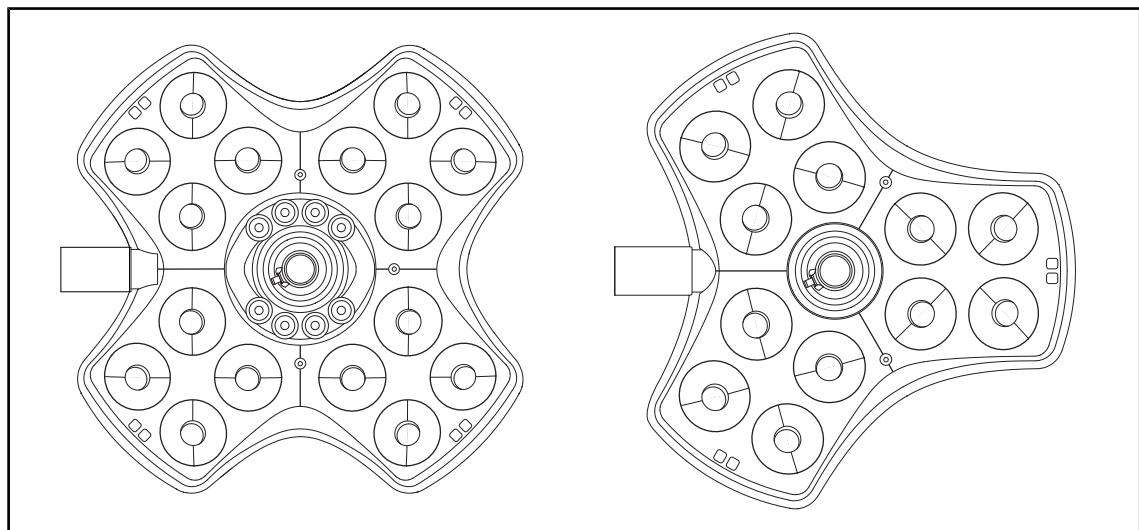


Sl. 3: Kupola Volista 600 in Volista 400

Vsaka kupola ima naslednje elemente:

- Nosilec za ročico in sterilizabilna ročica
- Upravljalna tipkovnica kupole
- Zunanja ročica


Vsaka kupola ima naslednje funkcije:

- Način večanja „Boost“
- Variacija premora snopa
- Zelena ambientalna osvetlitev
- Način AIM (samo na VSTII)
- Način LMD (možnost in samo na VSTII)
- Variacija barve snopa (možnost)
- Funkcija Volista VisioNIR (možnost in samo na VSTII)

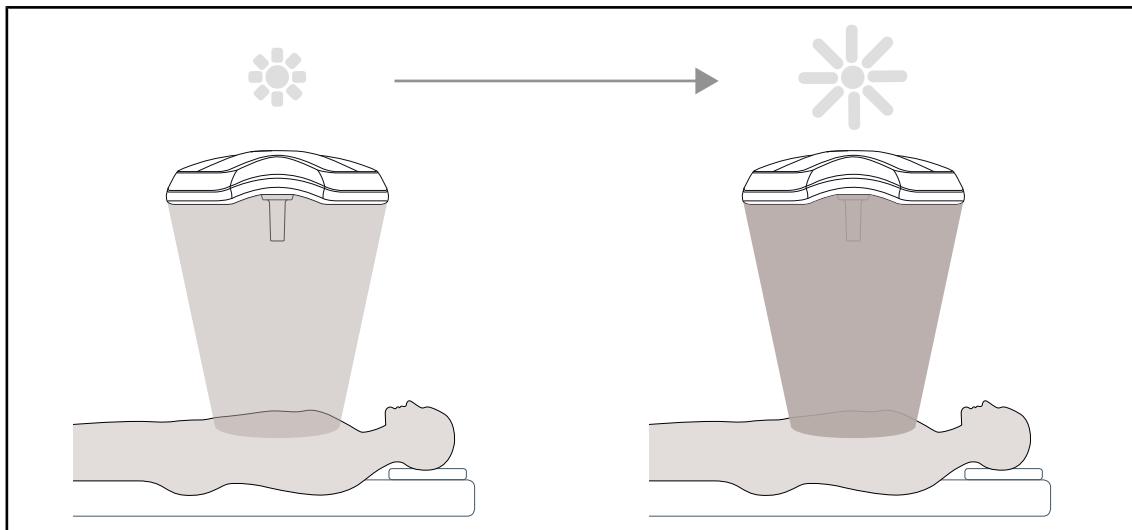Način večanja „Boost“

Sl. 4: Način večanja „Boost“


Način večanja „Boost“ (pomožna dodatna osvetlitev) je v assortimentu Volista in omogoča največje povečanje osvetljenosti po potrebi in glede na kirurške pogoje. Zagotavlja vodeno obsevanje po hoteni vključitvi; ne shrani, ko svetilka ne sveti. Ko se vključi, začnejo utripati signalne svetilke v zadnji vrsti na kupoli, tako da uporabnik nadzoruje obsevanje in zazna morebitno prekoračitev, ko se svetlobni snopi prekrijejo.

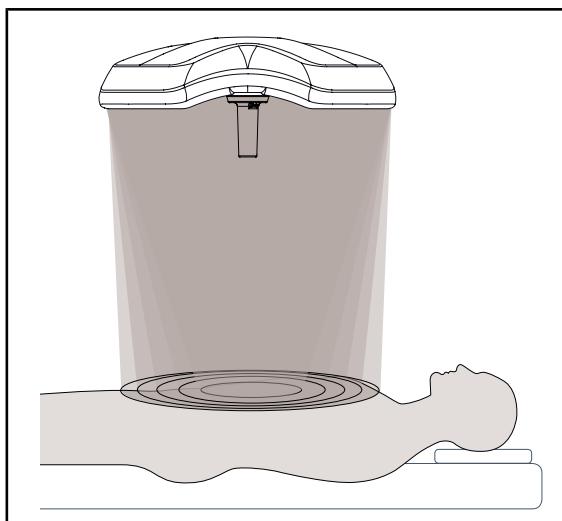Variacija premera snopa

S spremenjanjem premera snopa lahko nastavite velikost osvetljenega območja in pokrivanje snopa ustreznno velikosti reza. Sistem svetilk Volista omogoča nastavitev premera na pet ravni.

Sl. 5: Variacija premera snopa

Način AIM* (samo na VSTII)

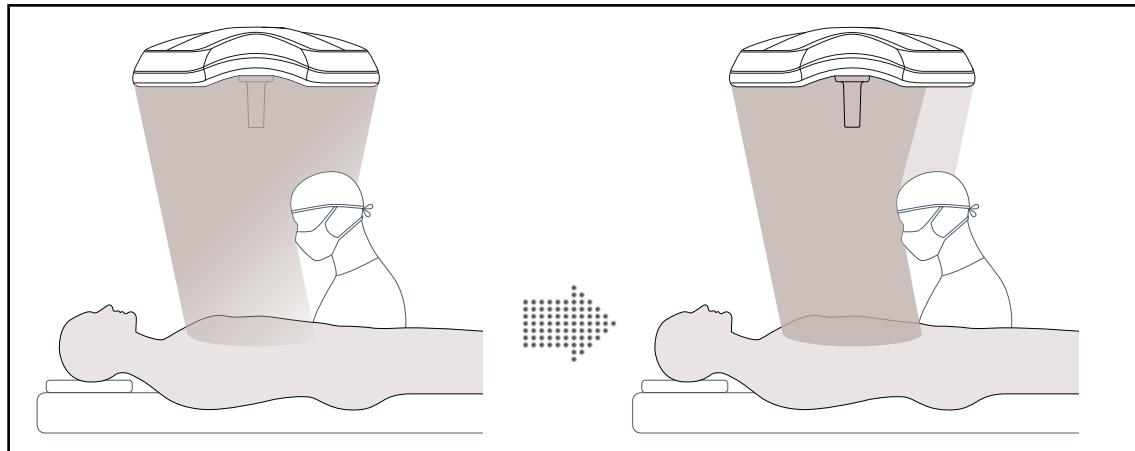


Sl. 6: Prisotnost kirurškega osebja (ena ali dve osebi)

Ta funkcija omogoča samodejno nadomestitev izgube osvetljenosti zaradi oviranja (glava, rame kirurškega osebja) med kupolo in operativnim poljem. Osvetljenost z maskiranimi LED se zmanjša, medtem ko se osvetljenost z nemaskiranimi LED poveča:


- Osvetljenost ostane enakomerna na višini operativnega polja.
- Kirurško osebje se lahko prosto giblje.
- Pogoji za kirurško osebje se izboljšajo.

Ambientalna osvetljenost

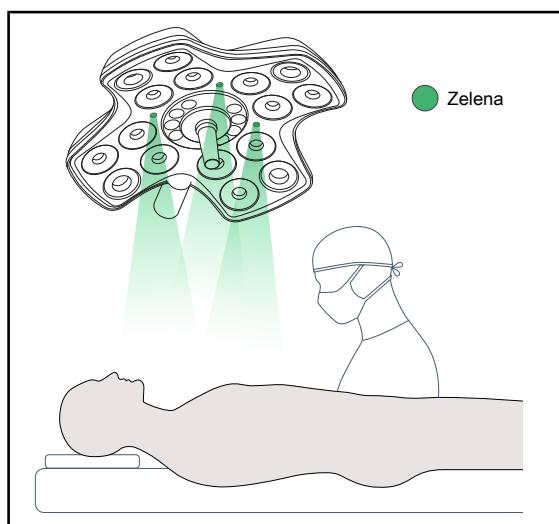

Svetilke za ambientalno osvetljevanje so oblikovane in izdelana za izboljšanje kontrasta in vidnosti zaslonov med manj invazivnimi postopki. Zagotavljajo zadostno osvetljenost za anesteziologe in kirurško osebje in ustvarijo vzdušje, ki pomirjujoče deluje na pacienta pri sprejemu, deluje manj stresno.

Sl. 7: Delovanje svetilk za ambientalno osvetljenost

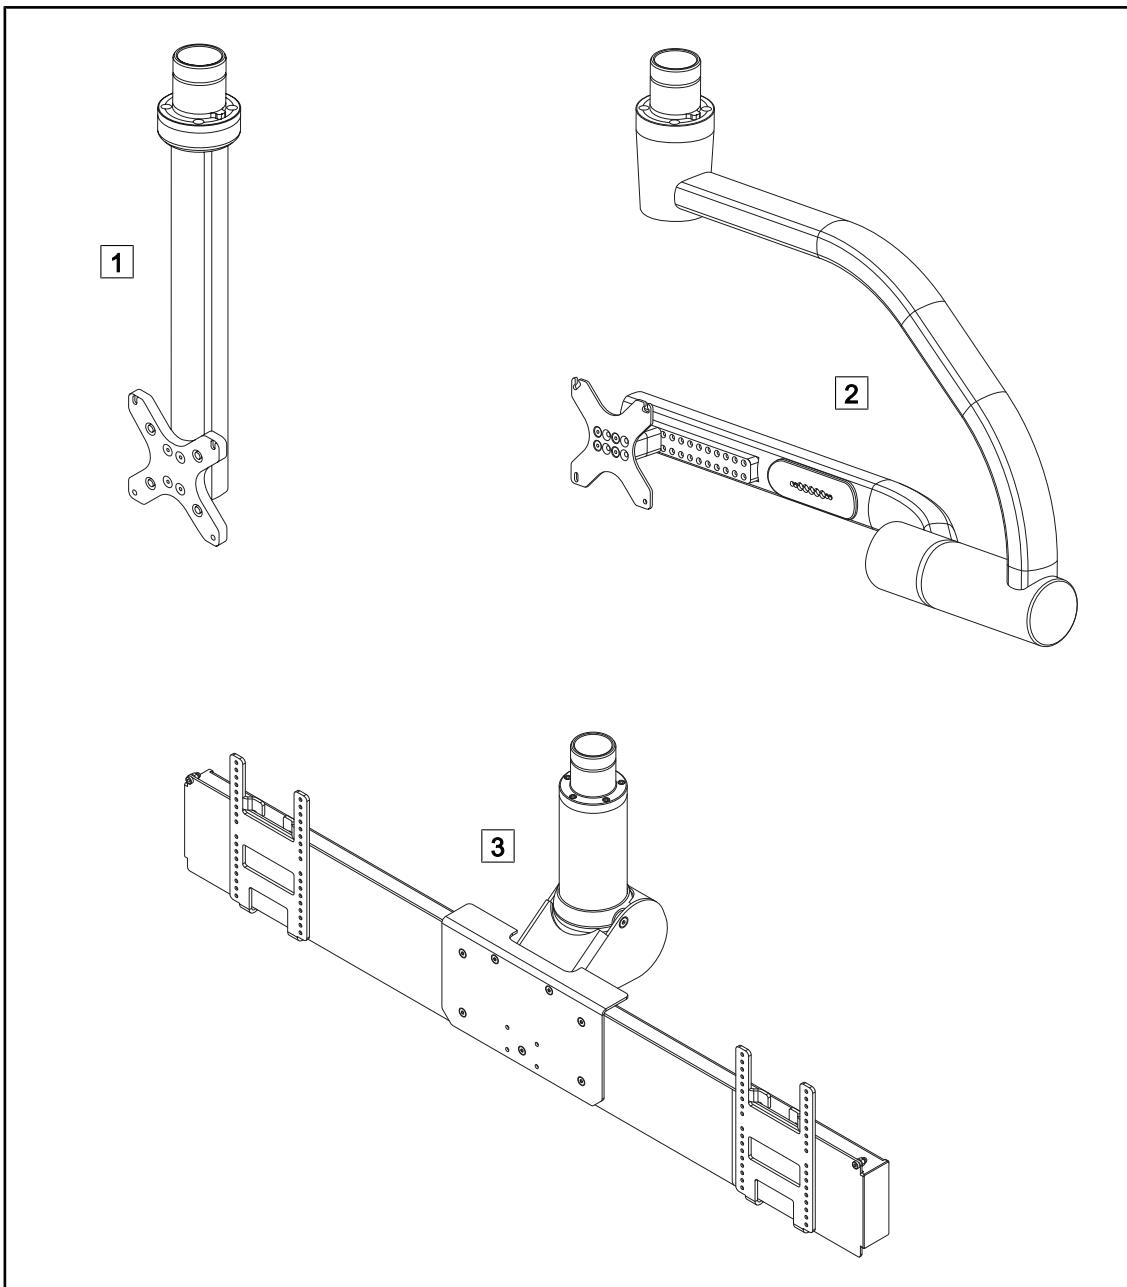1.6.1.2 Nosilec zaslona, vgrajen v pripomoček


Sl. 8: Nosilci zaslona na voljo z Volisto VSTII

[1] FHS0 / MHS0
[2] XHS0

[3] XHD1

1.6.1.3 Nosilec kamere, vgrajen v pripomoček


Nosilec kamere SC05

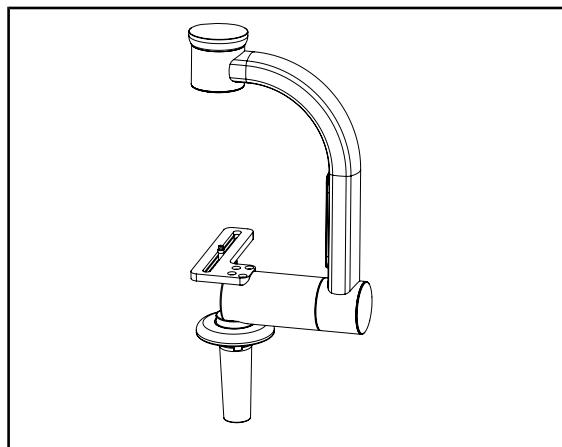

Sl. 9: Nosilec kamere SC05

Nosilec kamere je oblikovan in izdelan za medicinske videokamere z visoko ločljivostjo in za prenos celovitih signalov, kar omogoča široki premer prehoda. Kamera, ki je montirana na nosilec z vijakom Kodak, je vrtljiva v vse smeri, tako da je mogoče zajeti posnetke kirurškega mesta z različnih kotov.

FHS0 z nosilcem kamere

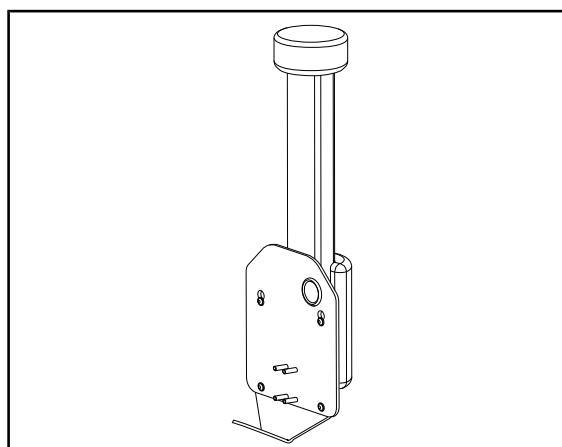


Sl. 10: Nosilec kamere SC05

Ploščo nosilca CAMERA HOLDER PLATE PSX/HGX/DAX FH je mogoče namestiti na strukturo nosilca zaslona FHS0. Nosilec kamere je oblikovan in izdelan za medicinske videokamere z visoko ločljivostjo, ki jih je mogoče priključiti na vmesnik 100 × 100 VESA. Kamera, nameščena na nosilec, je mogoče postaviti v optimalni položaj in zagotoviti zajem kirurškega mesta z različnih kotov.

1.6.2 Možnosti

1.6.2.1 Stenska nadzorna plošča


Stenska upravljalna tipkovnica (samo na VCSII)

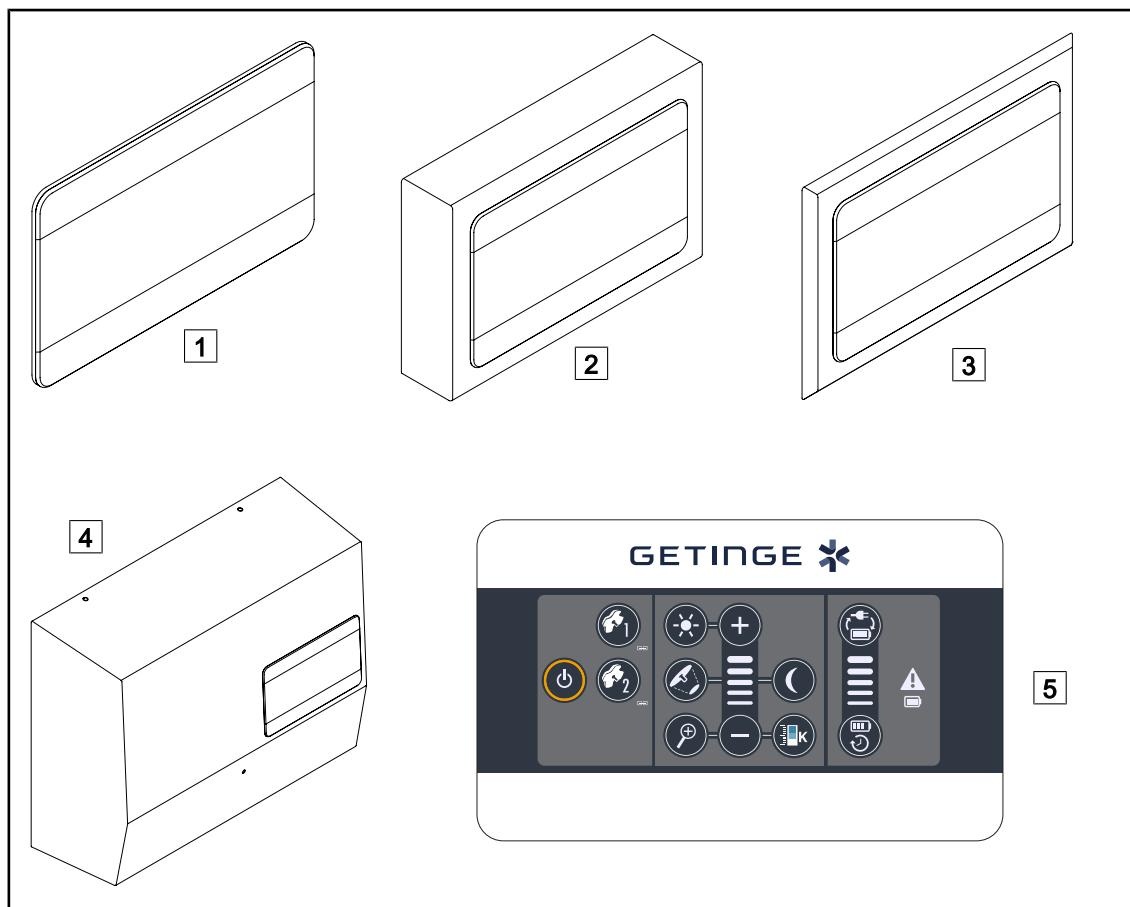

Sl. 11: Stenske upravljalne tipkovnice na voljo (samo na VCSII)

- | | |
|----------------------------------|----------------------------|
| [1] Ugreznjena izvedba | [4] Izvedba z napajanjem |
| [2] Površinska izvedba | [5] Upravljalna tipkovnica |
| [3] Ugreznjeno s sprednjo ploščo | |

Zasloni na dotik

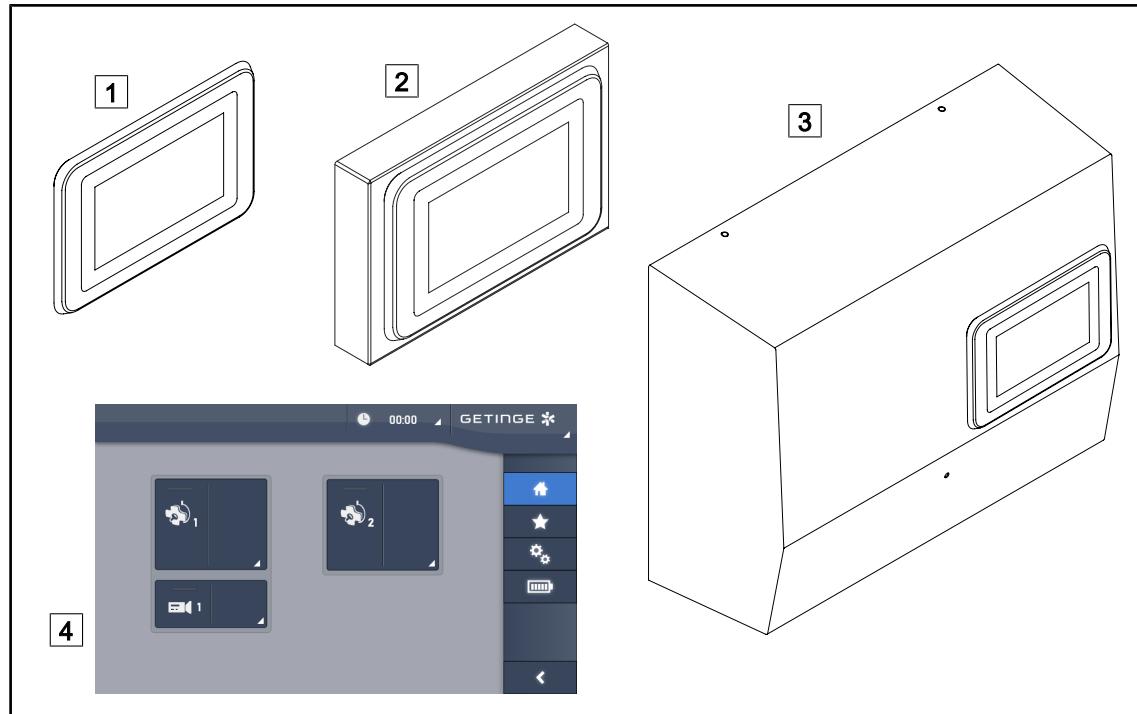


Sl. 12: Zasloni na dotik na voljo

- | | |
|------------------------|------------------------------|
| [1] Ugrezljena izvedba | [3] Izvedba z napajanjem |
| [2] Površinska izvedba | [4] Zaslony z ukazi na dotik |


1.6.2.2 Spremenljiva barvna temperatura

Operacijske svetilke VSTII so lahko treh barvnih temperatur: 3900 K, 4500 K in 5100 K. Operacijske svetilke VCSII so lahko treh barvnih temperatur: 3900 K, 4200 K in 4500 K.

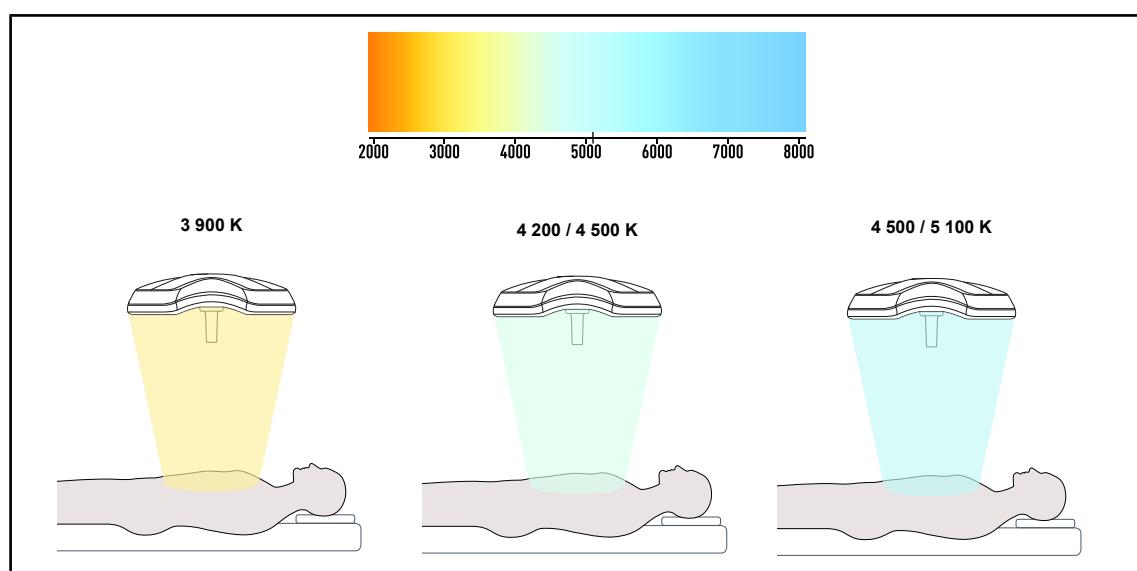

Sl. 13: Barvna temperatura

1.6.2.3 Volista VisioNIR (samo na VSTII)

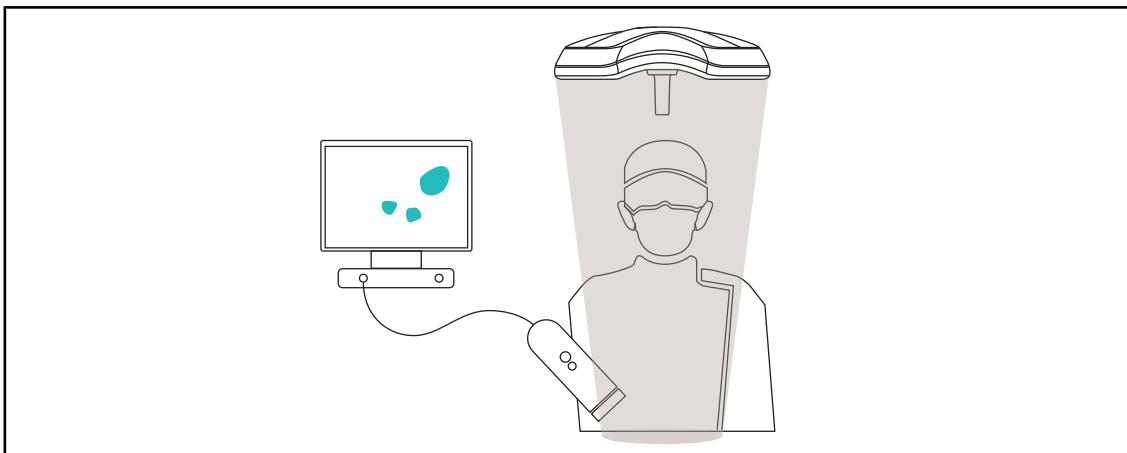

Sl. 14: Delovanje VisioNIR Volista


Funkcija VisioNIR Volista vključuje filtriranje ostankov žarkov bližnje infrardeče spektra LED s ciljem ohraniti jih na nizki ravni. VisioNIR Volista je prilagojena za kamero bližnje infrardeče, ne da bi motila signal prenosa na zaslon. VisioNIR Volista je dovoljeno uporabiti tudi med operacijo z uporabo ICG (indocianin zeleno), z uporabo naravne lastnosti, ki jo imajo nekatere tkiva, to je prenašanja fluorescenčno svetlobo po stimulaciji (avtofluorescencija). Za to mora biti območje zaznavanja fluorescence na valovni dolžini več kot 740 nm (glej preglednico 35).



NAPOTEK

Priporočamo, da najprej preizkusite sistem za slikanje s bližnjo infrardečo (NIR) in fluorescentnim barvilm s funkcijo VisioNIR Volista za najboljšo nastavitev.


1.6.2.4 Dodatne možnosti za FHS0/MHS0

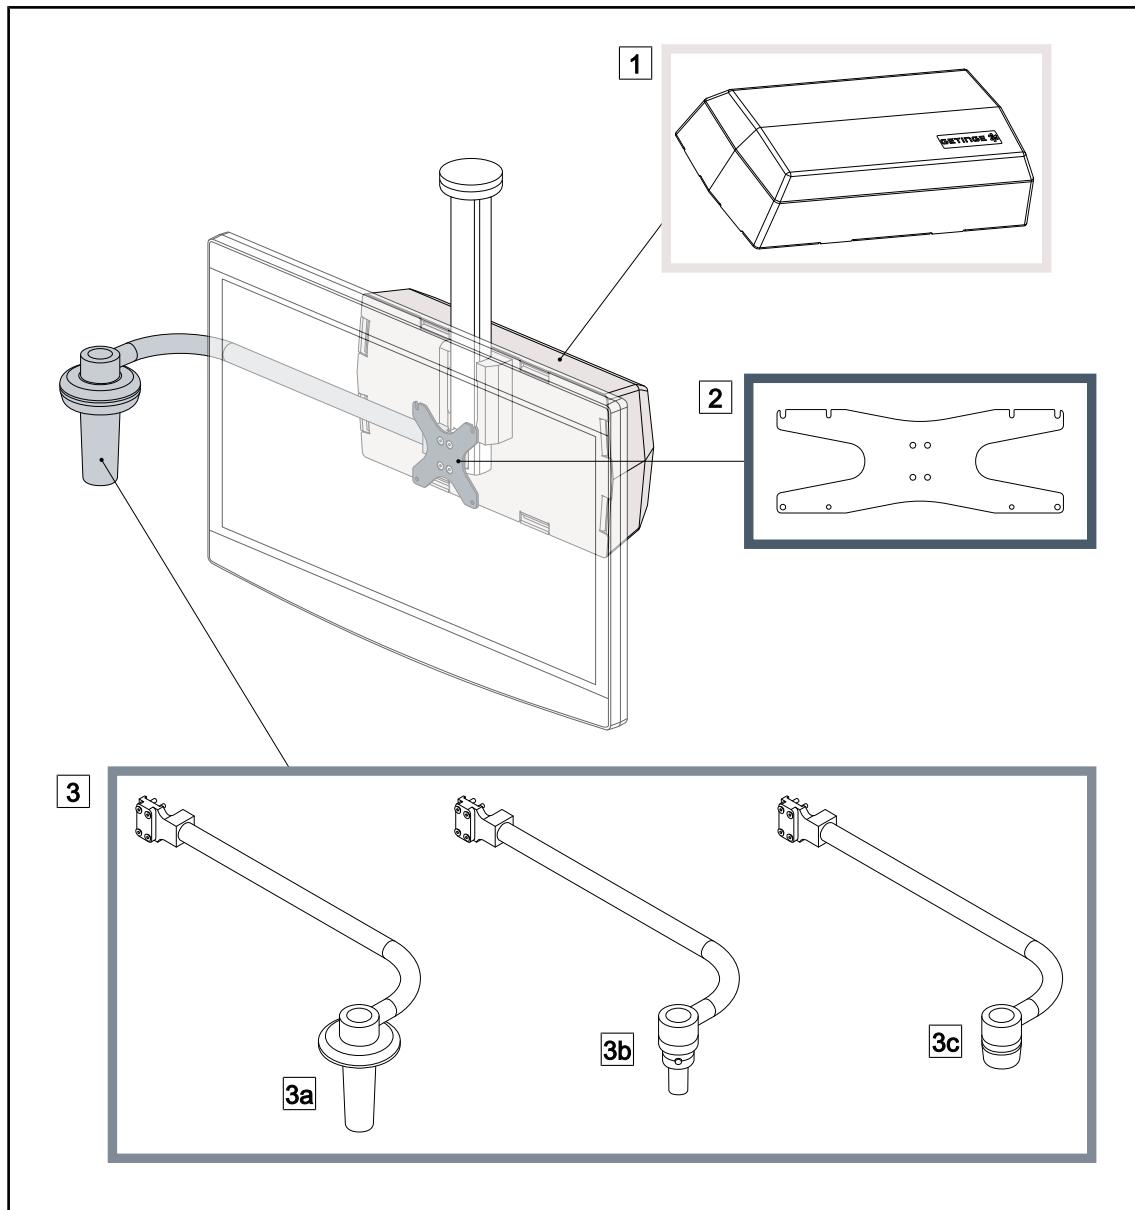

Sl. 15: Dodatne možnosti za FHS0/MHS0

- | | |
|---|-------------------------------|
| [1] Zadnji okvir | [2] Plošča nosilca zaslona MH |
| [3] Ročica (3 opcije, namestitev na levo ali desno stran zaslona) | |
| [3a] Držalo ročaja PSX FH/MH | [3b] Držalo ročaja HLX FH/MH |
| [3c] Držalo ročaja DAX FH/MH | |

1.6.2.5 Možnosti za XHS0

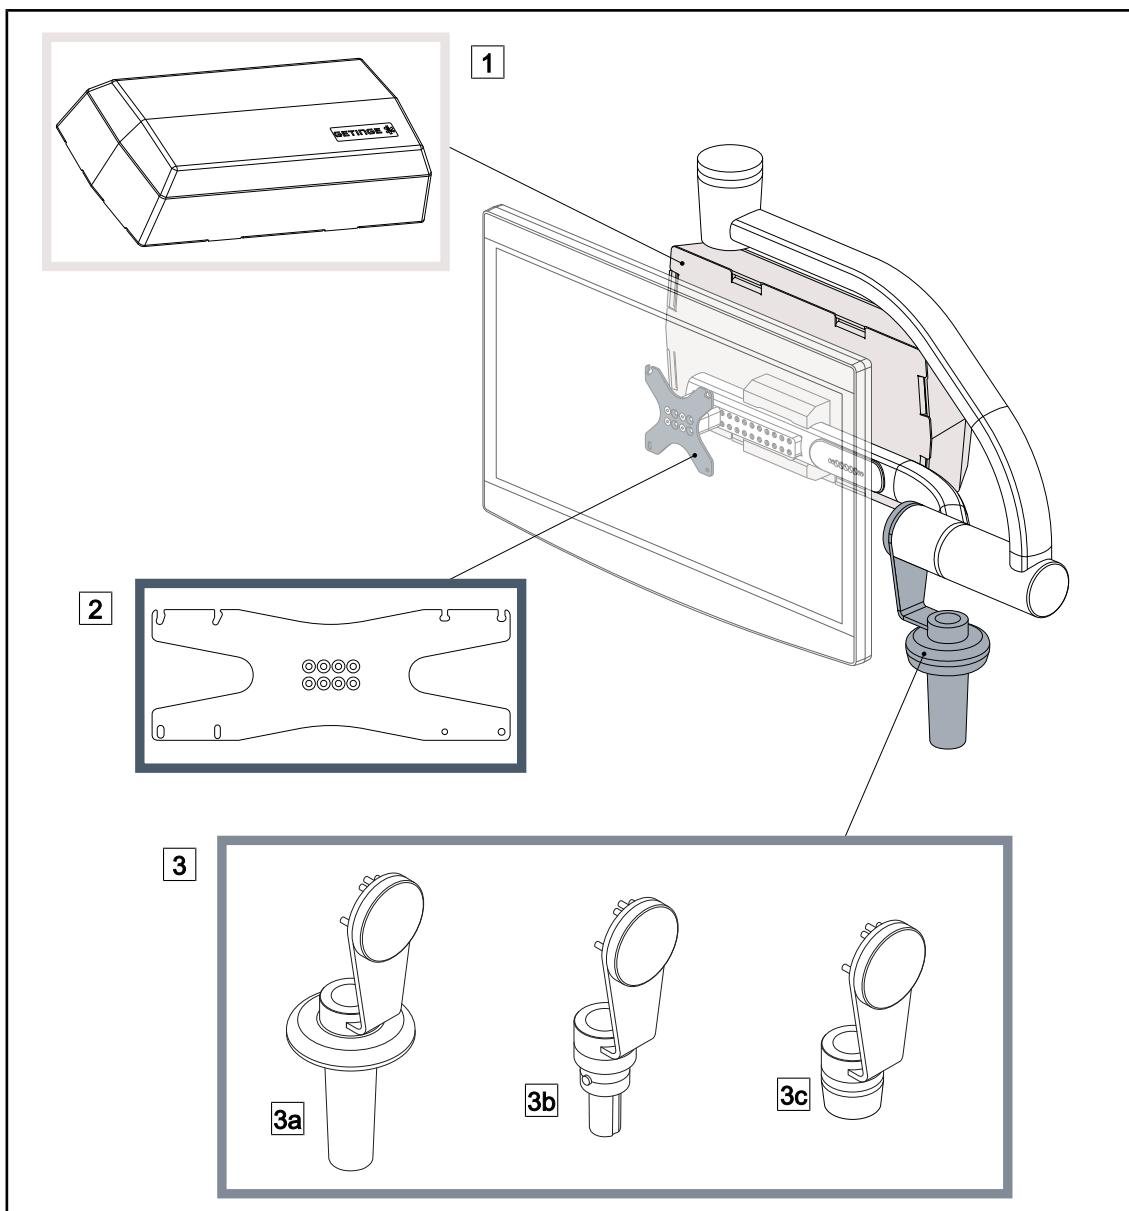


Sl. 16: Opcije za XHS0

- 1 Zadnji okvir
- 3 Ročica (3 možnosti)
- 3a Nosilec ročice PSX XH
- 3c Nosilec ročice DAX XH

- 2 Plošča nosilca zaslona XH
- 3b Nosilec ročice HLX XH

1.6.2.6 Možnost za XHD1

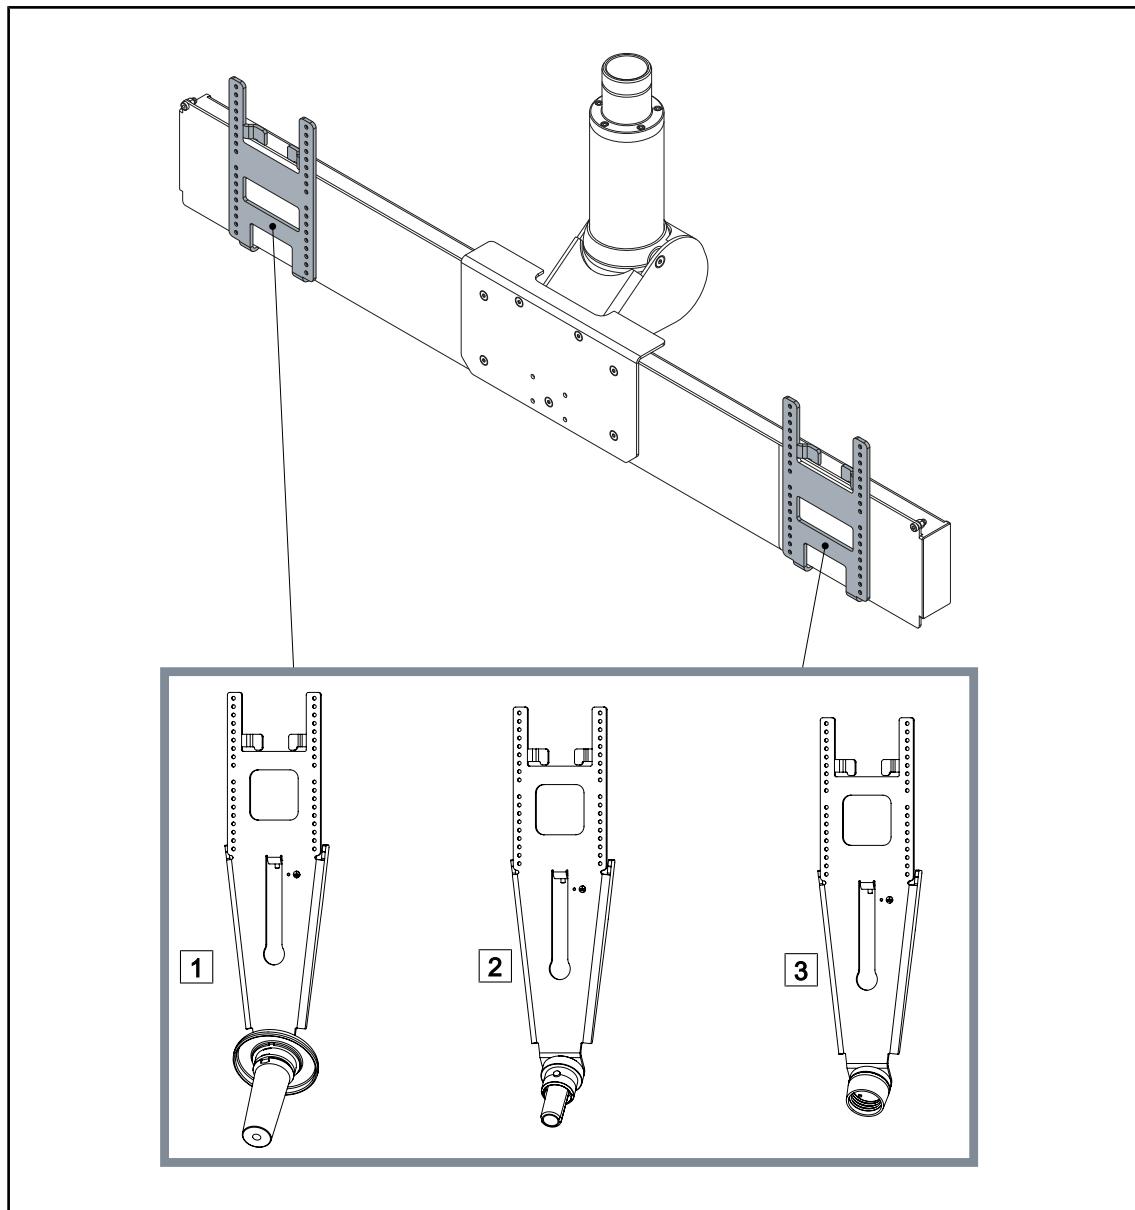


Sl. 17: Možnost za XHD1

- [1] Nosična plošča za zaslon PSX XHD1
[2] Nosična plošča za zaslon HLX XHD1

- [3] Nosična plošča za zaslon DAX XHD1

1.6.2.7 Možnosti za podporo kamere

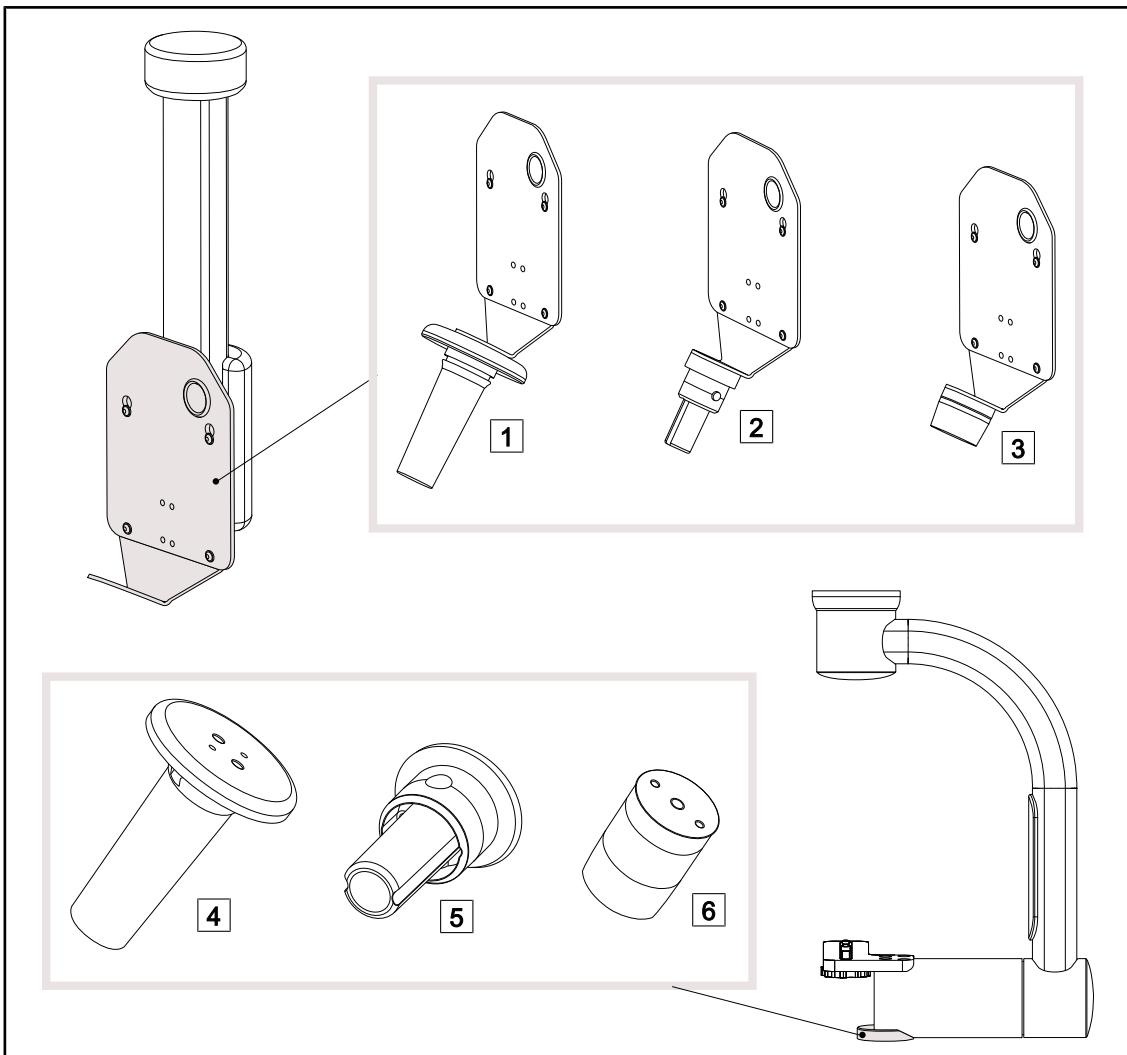


Sl. 18: Opcije, ki so na voljo z nosilci kamere

- [1] PLOŠČA ZA DRŽALO KAMERE PSX FH
- [2] PLOŠČA ZA DRŽALO KAMERE HLX FH
- [3] PLOŠČA ZA DRŽALO KAMERE DAX FH

- [4] Nosilec ročice PSX za SC05
- [5] Nosilec ročice HLX za SC05
- [6] Nosilec ročice DEVON/DEROYAL® za SC05

1.6.3 Dodatna oprema

1.6.3.1 Kamere

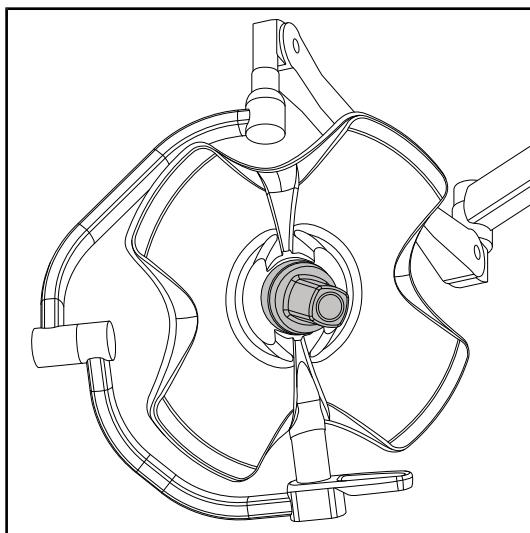

Sl. 19: Volista s kamero


Kamero lahko montirate na sredino kupole s sistemom hitrega zaklepanja „Quick lock“.



NAPOTEK

Uporabljajte samo eno kamero na posamezno konfiguracijo.

Ožičena kamera: OHDII FHD QL VP01 (samo na VSTII)

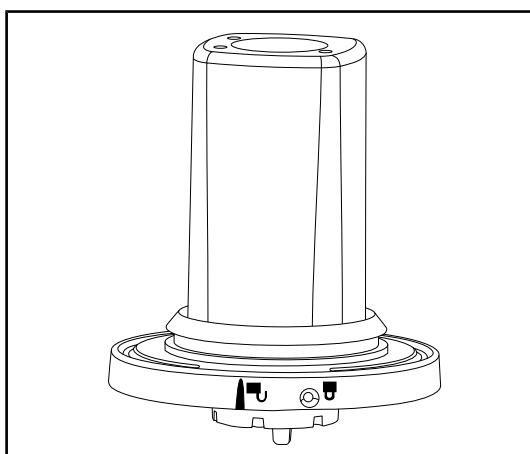

Sl. 20: Kamera OHDII FHD QL VP01


Ta kamera, ki jo lahko prenašate iz ene operacijske dvorane v drugo zaradi sistema hitrega zaklepanja „Quick lock“, je zelo uporaben pomoček za kirurško osebje. Izboljša potek operacije tako, da naredi operativno območje prosto med fazami sestavljanja in omogoča boljše spremeljanje gest kirurškega osebja ter predvidevanje potreb kirurškega osebja. Montirate jo lahko samo na kupolo, povezano z videosistemom.



NAPOTEK

Preden montirate ožičeno kamero, preverite in potrdite, da je kupola ustrezeno videopovezana tako, da sledite navodilom na etiketi kupole. Na etiketi mora biti navedeno „VP“. Če kamero inštalirate na kupolo, ki ni videopovezana, sistem sicer zazna kamero, vendar ni videoprikaza.

Kamera z brezžičnim sistemom: OHDII FHD QL AIR03 E/U

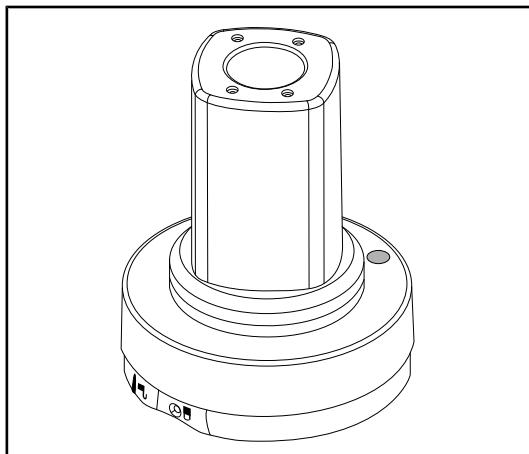

Sl. 21: Kamera OHDII FHD QL AIR03 E/U


Ta kamera, ki jo lahko prenašate iz ene operacijske dvorane v drugo zaradi sistema hitrega zaklepanja „Quick lock“, je zelo uporaben pomoček za kirurško osebje. Izboljša potek operacije tako, da naredi operativno območje prosto med fazami sestavljanja in omogoča boljše spremeljanje gest kirurškega osebja ter predvidevanje potreb kirurškega osebja.



NAPOTEK


Za tehnične specifikacije brezžičnega sistema glejte priložena navodila za namestitev ali navodila na spletišču dobavitelja.

1.6.3.2 Nosilec za ročico

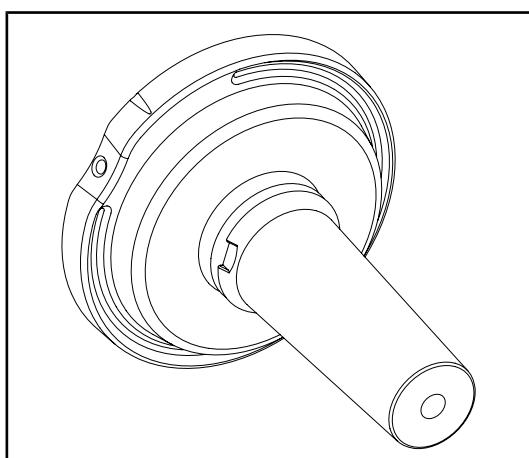


Sl. 22: Nosilec za sterilizabilno ročico STG PSX

Ta nosilec za ročico stoji na sredini kupole, zagnjen na mesto s sistemom hitrega zaklepanja „Quick Lock“. Primeren je za sterilizabilno ročico tipa STG PSX.

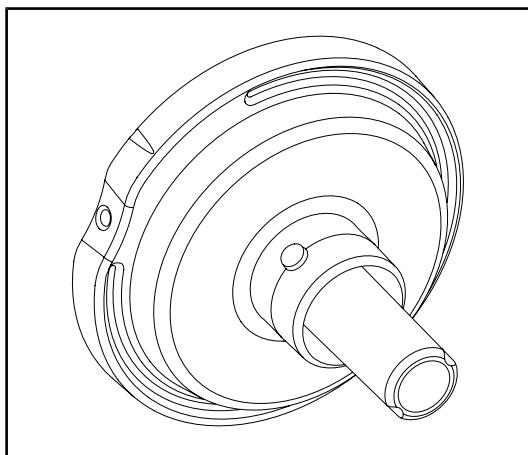

Sl. 23: Nosilec za sterilizabilno ročico STG HLX

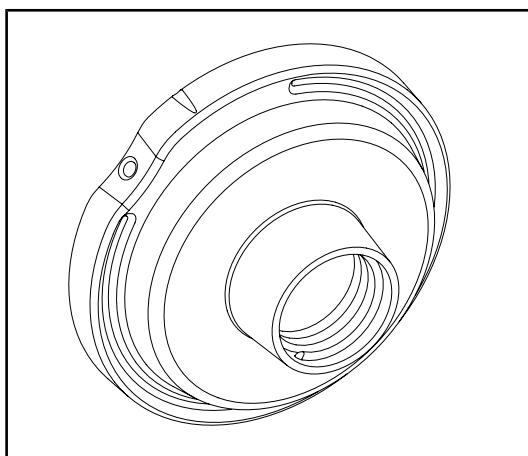


Sl. 24: Vmesnik za ročico za enkratno uporabo

Ta nosilec za ročico stoji na sredini kupole, zaklenjen na mesto s sistemom hitrega zaklepanja „Quick Lock“. Primeren je za sterilizabilno ročico tipa STG HLX.

Ta vmesnik za ročico za enkratno uporabo stoji na sredini kupole, zaklenjen na mesto s sistemom hitrega zaklepanje „Quick Lock“. Primeren je za ročico za enkratno uporabo tipa Devon® ali Deroyal®.


1.6.3.3 LMD* (samo na Volista VSTII)

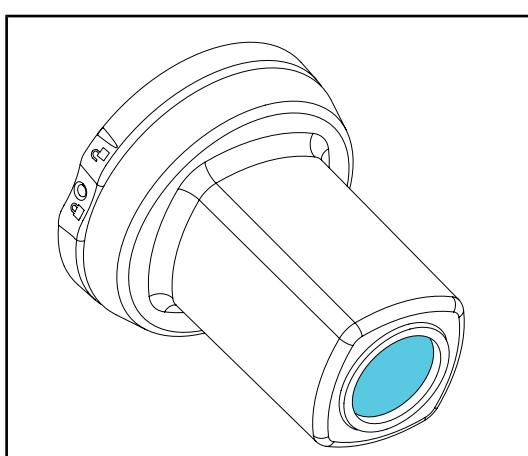

Sl. 25: Modul LMD

Sistem LMD (Luminance Management Device) upravlja osvetlitev, ki jo zazna kirurško oko. Namen te inovacije je ohranjati optimalno ostrino vida in preprečiti težave s prilagajanjem vida morebitnim spremembam svetilnosti. Kirurško osebje ima tako zagotovljeno isto stopnjo osvetljenosti, ko gleda v temne odprtine ali v svetlo tkivo.

1.6.3.4 Svinčene plošče

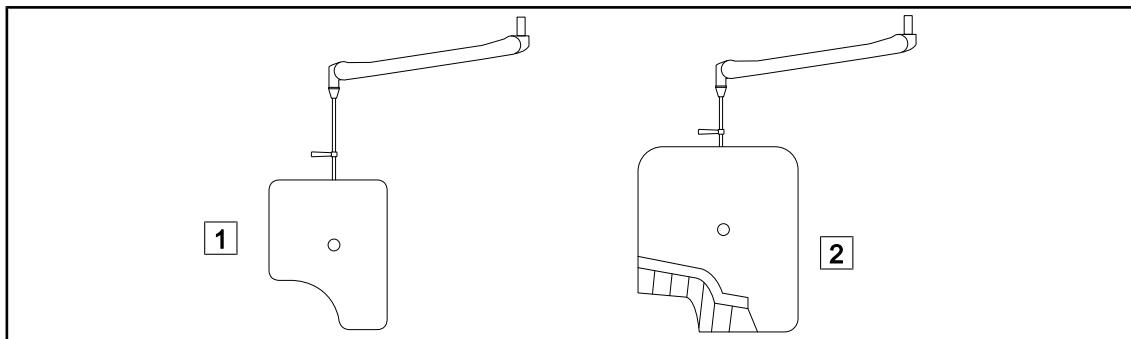


Sl. 26: Svinčene plošče

[1] OT50001/OT50001I

[2] OT54001/OT54001I

1.7 Etiketa s podatki o pripomočku

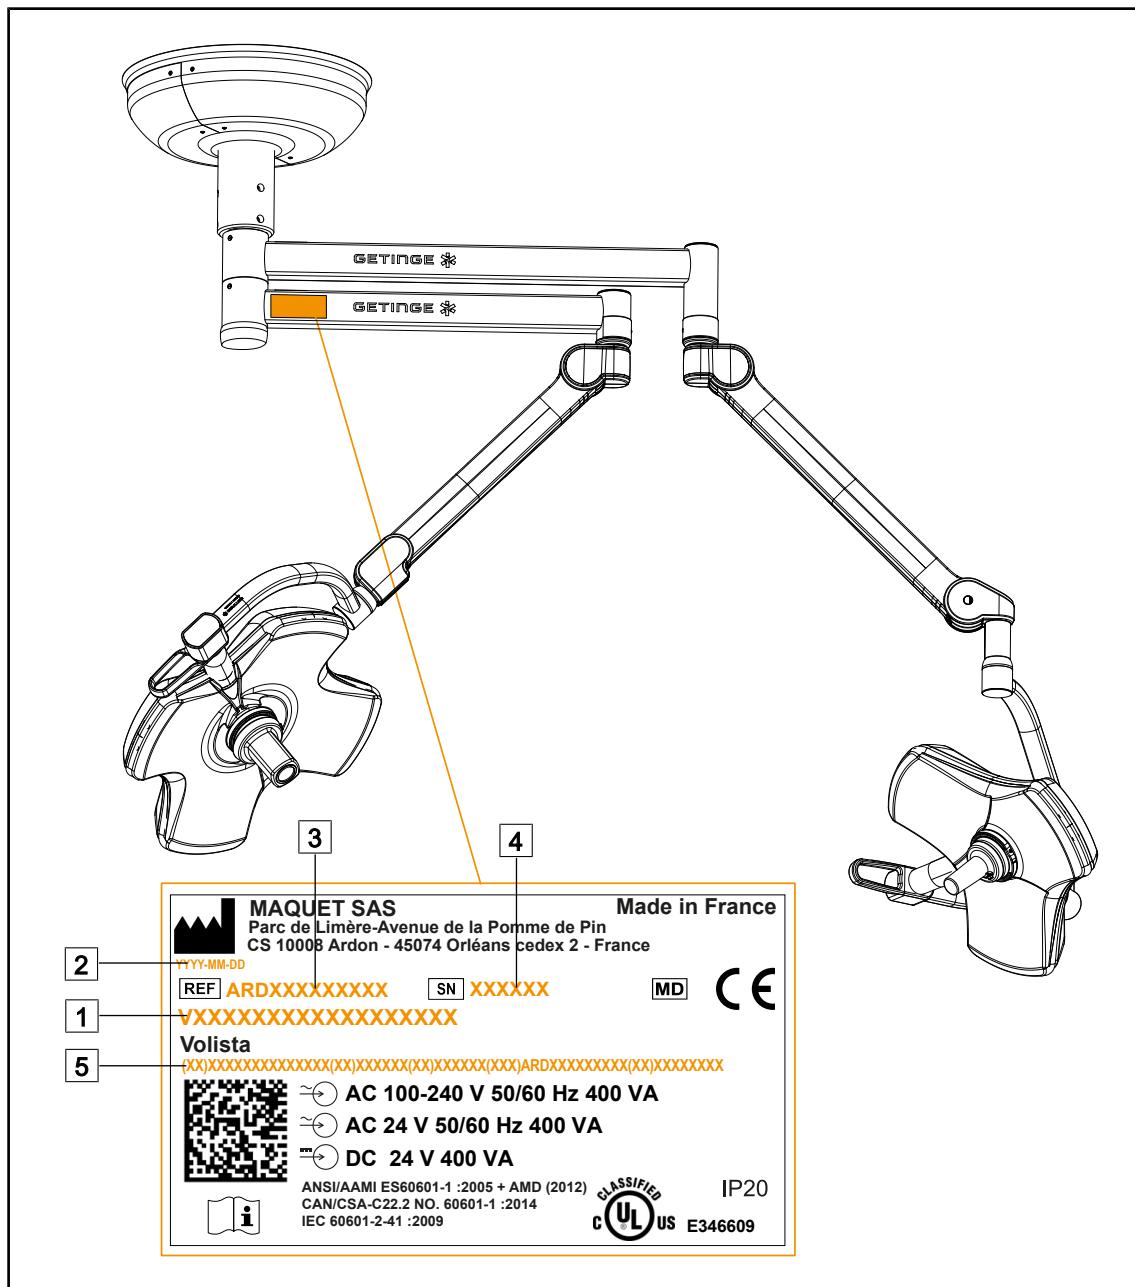

Sl. 27: Etiketa z identifikacijskimi podatki

- 1** Ime proizvoda
- 2** Datum proizvodnje
- 3** Ref. oznaka izdelka

- 4** Serijska številka
- 5** Identifikacija UDI

1.8

Pomembni standardi

Oprema je v skladu z varnostnimi določili naslednjih standardov in direktiv:

Referenca	Naslov
IEC 60601-1:2005 + AMD1:2012 ANSI/AAMI ES60601-1:2005/(R)2012 CAN/CSA-C22.2 št. 60601-1:14 EN 60601-1:2006/A1:2013/A12:2014	Električna medicinska oprema – 1. del: Splošne zahteve za osnovno varnost in bistvene zmogljivosti
IEC 60601-2-41:2009+AMD1:2013 EN 60601-2-41:2009/A11:2011/A1:2015	Električna medicinska oprema – 2.-41.del: Posebne zahteve za osnovno varnost svetilk za kirurške posege in diagnosticiranje
IEC 60601-1-2:2014+AMD1:2020 EN 60601-1-2:2015/A1:2021	Električna medicinska oprema – 1.-2. del: Splošne zahteve za varnost – Spremljevalni standard: Elektromagnetne motnje – Zahteve in preizkusi
IEC 60601-1-6:2010+AMD1:2013+AMD2:2020 EN 60601-1-6:2010/A1:2015/A2:2021	Električna medicinska oprema – 1.-6. del: Splošne zahteve za osnovno varnost in bistvene zmogljivosti – Spremljevalni standard: Primernost za uporabo
IEC 60601-1-9:2007+AMD1: 2013+AMD2:2020 EN 60601-1-9:2008/A1:2014/A2:2020	Električna medicinska oprema – 1.-9. del: Splošne zahteve za osnovno varnost in bistvene zmogljivosti – Spremljevalni standard: Zahteve za ekološko zasnova
IEC 62366-1:2015+AMD1:2020 EN 62366-1:2015/A1:2020	Medicinski pripomočki – 1. del: Medicinski pripomočki – Uporaba inženirstva uporabljivosti pri medicinskih napravah
IEC 62304:2006+AMD1:2015 EN 62304:2006/A1:2015	Programska oprema za medicinske pripomočke – Procesi življenjskega ciklusa programske opreme
ISO 20417:2020 EN ISO 20417:2021	Medicinski pripomočki – Informacije proizvajalca
ISO 15223-1:2021 EN ISO 15223-1 :2021	Medicinski pripomočki – Simboli proizvajalca za označevanje medicinskih pripomočkov – 1. del: Splošne zahteve
EN 62471:2008	Fotobiološka varnost svetilk in naprav, v katere so nameščene svetilke
IEC 62311:2019 EN 62311:2020	Ocena elektronske in električne opreme v povezavi z omejitvami izpostavljanja ljudi elektromagnethim poljem (0 Hz–300 GHz)
Odlok 384/2020	Certifikat INMETRO – Zahteve za evalvacijo skladnosti za opremo pod nadzorom pristojnih za zdravstvo

Tab. 3: Skladnost s standardi, ki veljajo za proizvod

Vodenje kakovosti:

Referenca	Leto	Naslov
ISO 13485 EN ISO 13485	2016 2016	ISO 13485:2016 EN ISO 13485:2016 Medicinski pripomočki – Sistemi vodenje kakovosti – Zahteve za zakonodajne namene
ISO 14971 EN ISO 14971	2019 2019	ISO 14971:2019 EN ISO 14971:2019 Medicinski pripomočki – Upravljanja tveganja za medicinske pripomočke
Zvezni zakonik 21 CFR 11. del	2023	Naslov 21 – Hrana in zdravila Poglavlje I – pristojni organ za hrano in zdravila ter zadovoljevanje človeških potreb „Food And Drug Administration Department Of Health And Human Services“ Podpoglavlje A – Splošno 11. DEL – Elektronske evidence, elektronski podpisi
Zvezni zakonik 21 CFR 820. del	2020	Naslov 21 – Hrana in zdravila Poglavlje I – pristojni organ za hrano in zdravila ter zadovoljevanje človeških potreb „Food And Drug Administration Department Of Health And Human Services“ Podpoglavlje H – Medicinski pripomočki 820. DEL – Predpis o sistemu kakovosti

Tab. 4: Skladnost s standardi vodenja kakovosti

Okoljski standardi in predpisi:

Referenca	Leto	Naslov
Direktiva 2011/65/EU	2011	Omejitev uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi
Direktiva 2015/863/EU	2015	Direktiva o spremembah in dopolnitvah Priloge II Direktive 2001/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta o seznamu snovi, za katere veljajo omejitve
Direktiva 2016/585/EU	2016	Izjeme za svinec, kadmij, šestivalentni krom in polibromirane difeniletre (PBDE)
Direktiva 2017/2102	2017	Omejitev uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi
IEC 63000	2022	Presoja električnih in elektronskih naprav v zvezi z omejitvami pri nevarnih snoveh
Uredba 1907/2006	2006	Registracija, evalvacija in avtorizacija kemičnih snovi, tudi veljavne omejitve za te snovi
Zvezni zakon „US California proposition 65 Act“	1986	Zakon o varni pitni vodi in strupih „Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act 1986“
Direktiva 2018/851	2018	Direktiva o spremembni Direktive 2008/98/ES o odpadkih
Direktiva 94/62/EC	1994	Embalaža in upravljanje odpadkov
SJ/T 11365-2006	2006	Administrativni ukrep za nadzor onesnaževanja zaradi elektronskih proizvodov ter omejitve za škodljive snovi „Administrative Measure on the Control of Pollution caused by Electronic Information Products Chines RoHS (Restriction of Hazardous Substances)“

Tab. 5: Okoljski standardi in predpisi

Država	Referenca	Leto	Naslov
Argentina	Določba 2318/2002	2002	Predpis o upravljanju zdravil, hrane in medicinske tehnologije ter registracijo medicinskih pripomočkov „Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica – Registro de productos Medicas – Reglamento“
Avstralija	TGA 236-2002	2021	Predpis o medicinskih pripomočkih „Therapeutic Goods (Medical Devices) Regulations 2002.“ Zakonski predpis št. 236, 2002 v skladu z zakonom o medicinskih pripomočkih „Therapeutic Goods Act 1989“
Brazilija	RDC 665/2022	2022	Dobre proizvodne prakse za medicinske pripomočke in medicinske pripomočke za diagnostiko in-vitro „Good Manufacturing Practices for Medical Devices and Medical devices for In Vitro Diagnostics“
Brazilija	RDC 751/2022	2022	Klasifikacija nevarnosti, obveščanje in obveznost registriranja in označevanja ter navodila za uporabo medicinskih pripomočkov
Kanada	SOR/98-282	2023	Predpisi o medicinskih pripomočkih
Kitajska	Predpis št. 739	2021	Predpis o nadzoru in upravljanju medicinskih pripomočkov
EU	Uredba 2017/745/EU	2017	Predpisi o medicinskih pripomočkih
Japonska	Odlok MHLW: MO št. 169	2021	Ministrski odlok o standardih za kontrolo proizvodnje in zagotavljanje kakovosti medicinskih pripomočkov in diagnostiko in-vitro
Južna Koreja	Zakon 14330	2016	Zakon o medicinskih pripomočkih
Južna Koreja	Uredba 27209	2016	Uredba o izvajanju medicinskega zakona
Južna Koreja	Predpis 1354	2017	Predpis o izvajanju medicinskega zakona
Švica	RS (Odim) 812.213	2020	Odlok o medicinskih pripomočkih (MedDO) z dne 1. julija 2020
Tajvan	TPAA 2018-01-31	2018	Tajvanski zakon o farmacevtskih zadevah
Združeno kraljestvo	Zakon	2021	Predpisi o medicinskih pripomočkih 2002 št. 618
ZDA	Zvezni zakonik 21 CFR 7. del	2023	Naslov 21 – Hrana in zdravila Poglavlje I – pristojni organ za hrano in zdravila ter zadovoljevanje človeških potreb „Food And Drug Administration Department Of Health And Human Services“ Podpoglavlje A – Splošno 7. DEL – Izvedbeni predpis
ZDA	Zvezni zakonik 21 CFR podpoglavlje H	-	Naslov 21 – Hrana in zdravila Poglavlje I – pristojni organ za hrano in zdravila ter zadovoljevanje človeških potreb „Food And Drug Administration Department Of Health And Human Services“ Podpoglavlje H – Medicinski pripomočki

Tab. 6: Skladnost s standardi, ki veljajo za trg

Druge informacije (samo Ljudska republika Kitajska)

产品名称：手术无影灯
规格型号：STANDOP VOLISTA 600, STANDOP VOLISTA 400
SN 序列号：见英文标签 生产日期：见英文标签
使用期限：10 年
注册证号：国械注进 20142015956
产品技术要求编号：国械注进 20142015956
注册人/生产企业名称：Maquet SAS 迈柯唯股份有限公司
注册人/生产企业住所：Parc de Limère Avenue de la Pomme de Pin CS 10008 Ardon 45074 Orléans Cedex 2- FRANCE
生产地址：Parc de Limère Avenue de la Pomme de Pin CS 10008 Ardon 45074 Orléans Cedex 2- FRANCE
注册人/生产企业联系方式：+33 (0) 2 38 25 88 88
代理人：迈柯唯（上海）医疗设备有限公司
代理人住所：中国（上海）自由贸易试验区美盛路 56 号 2 层 227 室
代理人电话：800 820 0207
其他内容详见说明书

1.9 Informacije o predvideni uporabi

1.9.1 Predvidena uporaba

Operacijske svetilke VOLISTA so oblikovane in izdelane za osvetlitev pacientovega telesa med kirurškim posegom, diagnosticiranjem ali zdravljenjem.

1.9.2 Navedbe

Svetilke v assortimentu VOLISTA so oblikovane in izdelane za uporabo na področju kirurgije, zdravljenja in pregledovanja, za kar je potrebna posebna osvetlitev.

1.9.3 Predvideni uporabniki

- To opremo lahko uporabljajo samo zdravstveni delavci, ki so prebrali ta navodila.
- Opremo lahko čisti samo tehnično usposobljeno osebje.

1.9.4 Neustrezna uporaba

- Uporaba v smislu manjšega sistema sijalk (kupola), če prekinitev delovanja pomeni smrtno nevarnost za pacienta.
- Uporaba poškodovanega proizvoda (npr.: pomanjkljivo vzdrževanje).
- V okolju, ki ni okolje profesionalno okolje za zagotavljanje zdravstvene oskrbe (npr.: nega na domu).
- Uporaba kamere kot pomoč med operacijo ali za postavitev diagnoze.
- Uporaba nosilca zaslona ali nosilca kamere za drug predmet, ki ni zaslon oziroma kamera.
- Namestitev pretežkega ali prevelikega zaslona, ki ni po priporočilih.

1.9.5 Kontraindikacije

Ta izdelek nima kontraindikacij.

1.10 Osnovno delovanje

Operacijske svetilke Volista osvetlijo v smeri operativnega polja, hkrati omejujejo povezano toplotno energijo.

1.11 Klinične koristi

Operacijske svetilke in ambulantne svetilke so obvezen pripomoček za invazivno in neinvazivno zdravljenje ali diagnosticiranje; omogočajo najboljšo osvetlitev, pri kateri kirurgi in zdravstveno osebje najbolje vidijo.

Podpora, ki jo svetilke zagotovijo med kirurškimi posegi in med pregledi v ambulanti, je njihova neposredna klinična korist. Kirurške svetilke na osnovi LED zagotovijo še več preko drugih tehnologij (npr.: inkandescenca).

Med pravilno uporabo svetilke:

- Izboljšajo udobje delovnega prostora in vizualno zaznavanje tako, da razpršijo svetlobo po območju, ki mora biti najbolje osvetljeno za kirurge in zdravstveno osebje, ter oddajajo manj topote.
- Omogočijo upravljanje senc, tako da se lahko zdravstveno osebje osredotoči na kirurški posug ali diagnosticiranje.
- Svetilke imajo daljšo tehnično življenjsko dobo, zaradi česar je manjša nevarnost delnega izpada med operacijami.
- Dovajajo stalno in neprekinjeno svetlobo ves čas uporabe.
- Dovajajo pravilno barvo različnih svetlobnih vlaken.

1.12 Garancija

Za garancijske pogoje, ki veljajo za izdelek, prosite lokalnega zastopnika Getinge.

1.13 Življenjska doba izdelka

Predvidena življenjska doba je 10 let.


Ta življenjska doba ne velja za potrošni material, kot so sterilizabilne ročice.

Za uresničitev življenjske dobe 10 let morajo opremo redno pregledovati ustrezno usposobljeni serviserji, ki jih odobri Getinge, pog. Časovni razpored vzdrževanja. Če je oprema še v uporabi po preteku te dobe, jo morajo pregledati ustrezno usposobljeni serviserji, ki jih odobri Getinge, se zagotovi varnost opreme.

1.14 Navodila o tem, kako zmanjšati vpliv na okolje

Pripomoček boste uporabljali najbolje, če boste omejili vpliv pripomočka na okolje. Za to upoštevajte nekaj navodil v nadaljevanju:

- Za čim manjšo porabo energije pripomoček izključite, ko ga ne uporabljate.
- Pripomoček pravilno postavite tako, da ni treba nadomestiti izgube zaradi neustrezne postavitve z večanjem moči svetilnosti.
- Upoštevajte časovni načrt vzdrževanja, ki je pripravljen z namenom zmanjšanja škodljivega vpliva na okolje.
- Odgovore na morebitna vprašanja o odlaganju in recikliraju pripomočka glejte poglavje Ravnanje z odpadki [► Stran 118].
- Premišljeno uporabljajte različne možnosti, ki zagotovijo varčno porabo energije:

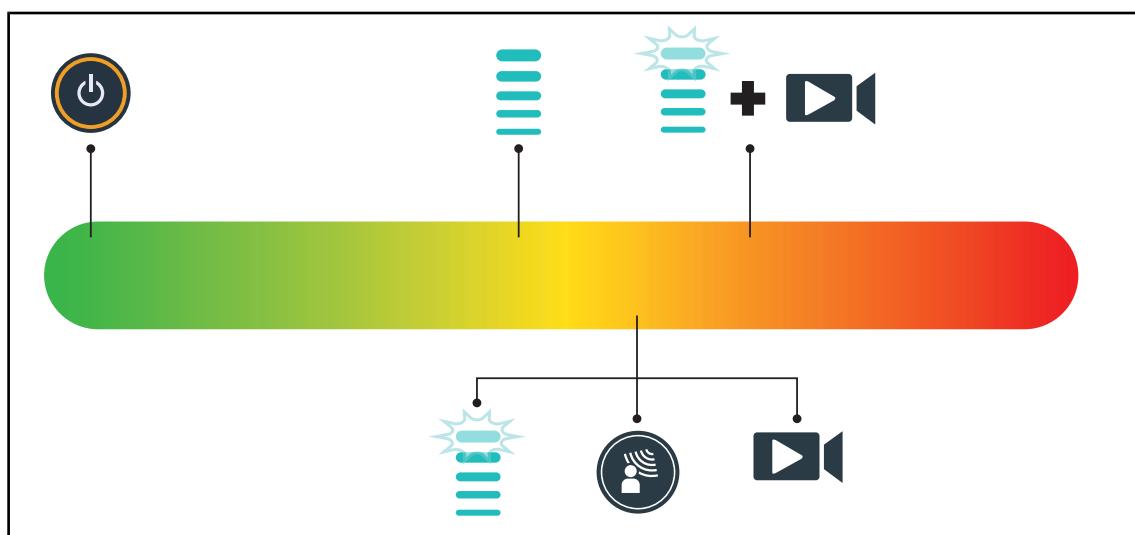

Sl. 28: Poraba električne energije med uporabo pripomočka



NAPOTEK

Več o porabi energije pripomočka je navedeno v poglavju 9.2 Električne lastnosti. V pripomočku ni nevarnih snovi v skladu z Direktivo o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi – RoHS (preglednica 5) in Uredbo o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH).

2 Informacije, povezane z varnostjo

2.1 Okoljski pogoji

Ambientni pogoji transporta in shranjevanja

Ambientna temperatura	10 °C +60 °C
Relativna vlažnost	Od 20 % do 75 %
Atmosferski tlak	Od 500 hPa do 1060 hPa

Tab. 7: Ambientni pogoji transport/shranjevanje

Ambientni pogoji uporabe

Ambientna temperatura	10 °C +40 °C
Relativna vlažnost	Od 20 % do 75 %
Atmosferski tlak	Od 500 hPa do 1060 hPa

Tab. 8: Ambientni pogoji uporaba



NAPOTEK

Za informacije o delovanju v elektromagnethem okolju glejte Izjava o elektromagnetni združljivosti

2.2 Varnostna navodila

2.2.1 Varna uporaba izdelka



OPOZORILO!

Nevarnost poškodb

Če se baterija prehitro izprazni, se lahko kupola izključi med operacijo.

Vsek mesec testirajte avtonomijo baterije. Če ne deluje pravilno, naročite servis Getinge.



OPOZORILO!

Nevarnost tkivne reakcije

Svetloba je energija, ki je zaradi oddajanja valov določenih dolžin lahko nezdružljiva z nekaterimi bolezenskimi stanji.

Uporabnik mora poznati nevarnosti uporabe svetilk nad osebami, ki so intolerantni za UV in/ali infrardeče žarke, ali osebami, ki so občutljive za svetlobo.

Pred posegom je treba preveriti in potrditi, da so svetilke združljive z bolezenskim stanjem.



OPOZORILO!

Nevarnost izsušitve tkiva ali opeklin

Svetloba je energija, ki lahko izsuši tkivo, predvsem pod svetlobnimi snopi več kopol hkrati.

Uporabnik mora poznati nevarnosti, povezane z izpostavljanjem odprtih ran zelo intenzivni svetlobi. Uporabnik mora ravnati skrbno in premišljeno ter prilagoditi osvetljenosti po meri posega in pacienta, predvsem med dolgotrajnejšim posegom.

**OPOZORILO!****Nevarnost opeklín**

Ta naprava ni odporna proti eksploziji. Iskrenje, ki v normalnih pogojih ni nevarno, lahko sproži požar v okolju, v katerem je visoka vsebnost kisika.

Ne uporabiti naprave v okolju, v katerem je velika vsebnost vnetljivih plinov in kisika.

**OPOZORILO!****Nevarnost poškodb/okuženja**

Poškodovana naprava pomeni nevarnost poškodb za uporabnika in nevarnost okužbe za pacienta.

Če je naprava poškodovana, je ne uporabite.

2.2.2 Elektrika

**OPOZORILO!****Nevarnost usmrтitve z električnim tokom**

Oseba, ki ni usposobljena za montažo, vzdrževanje ali demontažo napravo, se lahko med temi opravili poškodujejo zaradi električnega toka.

Napravo ali sestavne dele naprave lahko montirajo, vzdržujejo in demontirajo samo serviserji Getinge ali serviserji, ki se za to usposobijo pri Getinge.

**OPOZORILO!****Nevarnost poškodb**

Pri prekinitvi napajanja med operacijo se kupole svetilk izključijo, če ni pomognega napajanja.

Bolnišnica mora ravnati v skladu z veljavnimi standardi o uporabi medicinskih pripomočkov in zagotoviti sistem pomožnega električnega napajanja.

2.2.3 Optika

**OPOZORILO!****Nevarnost poškodb**

Ta izdelek oddaja potencialno nevarno optično sevanje. Lahko pride do okularnih poškodb.

Uporabnik ne sme gledati v svetlobo, ki jo oddaja kirurska luč. Med operacijo na obrazu mora imeti pacient zaščitene oči.

2.2.4 Okužba


**OPOZORILO!****Nevarnost okužbe**

Pri tehničnih in čistilnih procesih obstaja nevarnost kontaminacije v operativnem polju.

Tehničnih in čistilnih procesov ni dovoljeno izvajati v prisotnosti pacienta.

3

Kontrolni vmesnik

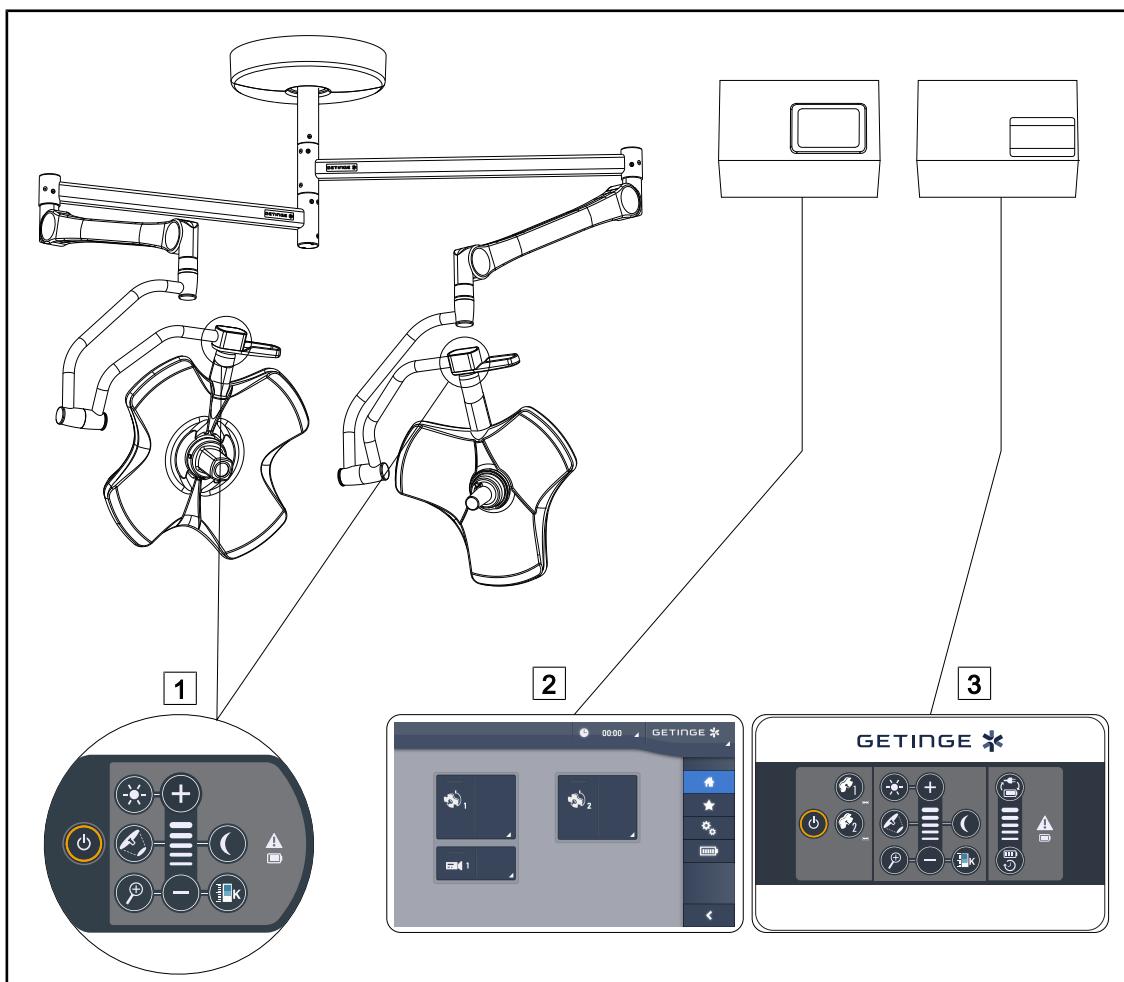

Sl. 29: Kontrolni vmesnik Volista


- [1] Upravljalna tipkovnica kupole
 [2] Zaslon na dotik (možnost)

- [3] Stenska upravljalna tipkovnica (samo na VCSII, možnost)

**NAPOTEK**


Osvetlitev je možno upravljati tudi preko zunanjega kontrolnega naprave tipa integratorja ter spojiti osvetljevanje z drugimi zunanjimi opreme (laminarni tok ...). Za več informacij prosite zastopnika Getinge.

3.1 Upravljalne tipkovnice kupole

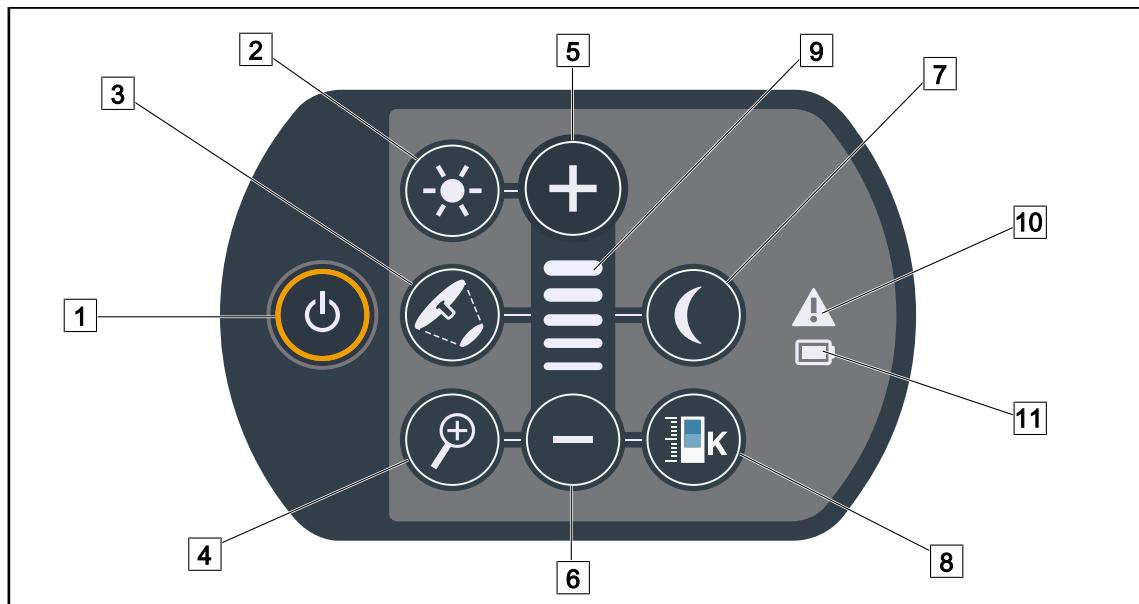

Sl. 30: Upravljalna tipkovnica VCSII

- | | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| [1] Zagon/zaustavitev | [7] Način ambientalne osvetljenosti |
| [2] Nastavitev osvetlitve | [8] Variacija barvne temperature |
| [3] Variacija premera snopa | [9] Kazalnik stopnje |
| [4] Zum kamere | [10] Opozorilna svetilka |
| [5] Plus (zvišaj stopnjo) | [11] Signalna svetilka za baterijo |
| [6] Minus (zmanjšaj stopnjo) | |

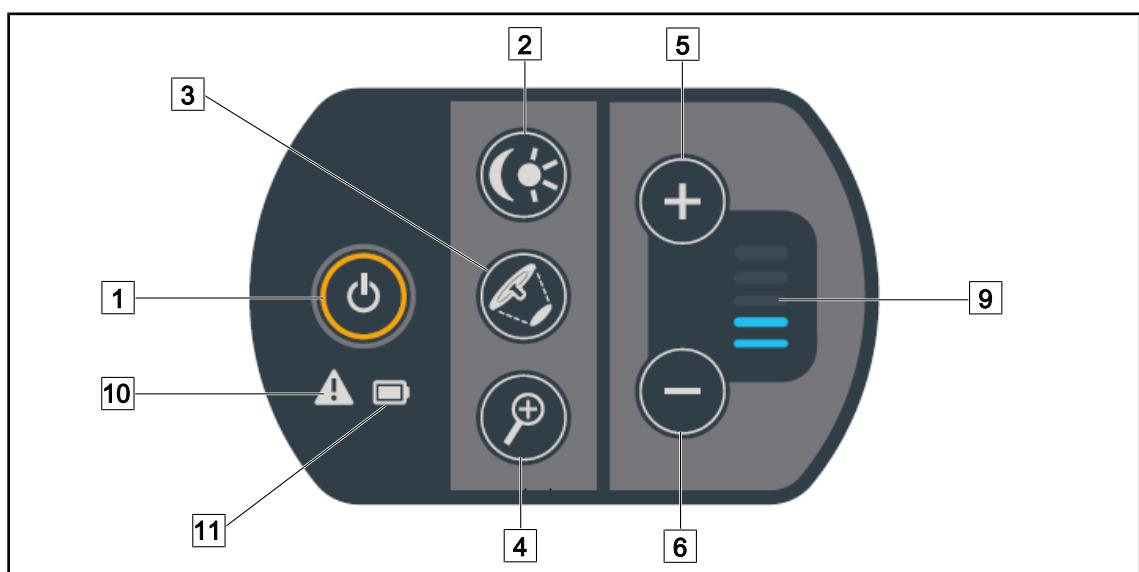


Sl. 31: Upravljalna tipkovnica VSTII

- | | |
|---|------------------------------------|
| [1] Zagon/zaustavitev | [6] Minus (zmanjšaj stopnjo) |
| [2] Upravljanje osvetlitvenosti/način ambientalne osvetljenosti | [9] Kazalnik stopnje |
| [3] Variacija premera snopa | [10] Opozorilna svetilka |
| [4] Zum kamere | [11] Signalna svetilka za baterijo |
| [5] Plus (zvišaj stopnjo) | |

3.2

Stenska upravljalna tipkovnica (samo za VCSII)

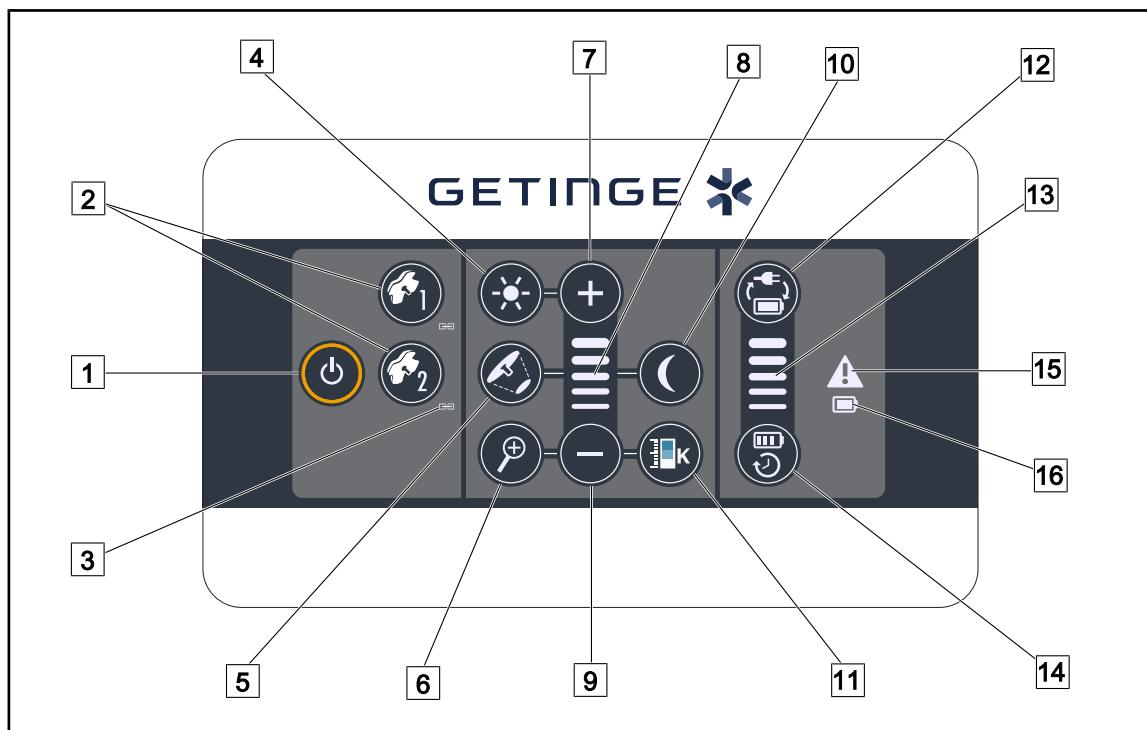

Sl. 32: Stenska upravljalna tipkovnica

- | | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| [1] Zagon/zaustavitev | [9] Minus (znižaj stopnjo) |
| [2] Izbera kupole (1 ali 2) | [10] Način ambientalne osvetljenosti |
| [3] Kazalnik sinhroniziranja | [11] Variacija barvne temperature |
| [4] Nastavitev osvetlitve | [12] Preklop baterije |
| [5] Variacija premera snopa | [13] Kazalnik stanja baterije |
| [6] Zum kamere | [14] Avtonomija baterije |
| [7] Plus (zvišaj stopnjo) | [15] Opozorilna svetilka |
| [8] Kazalnik stopnje | [16] Signalna svetilka za baterijo |

3.3 Zaslolu na dotik




Sl. 33: Zaslona z ukazi na dotik

- | | |
|----------------------|---------------------|
| [1] Vrstica stanja | [3] Aktivno območje |
| [2] Menijska vrstica | |

Št.	Ime
1	Območje zaslona, na katerem se označijo indikator napake, indikator baterij, ura, logotip Maquet in logotip kupca.
2	Območje zaslona za dostop do različnih menijev: vhodna stran, priljubljeni, funkcije in parametri.
3	Območje zaslona za upravljanje naprave.

Tab. 9: Informacije zaslona na dotik

Vrstica stanja

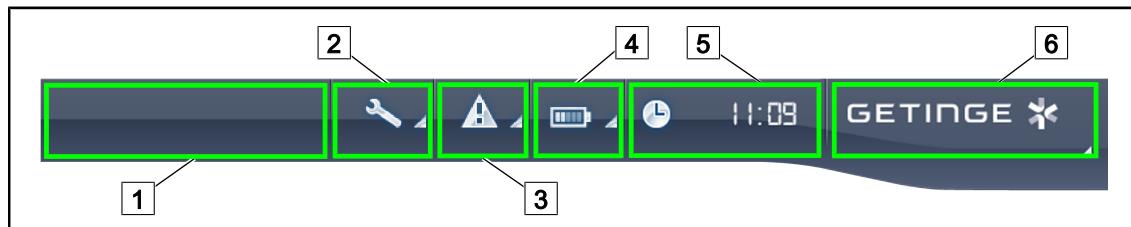


Sl. 34: Vrstica stanja na zaslonu na dotik

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| [1] Logo kupca (možnost) | [2] Indikator vzdrževanja |
| [3] Indikator napake | [4] Indikator baterije |
| [5] Ura | [6] Logo Getinge |

Št.	Ime	Možna dejanja
1	Logo kupca (možnost)	/
2	Označi, da je nujna revizija. Izpiše se med vzdrževanjem.	Pritisnite na Indikator vzdrževanja za dostop do okna za potrditev revizije.
3	Označi sistemsko napako. Izpiše se samo ob sistemski napaki.	Pritisnite na Indikator napake za pregled napak.
4	Označi stanje baterij; za več informacij glejte poglavje Signalne oznake na zaslonu na dotik [► Stran 99] Izpiše se samo ob sistemu pomožnega napajanja.	Pritisnite na Indikator baterij , da se odpre stanje različnih baterij.
5	Označi uro	Pritisnite na Uro za dostop do nastavitev datuma in ure.
6	Logo Getinge	Pritisnite na Logotip Getinge za dostop do informacij o vzdrževanju izdelka. Znova pritisnite na Logo Getinge , da dostopite do menija za serviserje Getinge ali pooblaščene delavce.

Tab. 10: Vrstica stanja zaslona na dotik

Menijska vrstica

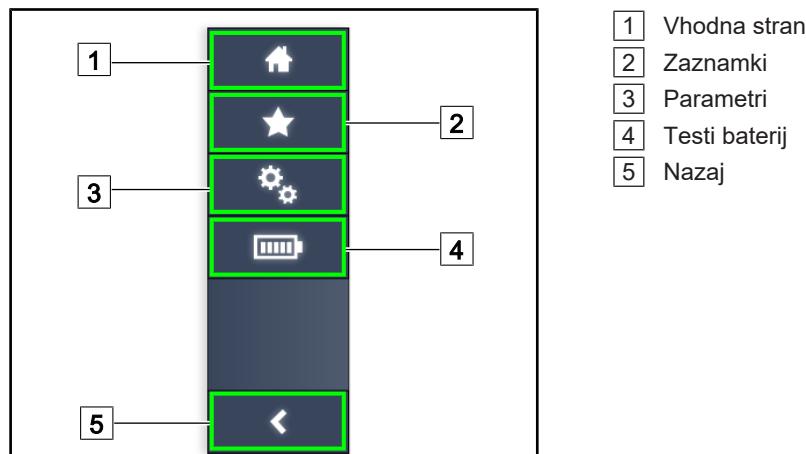

Sl. 35: Menijska vrstica na zaslono na dotik

Št.	Ime	Možna dejanja
1	S strani dostopate do ukazov in informacij.	Pritisnite na Vhodna stran , da odprete vhodno stran.
2	Zaznamki, ki ji določi uporabnik	Pritisnite na Zaznamki , da dostopite do strani prednastavitev.
3	Nastavljive nastavitev in podatki o konfiguracijah	Pritisnite na Parametri , da dostopite do strani nastavitev in podatkov o konfiguracijah.
4	Testi baterij	Pritisnite na Testi baterij , da dostopite do strani za preizkuse delovanja v sili.
5	Nazaj	Pritisnite na Nazaj , da se vrnete na prejšnji zaslon.

Tab. 11: Vrstica stanja na zaslono na dotik


4 Uporaba

4.1 Dnevni pregledi




NAPOTEK


Pravilno uporabo zagotovite tako, da serviser vsak dan proizvod pregleda s prostim očesom in ga preizkusi. Priporočamo, da se vodi evidenca rezultatov pregleda po datumu in s podpisom serviserja, ki je pregled opravil.

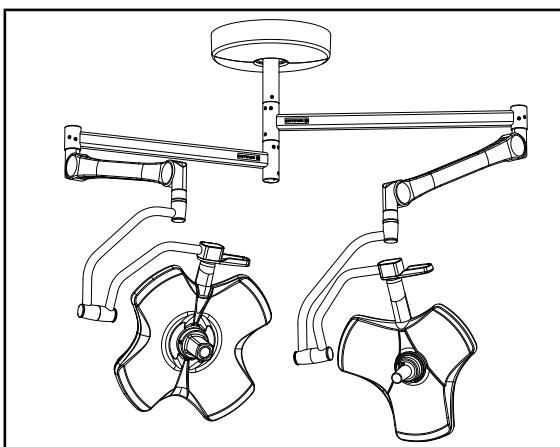

Sl. 36: Celovitost naprave

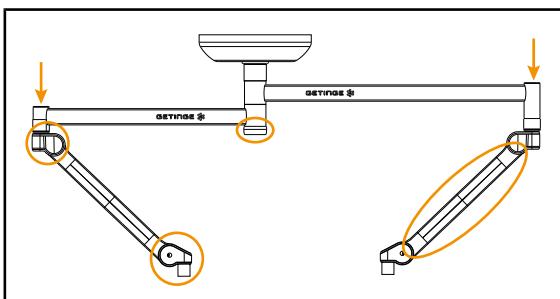

Sl. 37: Pokrovi za viseče dele

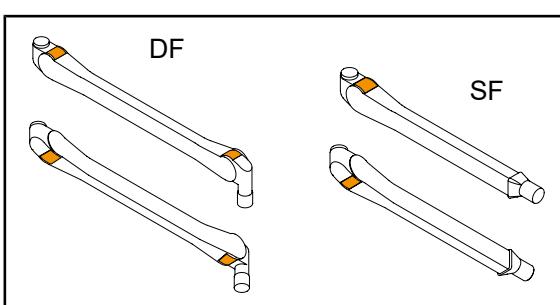

Sl. 38: Kovinski jezički vzmetnih rok

Celovitost naprave


1. Preglejte in potrdite, da naprava ni prestregla udarca in da ni uničena.
2. Preglejte in potrdite, da naprava pravilno sveti in da ni poškodovan barvni premaz.
3. Če odkrijete poškodb, pokličite servis.

Pokrovi za viseče dele


1. Preglejte in potrdite, da so pokrovi vzmetnih rok na pravem mestu in v dobrem stanju
2. Preglejte in potrdite, da so pokrovi elementov za obešanje na pravem mestu in v dobrem stanju, tudi tistih pod središčno osjo.
3. Če odkrijete poškodb, pokličite servis.

Kovinski jezički vzmetnih rok


1. Preglejte in potrdite, da so kovinski jezički vzmetnih rok na svojem mestu.
2. Če odkrijete poškodb, pokličite servis.

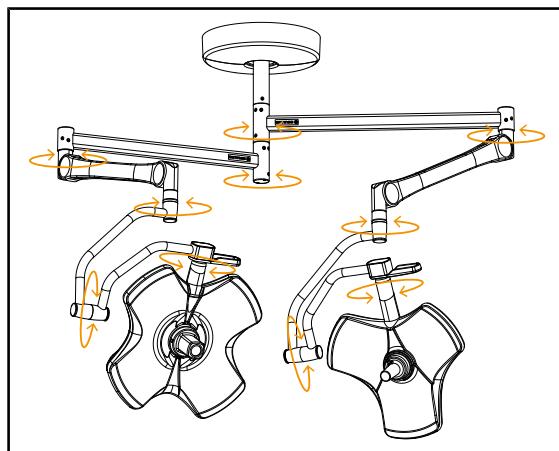

Sl. 39: Stabilnost/odklon naprave.

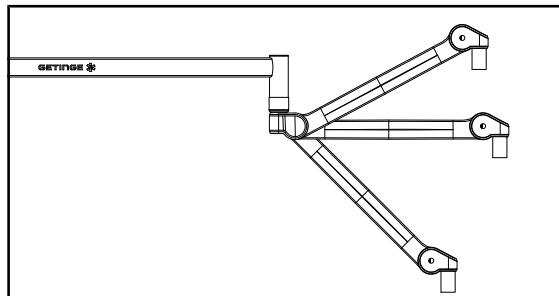

Sl. 40: Vzdrževanje vzemetne roke

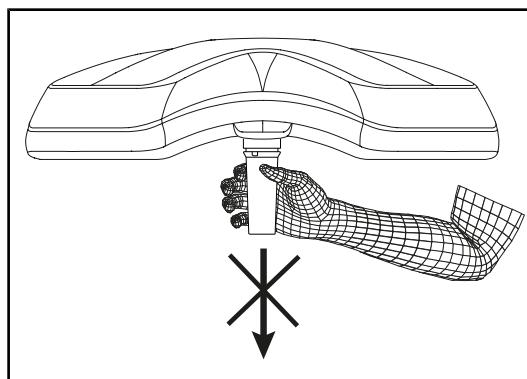

Sl. 41: Nosilec sterilizabilnih ročic

Stabilnost/odklon naprave.


1. Naredite več premikov naprave, da spustite viseče roke, vzemetne roke in kupole.
 - Sestav naprave se mora enostavno in neovirana premikati.
2. Napravo prestavite v več položajev.
 - Sestav naprave mora ostati na mestu, ne da bi se prestavil v predhodno nastavljen položaj.
3. Če odkrijete poškodb, pokličite servis.

Vzdrževanje vzemetne roke

1. Prestavite vzemetno roko do konca giba dol, nato vodoravno in na koncu do konca giba gor.
2. Vzemetna ruka mora ostati na mestu v vseh položajih.
3. Če odkrijete poškodb, pokličite servis.

Nosilec sterilizabilnih ročic


1. Odstranite nosilec za ročico na mestu.
 - Odstranitev ne sme biti ovirana ali otežena.
2. Znova namestite nosilec za ročico na ku polo.
 - Namestitev ne sme biti ovirana ali otežena, pravilno namestite nosilec za ročico.

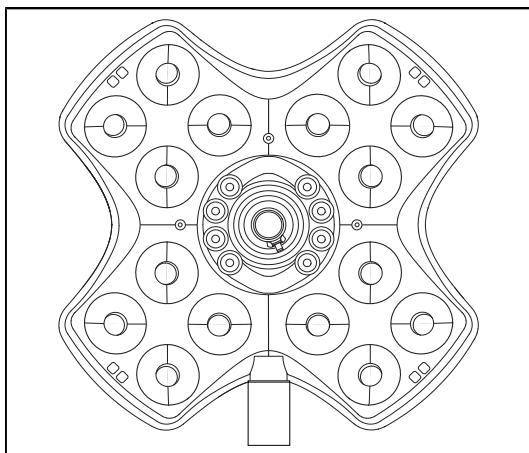

Sl. 42: Delovanje sijalk LED



Sl. 43: Skladnost tipkovnice

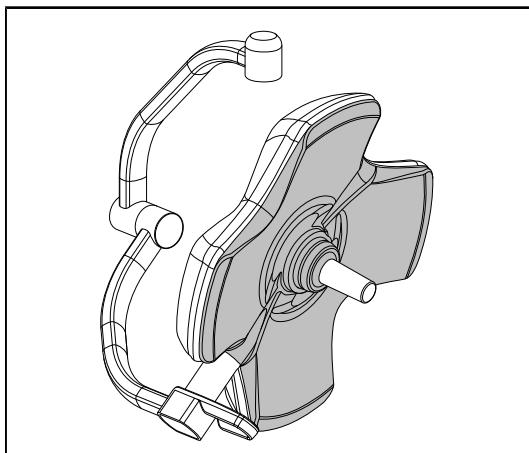

Sl. 44: Spodnja stran kupole

Delovanje sijalk LED


1. Vključite svetilko tako, da pritisnite na tipko vkl./izk. na tipkovnici kupole.
2. Preizkusite, ali se kupola pravilno odziva na ukaze s tipkovnice, tako, da prestavite intenzivnost osvetljenosti s kupole z najmanjše (min.) na največjo (maks.) vrednost.
➤ Svetilnost je odvisna od izbrane ravni.
3. Vključite svetilko tako, da izberete največji premer snopa (pri katerem zasvetijo vse LED) Nastaviti svetilke [► Stran 52].
4. Preizkusite, ali delujejo vse LED.

Skladnost tipkovnice


1. Preglejte, ali je tipkovnica na pravem mestu na kupoli.
2. Preverite stanje tipkovnice tako, da jo pregledate s prostim očesom.
3. Če odkrijete poškodb, pokličite servis.

Spodnja stran kupole


1. Pregledati spodnjo stran, ali je uničena (praske, umazanija itd.)
2. Če odkrijete poškodb, pokličite servis.

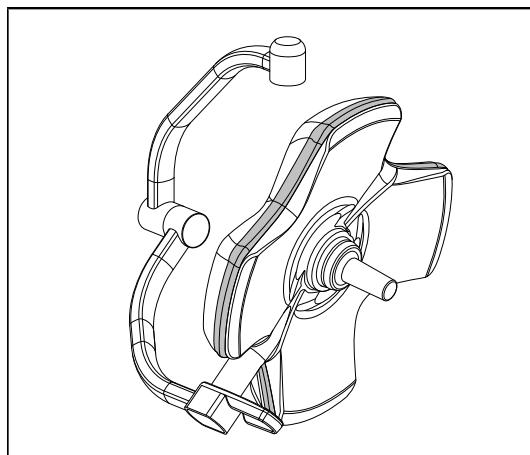

Sl. 45: Skladnost zunanjega spoja

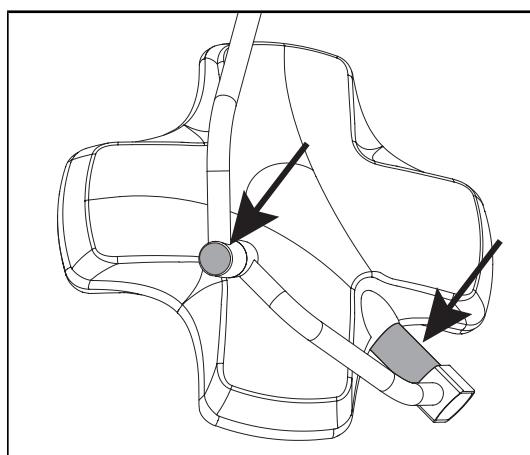

Sl. 46: Celovitost osnega spoja kupole in pokrova vilic

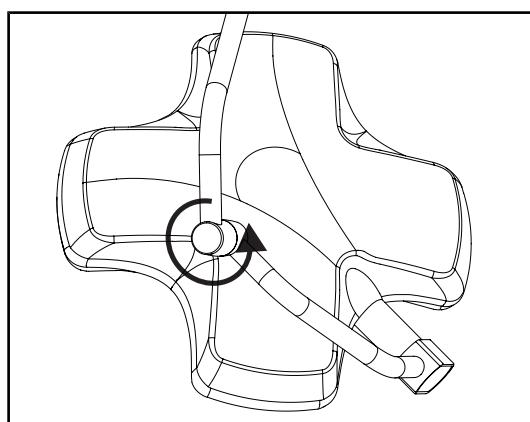

Sl. 47: Celovitost vmesnih vilic

Skladnost zunanjega spoja


1. Preglejte in potrdite, da je zunanji spoj na pravem mestu.
2. Preglejte s prostim očesom, da je spoj v dobrem stanju.
3. Če odkrijete poškodbe, pokličite servis.

Celovitost osnega spoja kupole in pokrova vilic


1. Preglejte in potrdite, da sta osni spoj kupole in pokrov vilic dobro postavljena.
2. Preglejte in potrdite, da sta osni spoj kupole in pokrov vilic v dobrem stanju.
3. Če odkrijete poškodbe, pokličite servis.

Celovitost vmesnih vilic

1. Preizkusite, če se vmesne vilice pravilno vrtijo.
2. Preizkusite, če vilice zdrsavajo.
3. Če odkrijete poškodbe, pokličite servis.

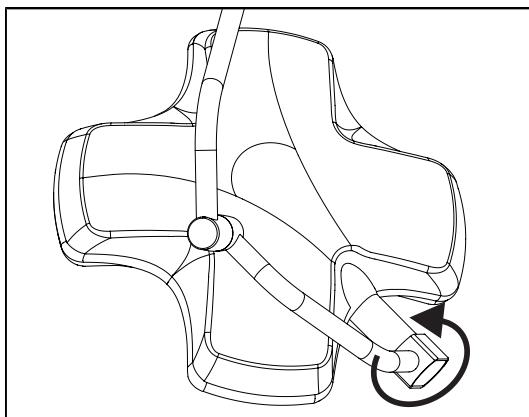


Sl. 48: Skladnost kupole

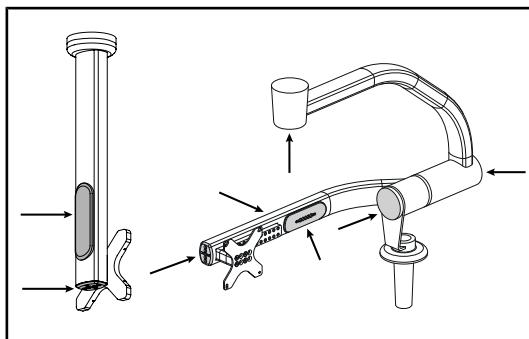

Sl. 49: Varovalni elementi nosilca zaslona

Za osebje, odgovorno za sterilizacijo

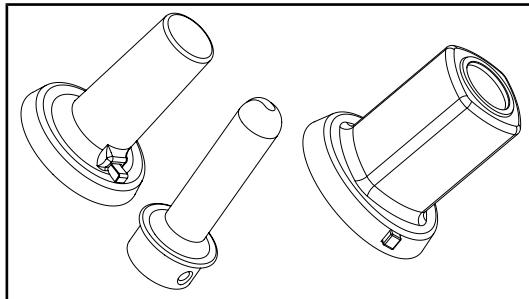

Sl. 50: Sterilizabilne ročice



NAPOTEK

Če je naprava opremljena s sistemom pomožnega napajanja, preizkusite samodejni preklop na to napajanje. Če je tipkovnica nadzorne plošče na steni, izključite kupole; ko zasveti gumb za zagon testa, lahko zaženete test. Če je tipkovnica na zaslonu na dotik, se v vrstici stanja označi ikona baterije.

Skladnost kupole

1. Preglejte, ali so kupole morda poškodovane (barva, udarci, uničenje).
2. Preizkusite, če se kupola pravilno vrti.
3. Preizkusite, če kupolo zdrsava.
4. Če odkrijete poškodb, pokličite servis.

Silikonski pokrovi in kabelske uvodnice za nosilec zaslona

1. Preglejte in potrdite, da so silikonski varovalni deli na nosilcu zaslona na pravem mestu in v dobrem stanju.
2. Preglejte in potrdite, da so kabelske uvodnice na nosilcu zaslona na pravem mestu in v dobrem stanju.

Celovitost sterilizabilne ročice

1. Po sterilizaciji preglejte in potrdite, da ročica ni razpokana ali umazana.
2. Pri ročicah tipa PSX po sterilizaciji preglejte in potrdite, da mehanizem deluje.



Sl. 51: Test samodejnega preklopa na pomožno napajanje (samo če je povezan sistem pomožnega napajanja)


Test samodejnega preklopa na pomožno napajanje (samo če je povezan sistem pomožnega napajanja)

1. Test samodejnega preklopa na pomožno napajanje zaženete na tipkovnici stenske nadzorne plošče (Preko stenske upravljalne tipkovnice (samo na VCSII) [► Stran 97]) ali preko zaslona na dotik (Z zaslona na dotik [► Stran 98]).
2. Če test ne uspe, pokličite servis.

4.2 Upravljanje svetilke

4.2.1 Vključiti/izključiti svetilke

4.2.1.1 Na tipkovnici nadzorne plošče na kupoli ali steni

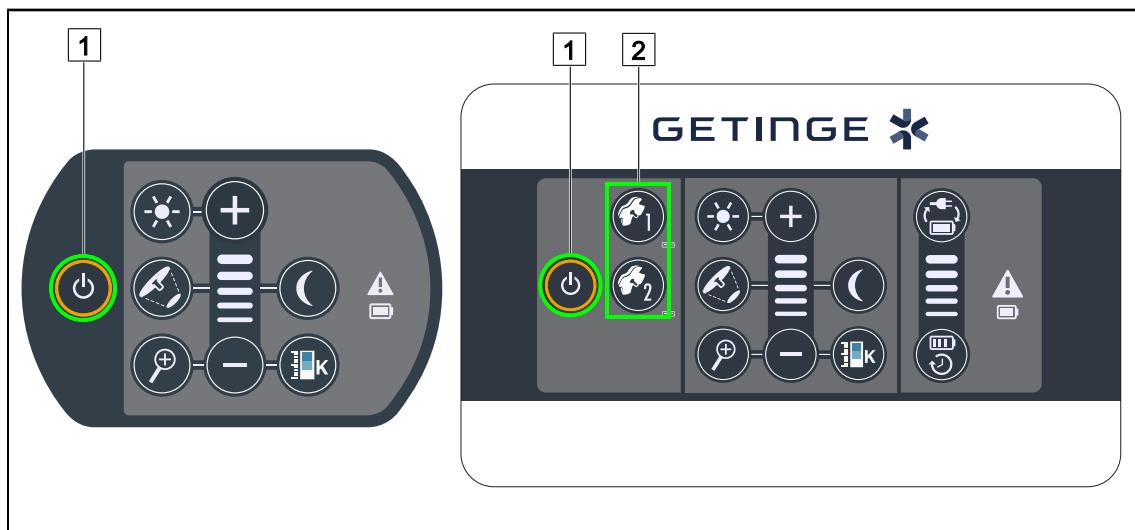

Sl. 52: Vključiti/izključiti osvetljevanje preko tipkovnice

Vključiti osvetljevanje kupole s kupolo

1. Če je na voljo stenska tipkovnica, pritisnite na tipko kupole [2], tako da sveti, dokler je gumb osvetljen v ozadju.
2. Pritisnite na Zagon/zaustavitev [1]; kupola zasveti.
 - LED zasvetijo ena za drugo; raven osvetljenosti je enaka nastavljeni vrednosti pred zadnjim izključitvijo.

Vključiti sistem osvetljevanja (samo preko stenske tipkovnice)

1. Pritisnite na **Zagon/zaustavitev** **[1]**.

➤ LED vse kupol zasvetijo ena za drugo; stopnja osvetljenosti je enaka nastavljeni vrednosti pred zadnjo izključitvijo.

Izklučiti osvetljevanje preko tipkovnice kupole

1. Pritisnjte na **Zagon/zaustavitev** **[1]**, dokler se tipkovica ne izključi.

➤ LED kupole se izključijo ena za drugo, ko spustite gumb.


Izklučiti osvetljevanje preko stenske tipkovnice

1. Pritisnjte na tipko kupole **[2]**, dokler sveti ozadje tipke.

2. Pritisnjte na **Zagon/zaustavitev** **[1]**, dokler se ne izključi tipka kupole.

➤ LED kupole se izključijo ena za drugo, ko spustite gumb.

4.2.1.2 Z zaslona na dotik

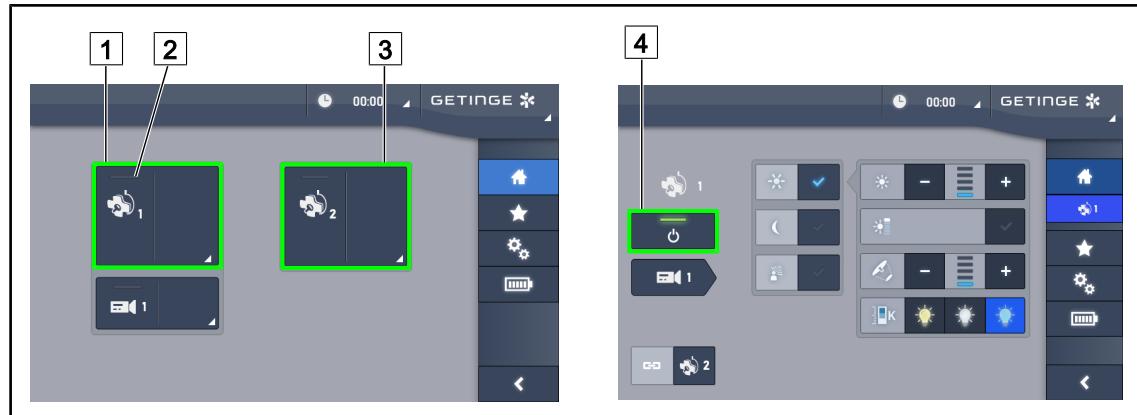

Sl. 53: Vhodna stran

Vključitev svetilk


- Pritisnite na **Aktivno območje kamere 1** [1].
 - **Signalna ikona za zagon** [2] se vključi, zasveti kupola 1.
- Pritisnite na **Aktivno območje kupole 2** [3], če je na voljo.
 - Zasvetijo vse svetilke.

Izklopitev svetilk

- Pritisnite na **Aktivno območje kamere 1** [1].
 - Odpre se krmilna stran za kupolo
- Pritisnite na **Vkl./izk (ON/OFF) kupole** [4].
 - Kupola 1 se izklopi, prav tako **Signalna ikona zagona** kupole 1.
- Naredite enako za vse ostale vključene kupole.
 - Vse svetilke se izklopijo.

4.2.2 Nastaviti svetilke

4.2.2.1 Na tipkovnici nadzorne plošče na kupoli ali steni

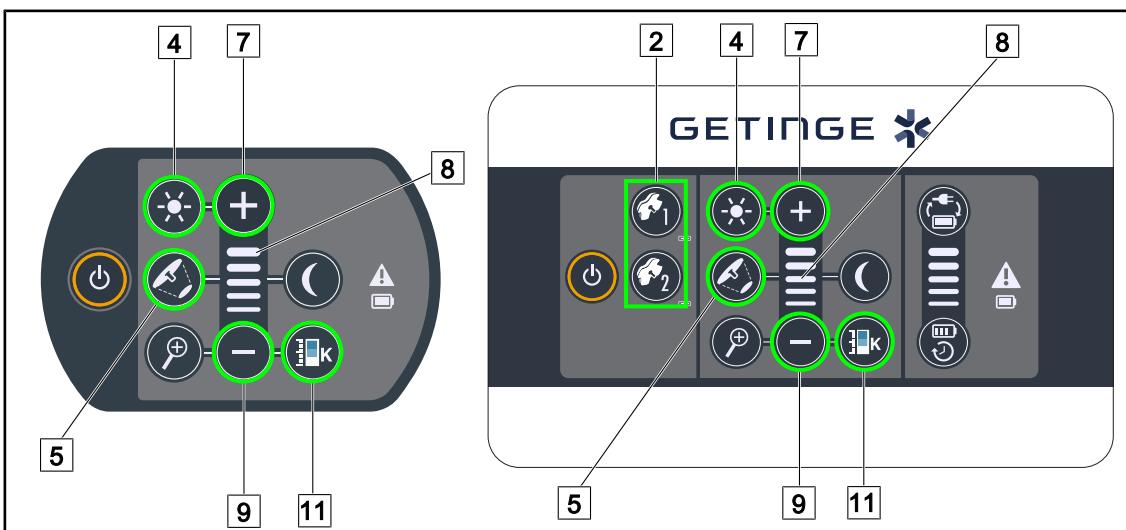

Sl. 54: Nastaviti svetilko preko upravljalnih tipkovnic

Če je na voljo stenska upravljalna tipkovnica, najprej izberite kupolo **2**, na kateri želite spremi-njati nastavitev.

Prilagoditi svetilnost

1. Pritisnite na **Standardna/ambientalna osvetljenost** **4**.
 - Zasveti ozadje tipke na upravljalni tipkovnici.
2. Pritiskajte na **Plus** **7**, da povečate svetilnost kupole ali kupol.
3. Pritiskajte na **Minus** **9**, da zmanjšate svetilnost kupole ali kupol.

Vključiti/izklučiti način večanja „Boost“

1. Ko je svetilnost 100 %, pritisnite in zadržite **Plus** **7**, dokler se začne utripati zadnja signalna LED stopnje **8**.
 - Način večanja „Boost“ je zdaj vključen.
2. Način večanja „Boost“ izklučite tako, da pritisnete na **Minu** **9**.
 - Način večanja „Boost“ se izkluči.


Nastaviti premer snopa

1. Pritiskajte na **Variacija premera snopa** **5**.
 - Zasveti ozadje tipke na upravljalni tipkovnici.
2. Pritiskajte na **Plus** **7**, da povečate premer snopa kupole.
3. Pritiskajte na **Minus** **9**, da zmanjšate premer snopa kupole.

Nastaviti barvno temperaturo

1. Pritisnite na **Barvna temperaturo** **11**.
 - Zasveti ozadje tipke na upravljalni tipkovnici.
2. Pritiskajte na **Plus** **7**, da izberete hladnejšo barvno temperaturo.
3. Pritiskajte na **Minus** **9**, da izberete toplejšo barvno temperaturo.

4.2.2.2 Z zaslona na dotik

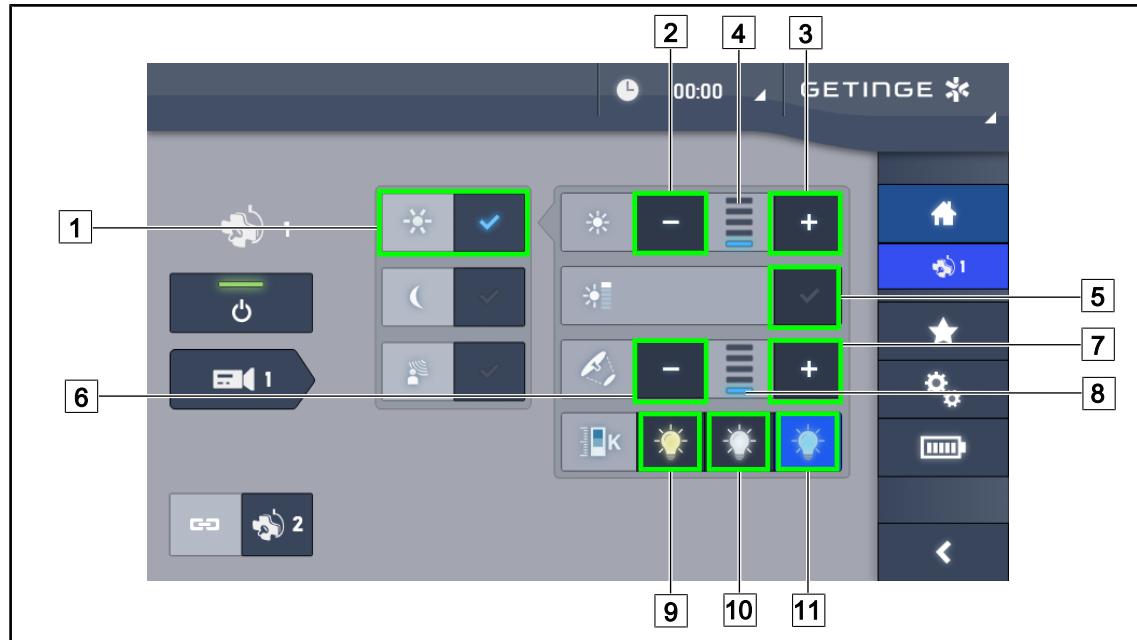

Sl. 55: Nastaviti osvetljenost preko zaslona na dotik

Prilagoditi svetilnost kupole ali kупол

- Odprite stran kupole, pritisnite na **Način standardna osvetljenost** [1].
➤ Tipka zasveti modro.
- Pritisnjte na **Povečaj intenzivnost** [3], da povečate svetilnost [4].
- Pritisnjte na **Zmanjšaj intenzivnost** [2], da zmanjšate svetilnost [4].

Vključiti način večanja „Boost“

- Odprite stran kupole, pritisnite na **Način standardna osvetljenost** [1].
➤ Tipka zasveti modro.
- Pritisnite na **Način večanja „Boost“** [5].
➤ Tipka zasveti modro, utripati začne zadnja vrstica kazalnika stopnje osvetlitve [4]. Način večanja „Boost“ je vključen na določeni kupoli ali kupolah.

Nastaviti premer snopa kupole ali kупол.


- Odprite stran kupole, pritisnite na **Način standardna osvetljenost** [1].
➤ Tipka zasveti modro.
- Pritisnjte na **Povečaj premer** [7], da povečate premer snopa [8].
- Pritisnjte na **Zmanjšaj premer** [6], da zmanjšate premer snopa [8].

Nastaviti barvno temperaturo

- V območju kupole pritisnite na [9] [10] ali [11], tako da nastavite želeno barvno temperaturo.
➤ Tipka zasveti modro, sistem uporabi izbrano barvno temperaturo na kupoli.

4.2.3 Ambientalne svetilke

4.2.3.1 Na tipkovnici nadzorne plošče na kupoli ali steni

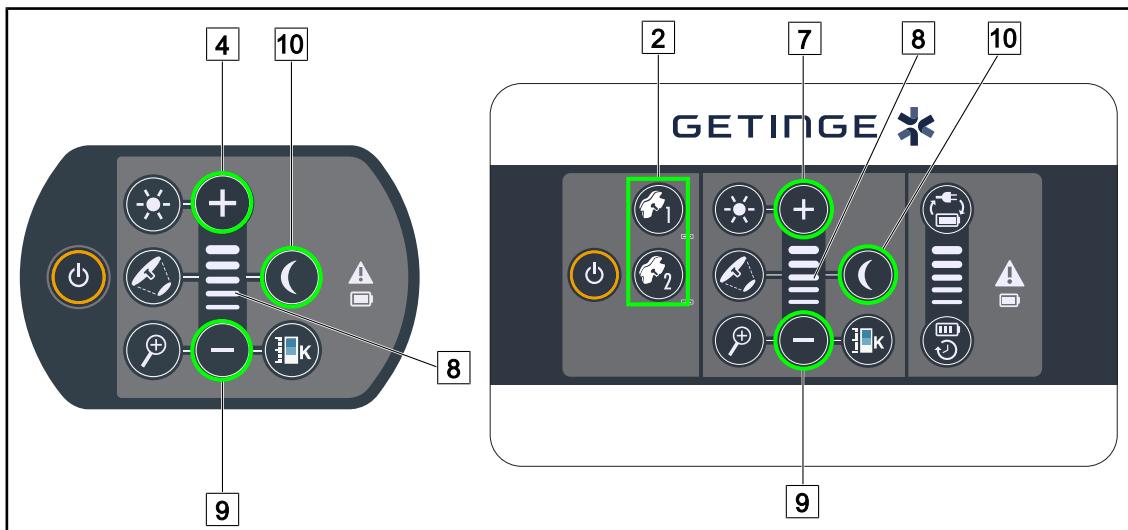


Sl. 56: Ambientalna osvetljenost preko tipkovnic

Če je na voljo stenska upravljalna tipkovnica, najprej izberite kupolo [2], na kateri želite spremi-njati nastavitev.

Nastaviti stopnjo ambientalne osvetljenosti

1. Izberite kupolo [2].
2. Pritisnite na **Ambientalna osvetljenost** [10].
 - Ambientalno osvetljevanje se vključi in na tipkovnici zasveti ozadje tipke.
3. Pritiskajte na **Plus** [7], da povečate svetilnost kupole ali kupol [8].
4. Pritiskajte na **Minus** [9], da zmanjšate svetilnost kupole ali kupol [8].

4.2.3.2 Z zaslona na dotik

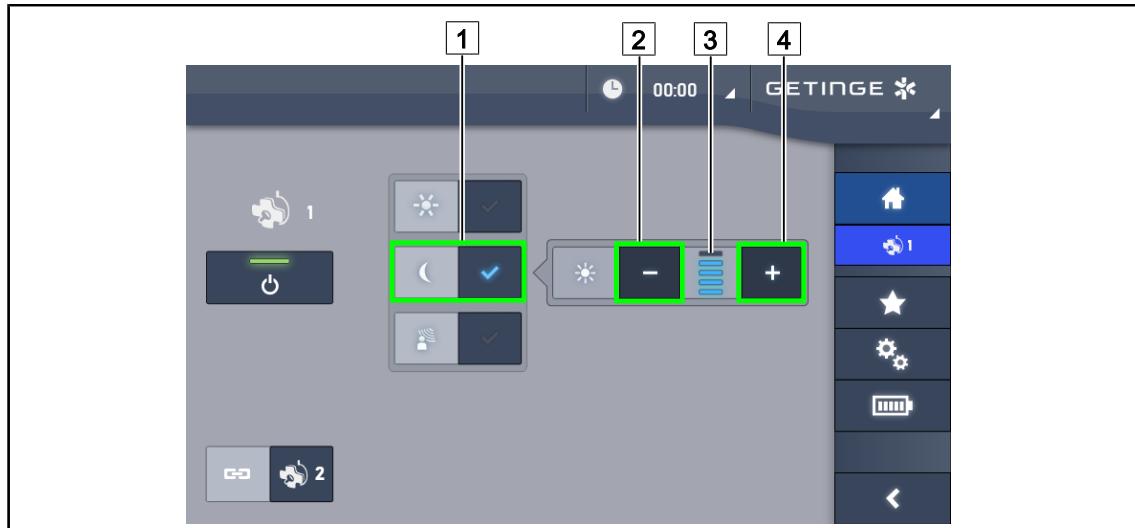

Sl. 57: Ambientalne osvetljenost prek zaslona na dotik

Vključiti način ambientalne osvetljenosti


1. Odprite stran kupole, pritisnite na **Standardna/ambientalna osvetljenost** [1].
➤ Tipka zasveti modro.

Prilagoditi svetilnost ambientalnih svetilk.

1. Odprite stran kupole, pritisnite na **Standardna/ambientalna osvetljenost** [1].
➤ Tipka zasveti modro.
2. Pritisnjte na **plus** [4], da povečate osvetljenost kupole ali kupol [3].
3. Pritisnjte na **minus** [2], da zmanjšate osvetljenost kupole ali kupol [3].

4.2.4 AIM (samo na Volista VSTII)

Samo z zasloni na dotik

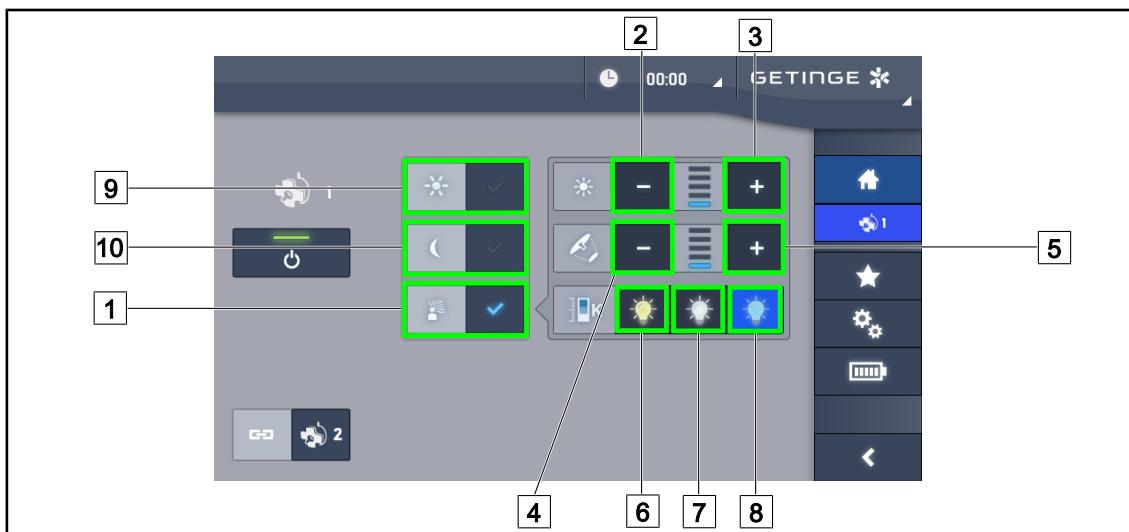

Sl. 58: Stran AIM

Vključiti/izklučiti način AIM

- Odprite stran kupole, pritisnite na **Način AIM** [1].
 - Tipka zasveti modro, vključi se način AIM na določeni kupoli ali kupolah.
- Funkcijo AIM izklučite tako, da pritisnите na **Način standardne osvetljenosti** [9] ali **Način prostorske osvetljenosti** [10].
 - Tipka ugasne, način AIM se izkluči na kupoli ali kupolah.

Prilagoditi svetilnost z AIM

- Pritiskajte na **Povečaj intenzivnost** [3], da povečate svetilnost kupole ali kupol.
- Pritiskajte na **Zmanjšaj intenzivnost** [2], da zmanjšate svetilnost kupole ali kupol.



NAPOTEK

Način večanja „Boost“ ni na voljo, ko je vključen način AIM; svetilke imajo 5 ravni osvetljenosti.

Nastaviti premer snopa z AIM

- Pritiskajte na **Povečaj premer** [5], da povečate premer snopa kupole ali kupol.
- Pritiskajte na **Zmanjšaj premer** [4], da zmanjšate premer snopa kupole ali kupol.

Prilagodite barvno temperaturo (za VSTII opremljen s to izbiro)

- Vključite LMD, pritisnite na **3900 K** [6], **4500 K** [7] ali **5100 K** [8], da nastavite želeno barvno temperaturo.
 - Tipka zasveti modro, sistem uporabi izbrano barvno temperatura na kupoli ali kupolah.

4.2.5 Volista VisioNIR* (samo na Volista VSTII)



Sl. 59: VisioNIR

Vključiti/izklučiti funkcijo večanja VisioNIR

1. Pritisnite na **Način večanja Svetilke** [1].
2. Pritisnite na **VisioNIR** [2], da vključite funkcijo večanja VisioNIR.
 - Tipka zasveti modro.
3. Pritisnite na **VisioNIR** [2], da izklučite funkcijo večanja VisioNIR.




NAPOTEK

Funkcija večanja VisioNIR Volista se avtomatično uporabi za vse kupole v konfiguraciji. Kupole sistem avtomatično nastavi na barvno temperaturo 5100 K in izkluči LED v središčnem obroču na Volista 600.

4.2.6 Sinhronizacija kupol

4.2.6.1 S tipkovnico stenske nadzorne plošče

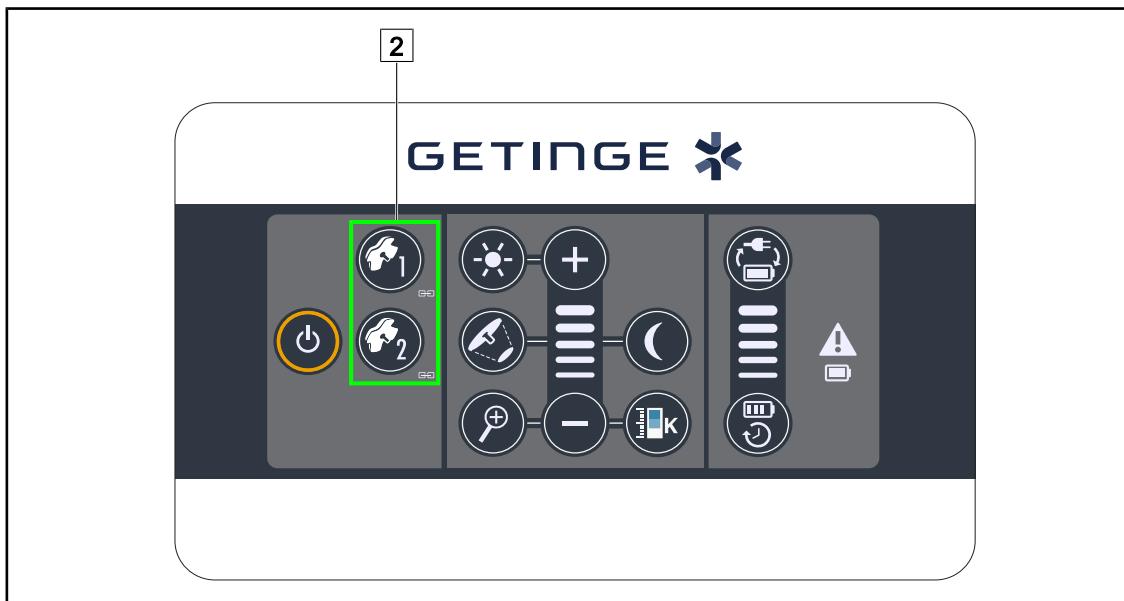

Sl. 60: Sinhroniziranje kupole preko stenske tipkovnice

Sinhronizirati/desinhronizirati kupole

1. Nastavite eno od kupol na želene parametre.
2. Pritisnjte na tipko kupole **[2]**, ki jo želite sinhronizirati, dokler ne zasveti ozadje tipke.
 - Kupole so sinhronizirane; vsaka sprememba na eni se zgodi tudi na drugi.
3. Pritisnjte na tipko kupole **[2]**, za katero želite odpraviti sinhronizacijo, dokler se ne izključi osvetlitev tipke v ozadju, ali spremenite stanje kupole preko lokalne tipkovnice, tako da odpravite sinhronizacijo želene kupole.
 - Kupole niso več sinhronizirane.



NAPOTEK

Poseben primer: Kupole sinhronizirate v načinu ambientalne osvetljenosti tako, da pred sinhroniziranjem vključite način na teh kupolah.

4.2.6.2 Z zaslona na dotik



Sl. 61: Sinhronizirati kupole


1. Nastavite eno od kupol [1] na želene parametre.
2. Pritisnite na **Sinhroniziraj** [2].
 - Kupole so sinhronizirane; vse spremembe na eni se zgodijo tudi na drugih kupolah.
3. Znova pritisnite na **Sinhroniziraj** [2], da desinhronizirate kupole.
 - Kupole se desinhronizirajo.

**NAPOTEK**

Posebni primer: Če želite kupole sinhronizirati v načinu ambientalne osvetlitve, vključite način na teh svetilkah pred sinhroniziranjem.

4.2.7

LMD (samo na Volista VSTII z zaslonom na dotik)

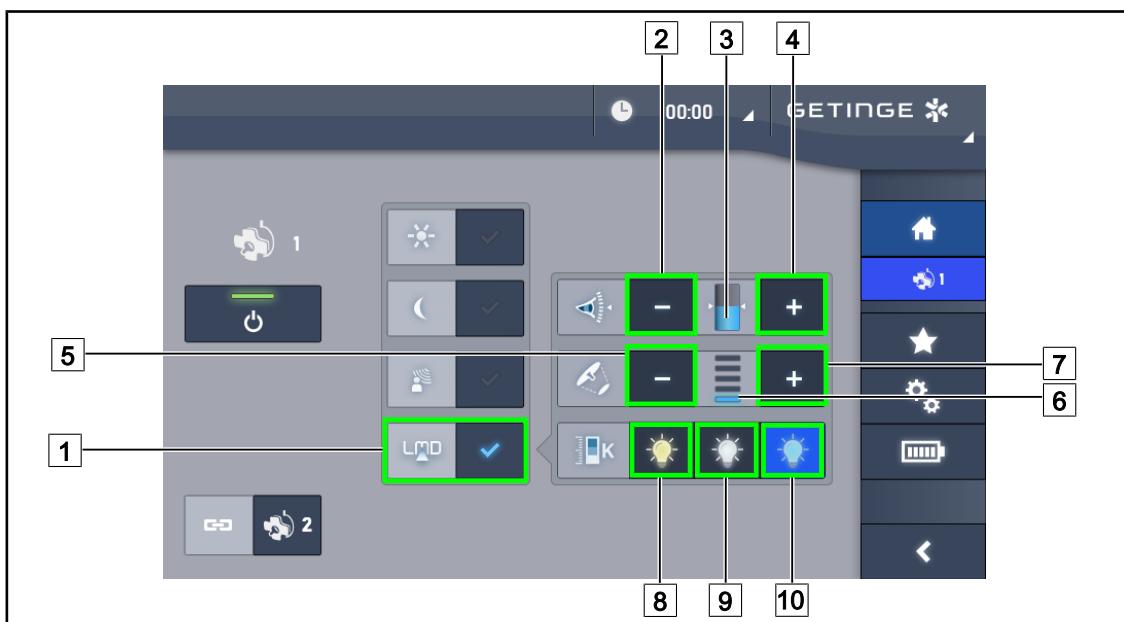

Sl. 62: Stran LMD

Vključiti/izklujučiti način LMD

1. Nastavite želeno svetilnost po meri potreb kirurškega osebja.
2. Pritisnite na **LMD** [1].
 - Gumb je omogočen v modri barvi, LMD pa je omogočen na zadevni kupoli in kupole se samodejno sinhronizirajo.
3. Vključen način LMD izklujučite tako, da pritisnите na **LMD** [1].
 - Tipka ugasne, način LMD se izkluči na določeni kupoli ali kupolah.

Nastaviti referenčno vrednost svetilnosti

1. Pritisnjte **Povečaj svetilnost** [4], da povečate svetilnost kupole ali kupol [3].
2. Pritisnjte na **Zmanjšaj svetilnost** [2], da zmanjšate svetilnost kupole ali kupol [3].

Nastaviti premer snopa z LMD

1. Pritisnjte na **Povečaj premer** [7], da povečate premer snopa kupole ali kupol [6].
2. Pritisnjte na **Zmanjšaj premer** [5], da zmanjšate premer snopa kupole ali kupol [6].

Nastaviti barvno temperaturo, ko je vključen LMD

1. Vključite LMD, pritisnite na **3900 K** [8], **4500 K** [9] ali **5100 K** [10], da nastavite želeno barvno temperaturo.
 - Tipka zasveti modro; na kupoli je nastavljena izbrana barvna temperatura.

**NAPOTEK**

Če je kupola nastavljena na največjo dovoljeno vrednost, svetilnosti ni mogoče povečati; tipka **plus** [4] je siva in neaktivna.

Če je kupola nastavljena na najmanjšo dovoljeno vrednost, svetilnosti ni mogoče zmanjšati; tipka **minus** [2] je siva in neaktivna.


Indikator ravni svetilnosti [5] podpira nadzor in ohranjanje shranjene vrednosti svetilnosti:

	Nastavljena vrednost je dosežena.
	Kupola je na najnižji vrednosti in svetilnost ostane večja od nastavljene vrednosti (oranžni merilec nad referenčno vrednostjo).
	Kupola je na najvišji vrednosti in oddana svetloba ostane manjša od nastavljene vrednosti (oranžni merilec pod referenčno vrednostjo).

Tab. 12: Ravni svetilnosti

4.2.8 Zaznamki (samo z zaslonom na dotik)

4.2.8.1 Izbrati/shraniti med zaznamke

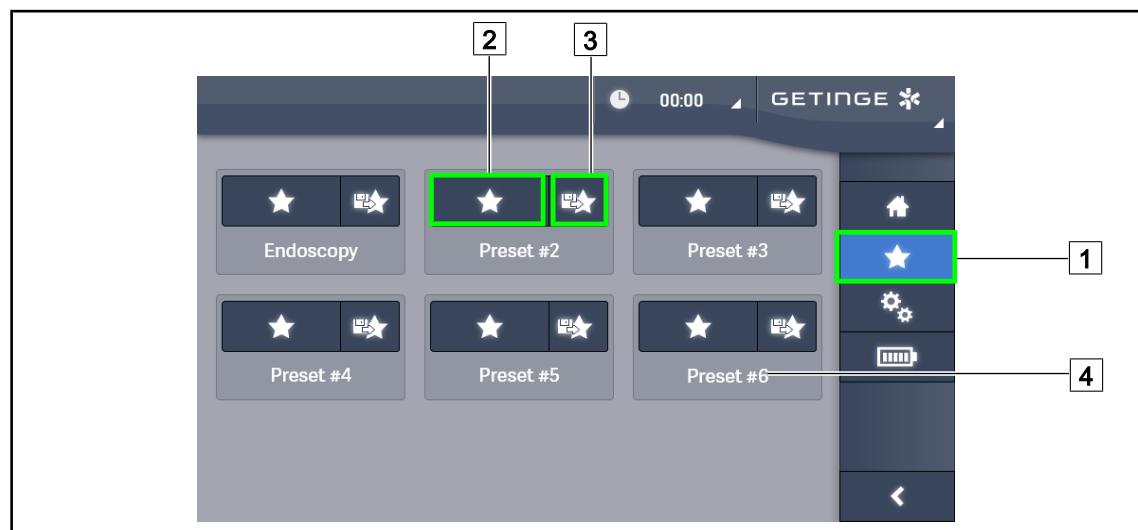

Sl. 63: Stran zaznamkov

Uporabiti zaznamke

1. Pritisnite na **Zaznamki** [1], da dostopite do strani.
 - Stran zaznamkov se odpre na zaslonu.
2. Med šestimi shranjenimi zaznamki pritisnite na **Uporabi zaznamek** [2] po imenu izbranega zaznamka [4].
 - Sistem uporabi izbran zaznamek.



Sl. 64: Shraniti zaznamke

Shraniti zaznamek

1. Nastavite izbrane parametre osvetlitve za zaznamek.
2. Pritisnite na **Shrani zaznamke** [3].
 - Odpre se okno za vnos zaznamka (glej zgoraj), v katerem je označen izbran zaznamek [5].
3. Vnesite ime zaznamka preko tipkovnice [8].
4. Pritisnite na **Shrani zaznamke** [7], da ga shranite. Spremembe lahko kadar koli prekličete tako, da pritisnите **Prekliči spremembo** [6].
 - Odpre se pojavno okno, ki potrdi, da so prednastavite shranjene, nato znova odpre stran zaznamkov

4.2.8.2 Tovarniške prednastavitev

Ob odpremi iz tovarne so prednastavljeni naslednji profili:

Aplikacije	Osvetljenost	Premer snopa	Barvna temperatura
Urologija/ginekologija	80 %	Majhen	4.500
Laparotomija	100 %	Velik	3.900
Ortopedija	60 %	Srednji	5.100
ORL	60 %	Majhen	4.500
Plastična kirurgija	100 %	Majhen	5.100
Srčna kirurgija	100 %	Majhen	3.900

Tab. 13: Prednastavljeni zaznamki kupol ob odpremi iz tovarne

Aplikacije	Zum	WB (čb)	Kontrast
Laparotomija	50 %	Avtom.	Visoko
Ortopedija	50 %	Avtom.	Sred.
Plastična kirurgija	20 %	Avtom.	Standardno
Srčna kirurgija	50 %	Avtom.	Visoko

Tab. 14: Tovarniško prednastavljeni zaznamki kamere

4.3 Postaviti svetilko

4.3.1 Montaža sterilizabilne ročice

OPOZORILO!



Tveganje prenosa okužbe

Z ročice, ki se lahko sterilizira in ki ni v dobrem stanju, lahko odpadejo delci v sterilno okolje.

Po vsaki sterilizaciji in pred vsako ponovno uporabo preglejte ročico, če je morda razpokana.

OPOZORILO!




Tveganje prenosa okužbe

Te ročice so edini elementi opreme, ki se lahko sterilizirajo. Vsak stik sterilne ekipe z drugo površino pomeni tveganje prenosa okužbe. Vsak stik nesterilnega osebja z ročicami, ki se lahko sterilizirajo, pomeni tveganje prenosa okužbe.

Med kirurškim posegom mora sterilna ekipa upravljati opremo samo z ročicami, ki se lahko sterilizirajo. Na ročicah HLX gumb za zaklepanje ni sterilen. Nesterilno osebje se ne sme dotakniti ročic, ki se lahko sterilizirajo.


4.3.1.1 Namestite in odstranite sterilizabilno ročico STG PSX 01

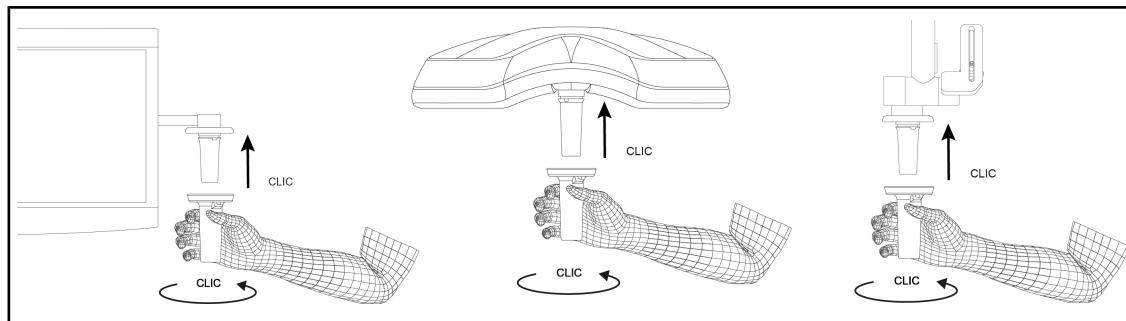

Sl. 65: Namestite sterilizabilno ročico STG PSX 01

Namestite sterilizabilno ročico STG PSX 01

1. Preglejte ročico, če je razpokana ali onesnažena.
2. Vstavite ročico v nosilec.
 - Zasliši se klik.
3. Obrnite ročico, dokler ne boste zaslišali drugega klika.
4. Preglejte oprijem ročice.
 - Ročica je zaklenjena na mesto in pripravljena za uporabo.

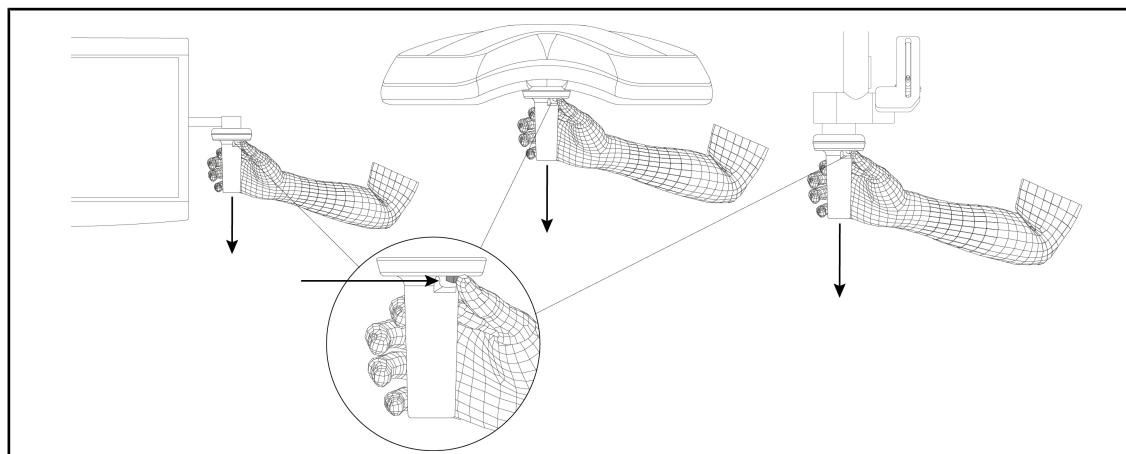


Sl. 66: Odstranite sterilizabilno ročico STG PSX 01

Odstranite sterilizabilno ročico STG PSX 01

1. Pritisnite na gumb za zaklepanje.
2. Odstranite ročico.


4.3.1.2 Namestite in odstranite sterilizabilno ročico STG HLX 01

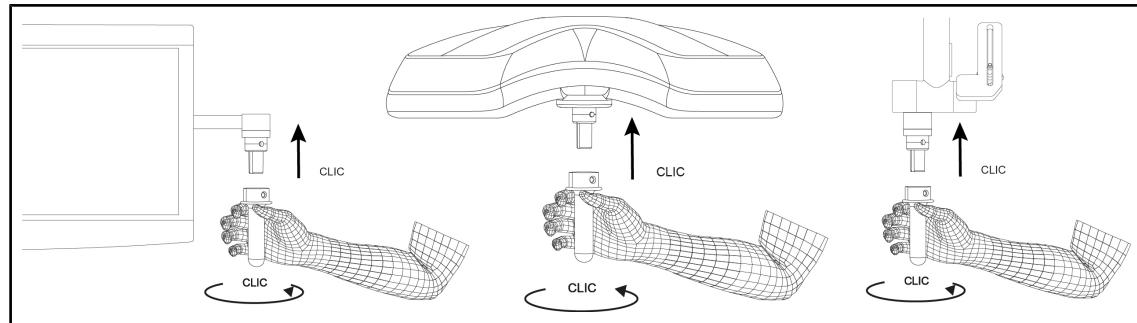

Sl. 67: Namestiti sterilizabilno ročico STG HLX 01

Namestiti sterilizabilno ročico STG HLX 01

1. Preglejte ročico, če je razpokana ali onesnažena.
2. Vstavite ročico v nosilec.
3. Zavrtite ročico do konca giba.
 - Gumb za zaklepanje skoči iz ohišja.
4. Preglejte oprijem ročice.
 - Ročica je zaklenjena na mesto in pripravljena za uporabo.

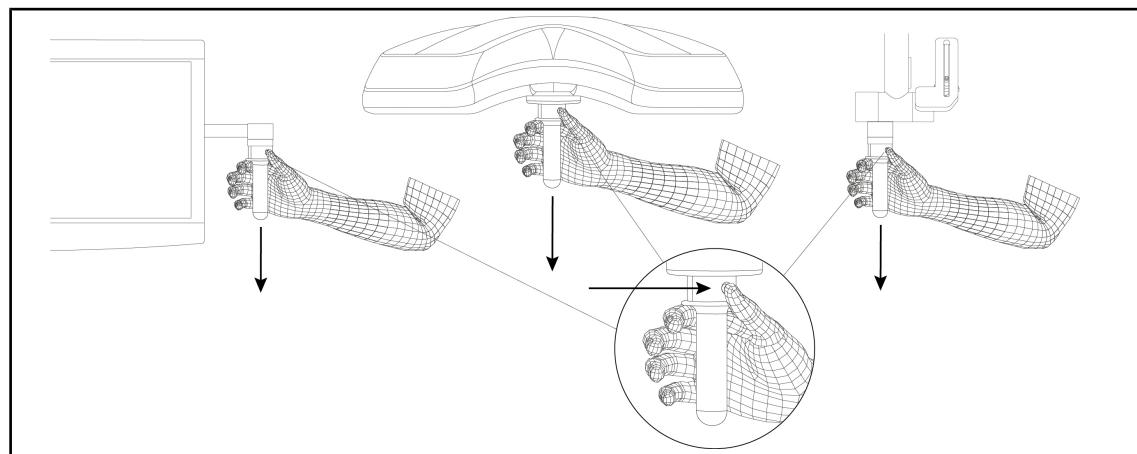


Sl. 68: Odstranite sterilizabilno ročico STG HLX 01

Odstranite sterilizabilno ročico STG HLX 01

1. Pritisnite na gumb za zaklepanje.
2. Odstranite ročico.

4.3.1.3 Namestiti in odstraniti ročico tipa DEVON®/DEROYAL®****NAPOTEK**


Glejte navodila, priložena k ročici tipa DEVON/DEROYAL.

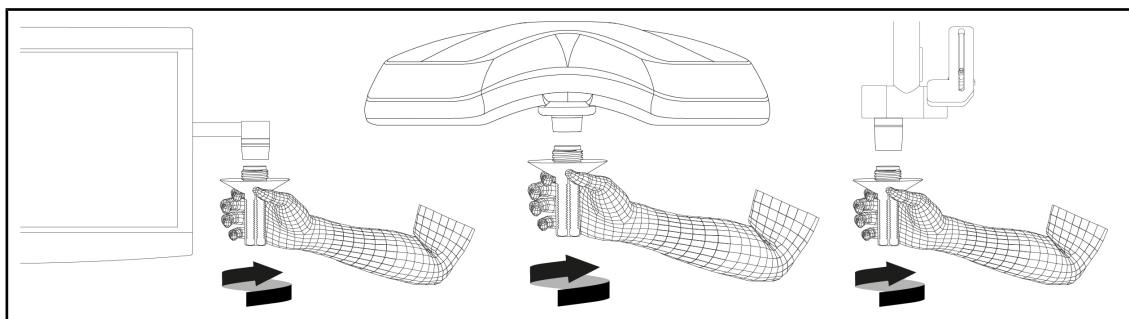

Sl. 69: Namestite zaskočno ročico tipa DEVON/DEROYAL

Namestite zaskočno ročico tipa DEVON/DEROYAL

1. Privijte ročico v nosilec do konca giba.
➤ Ročica je zdaj pripravljena za uporabo.

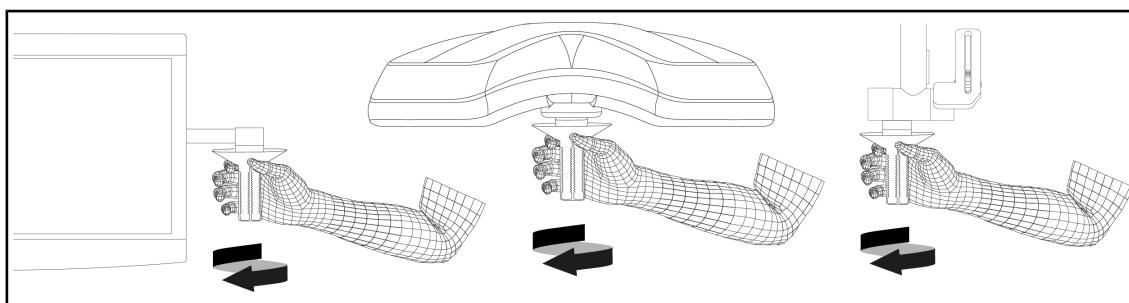


Sl. 70: Odstranite ročico tipa DEVON/DEROYAL

Odstranite ročico tipa DEVON/DEROYAL

1. Odvijte ročico z nosilca.


4.3.1.4 Namestiti in odstraniti sterilizabilno ročico STG PSX 01

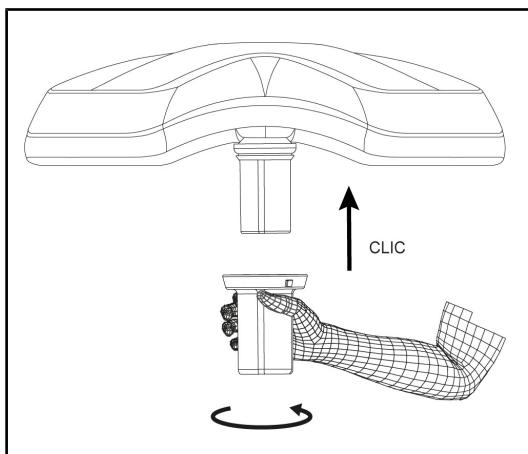

Sl. 71: Namestiti sterilizabilno ročico STG PSX VZ 01

Namestiti sterilizabilno ročico za kamero na kupolo

1. Preglejte ročico, če je razpokana ali onesnažena.
2. Vstavite ročico na kamero.
 - Zasliši se klik.
 - Ročica je zaklenjena na mesto in prpravljena za uporabo.

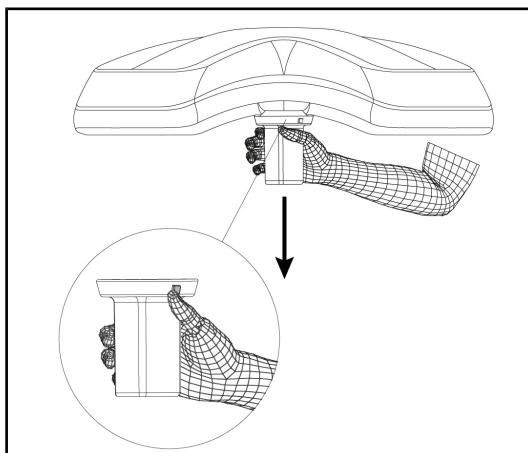

Sl. 72: Odstraniti sterilizabilno ročico STG PSX 01

Odstraniti sterilizabilno ročico za kamero kupole

1. Pritisnite na gumb za zaklepanje.
2. Odstranite ročico.

4.3.2 Nastaviti kupolo



OPOZORILO!

Nevarnost infekcije/tkivne reakcije

Pri trku naprave ob drugo opremo lahko delci padejo v operativno polje.

Napravo postavite na mesto pred prihodom pacienta. Opremo prestavite previdno, preprečite trke.




OPOZORILO!

Tveganje prenosa okužbe

Te ročice so edini elementi opreme, ki se lahko sterilizirajo. Vsak stik sterilne ekipe z drugo površino pomeni tveganje prenosa okužbe. Vsak stik nesterilnega osebja z ročicami, ki se lahko sterilizirajo, pomeni tveganje prenosa okužbe.

Med kirurškim posegom mora sterilna ekipa upravljati opremo samo z ročicami, ki se lahko sterilizirajo. Na ročicah HLX gumb za zaklepanje ni sterilen. Nesterilno osebje se ne sme dotakniti ročic, ki se lahko sterilizirajo.


Rokovati s kupolo

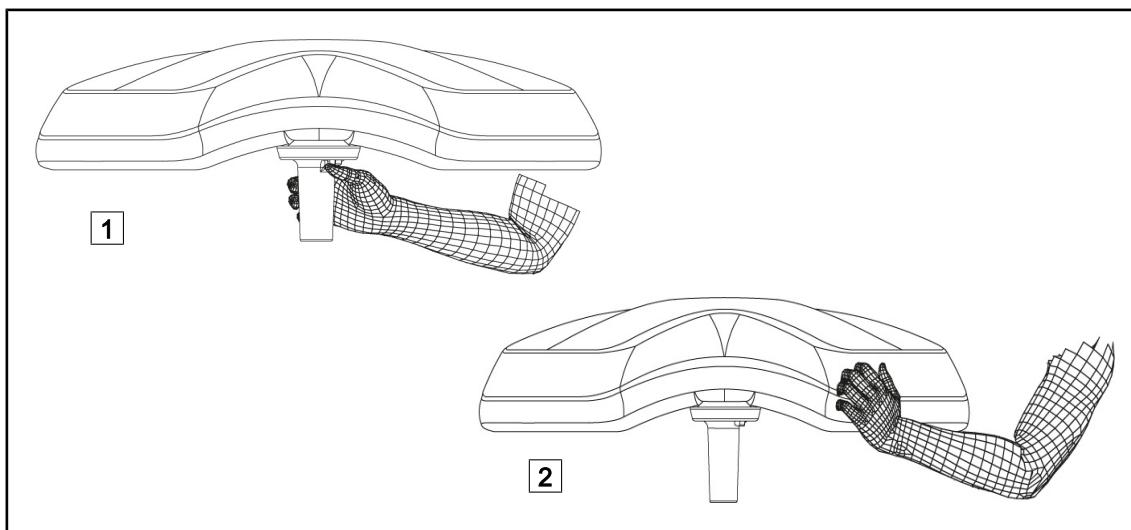


Sl. 73: Rokovanje s kupolo

- S kupolo je mogoče manipulirati na različne načine, tako da ga prestavite:
 - Za sterilno osebje: s temu namenjeno sterilno ročico na sredini kupole **1**.
 - Za nesterilno osebje: neposredno s kupolo **2** ali zunanjim ročicom na loku.


Koti vrtenja svetilk

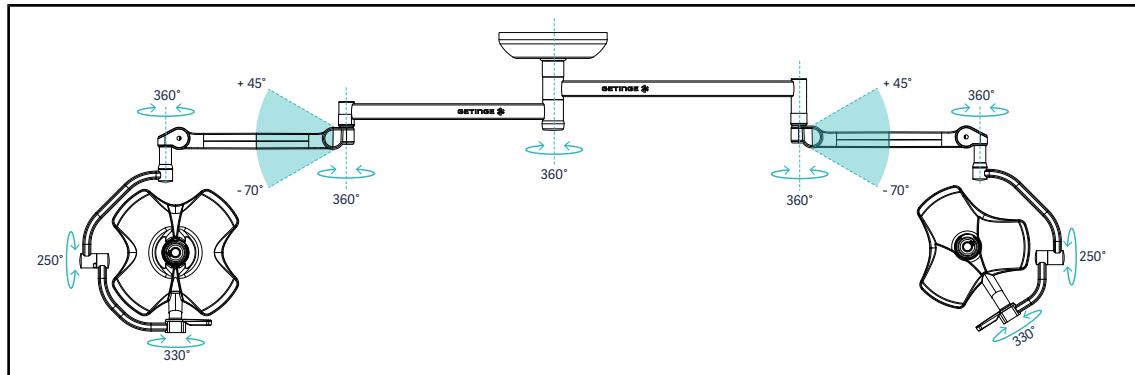


Sl. 74: Možnosti vrtenja na dvojni konfiguraciji VSTII64DF na vzetni SAX

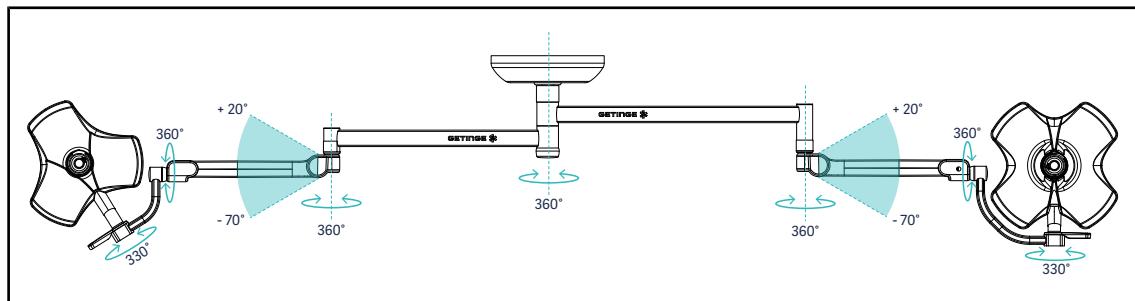


Sl. 75: Možnosti vrtenja na dvojni konfiguraciji VSTII64SF na vzetni SAX

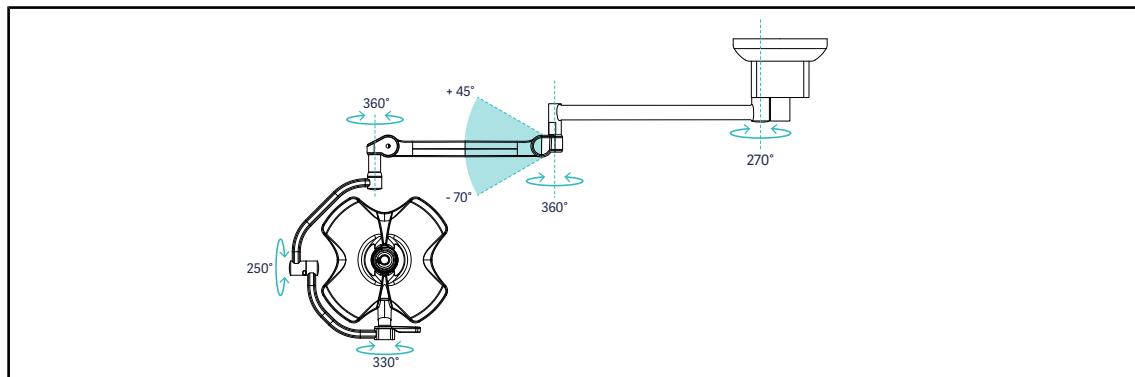


Sl. 76: Možnosti vrtenja na enojni konfiguraciji VSTII60DF na vzetni SATX

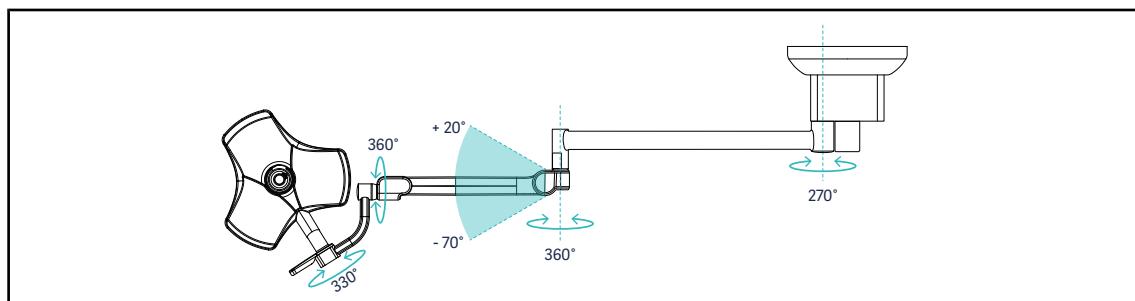

Sl. 77: Možnosti vrtenja na enojni konfiguraciji VSTII40SF na vzetni SATX

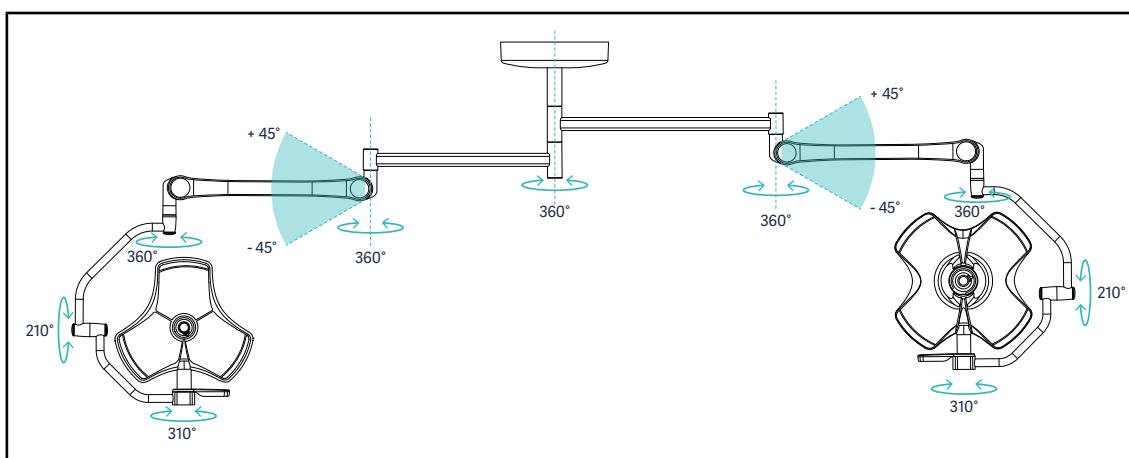


Sl. 78: Možnosti vrtenja na dvojni konfiguraciji VCSII64DF na vzemeti SB

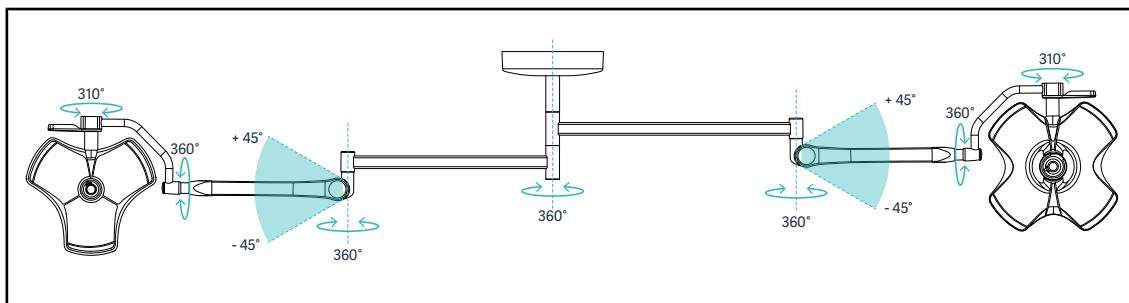

Sl. 79: Možnosti vrtenja na dvojni konfiguraciji VCSII64SF na vzemeti SB

4.3.3 Primeri prestavljanja


Splošna kirurgija, abdominalna kirurgija, torakalna kirurgija

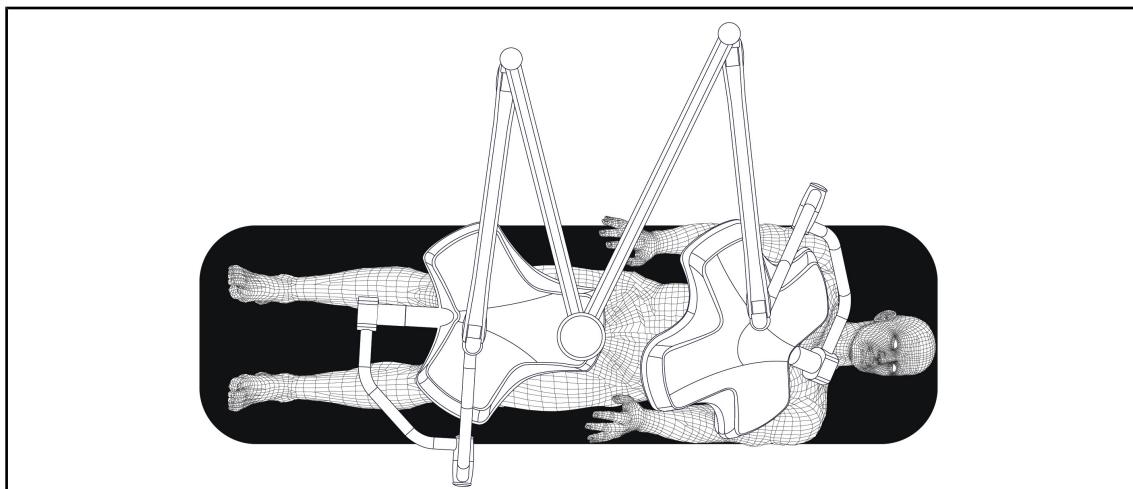

Sl. 80: Predhodna postavitev za splošno kirurgijo, abdominalno kirurgijo ali torakalno kirurgijo


- Viseče roke in vzmetne roke je treba postaviti nasproti osebi, ki upravlja s svetilko na način, da tvori obliko črke M.
- Po potrebi predhodno preverite dostop do ukazov kupole za zdravstveno osebje, ki ne izpolnjujejo posebnih sterilnih pogojev.
- Svetilke morajo biti nameščene nad operacijsko mizo:
 - glavno kupolo tik nad odprtino.
 - Sekundarno kupolo lahko premikate več in jo nastavljate v po želji.

Urologija, ginekologija

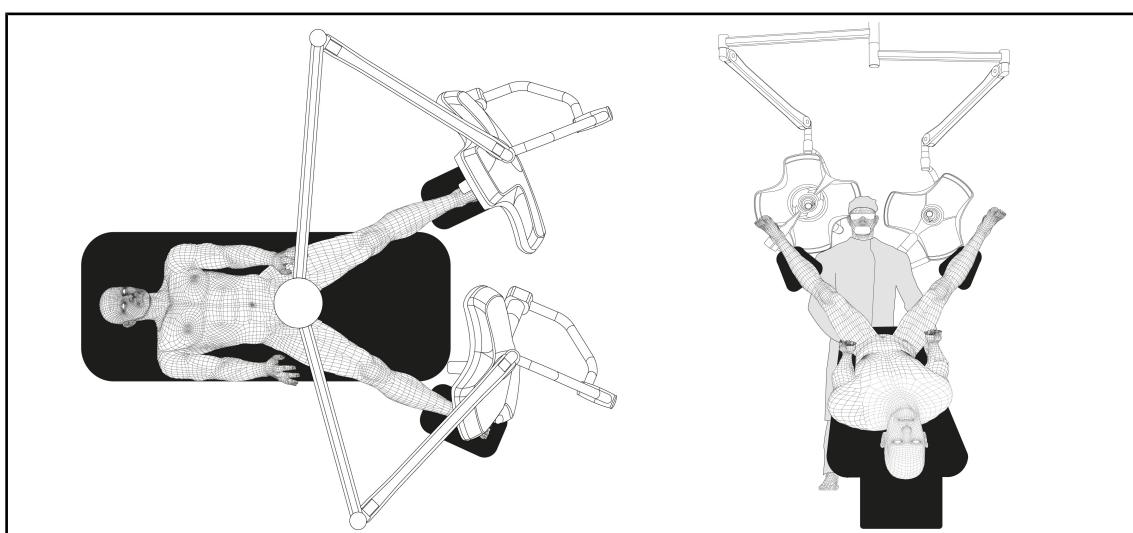


Sl. 81: Predhodna postavitev za urologijo ali ginekologijo

- Viseče roke in vzmetne roke je treba postaviti na zunanj stran mize, tako da ne ovirajo prostora nad pacientom in kirurgovo glavo.
- Svetilki morata stati na obeh straneh ob kirurgovih ramen.

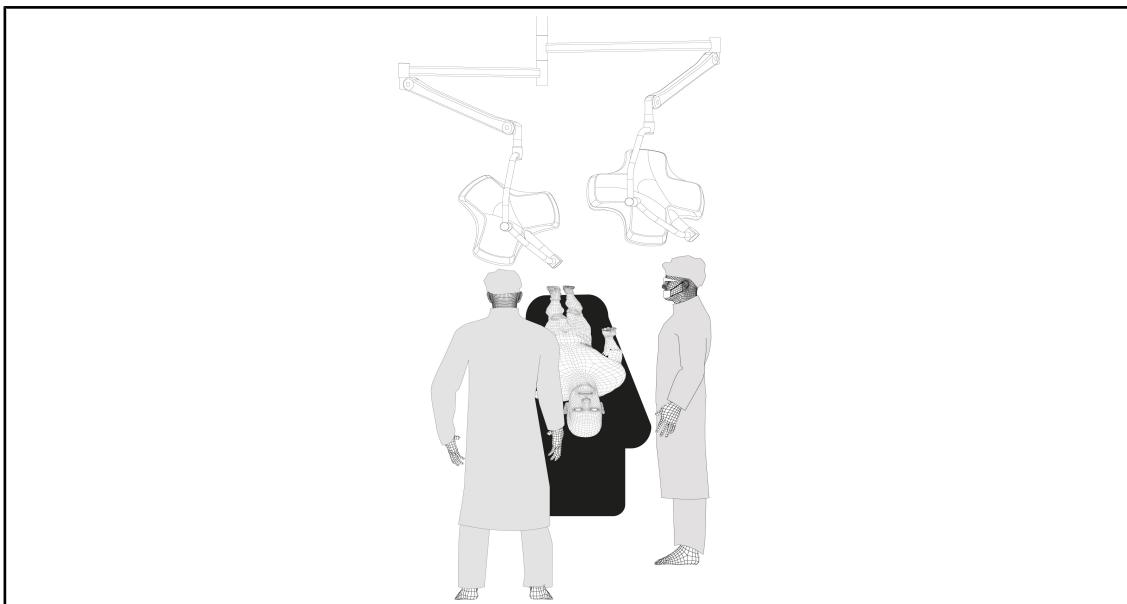ORL, nevrologija, stomatologija, oftalmologija

Sl. 82: Predhodna postavitev za ORL, nevrologijo, stomatologijo ali oftalmologijo

- Svetilke morajo biti nameščene nad operacijsko mizo:
 - glavno kupolo tik nad odprtino.
 - Sekundarno kupolo lahko več premikate in jo nastavljate na različne točke po želji.

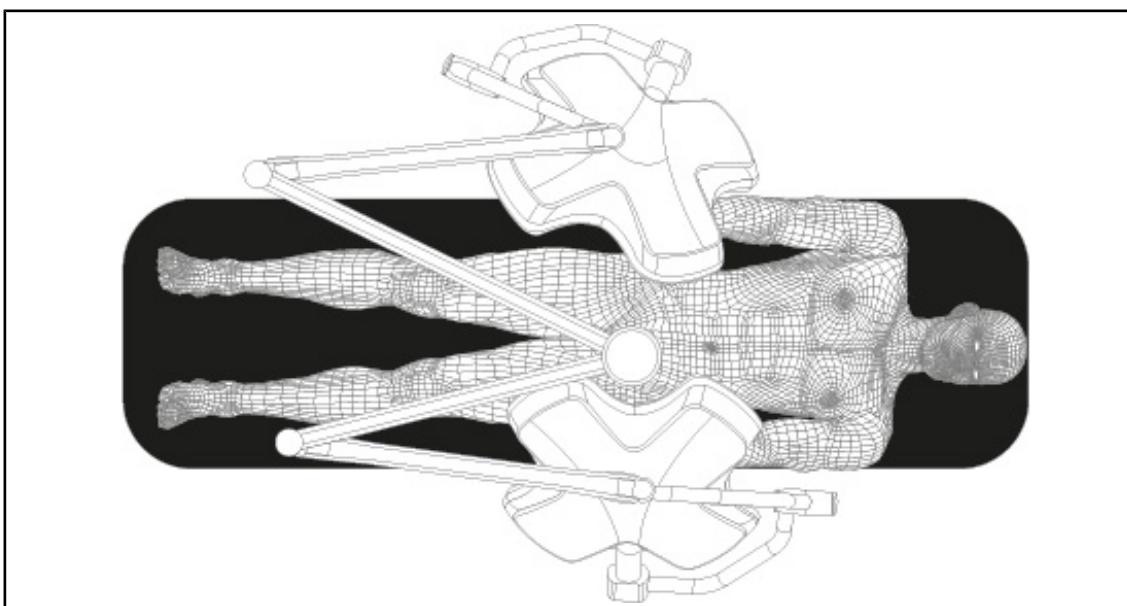Plastična kirurgija

Sl. 83: Predhodna postavitev za plastično kirurgijo

Za plastično kirurgijo velja priporočilo namestiti dve enako veliki kupoli, da se zagotovi enaka osvetljenost simetrično.

4.4 Montirati/demontirati sistem za hitro zaklepanje „Quick Lock“ naprave (kamera ali nosilec za ročice)



OPOZORILO!

Nevarnost poškodb

Ko ni nosilca za ročico ali kamere, so dostopni deli pod napetostjo.

Pred montažo/demontažo priključkov „Quick Lock“ na kupolo serviser izključi napajanje konfiguracije.




NAPOTEK

Ozičeno kamero lahko montirate samo na kupolo spodnje roke podaljška. Če je nameščena na zgornjo roko podaljška, ni možno priključiti videosistema.

4.4.1 Najprej določite položaj naprave

4.4.1.1 Na kameri „Quick Lock“

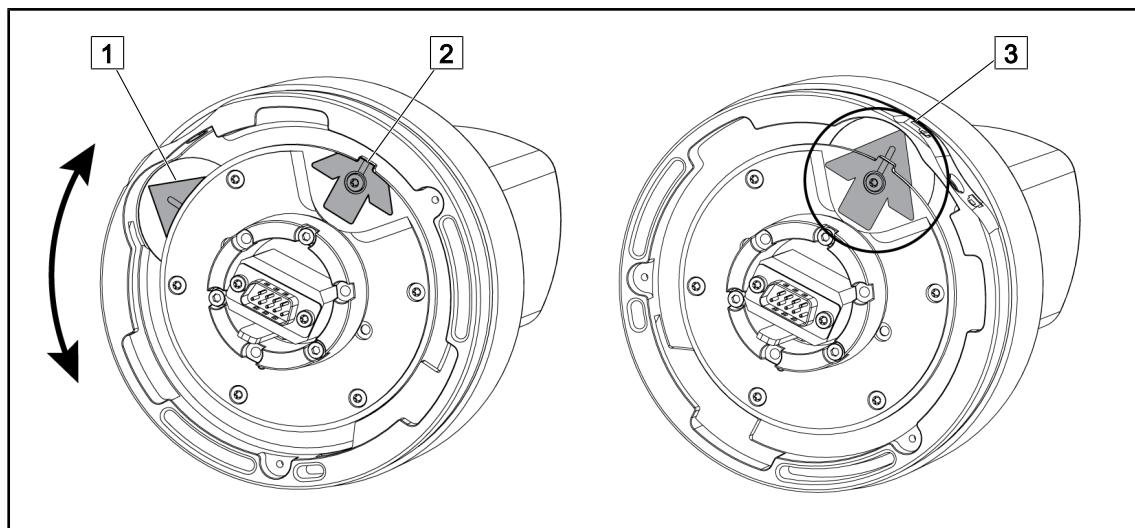

Sl. 84: Predhodna postavitev kamere „Quick Lock“


- Zavrtite osnovno enoto [1] do stka z vrhom [2] in postavite zelene puščice [3].
➤ Kamera je pripravljena, da jo lahko postavite na mesto.

4

Uporaba

Montirati/demontirati sistem za hitro zaklepanje „Quick Lock“ naprave (kamera ali nosilec za ročice)


4.4.1.2 Na kupoli

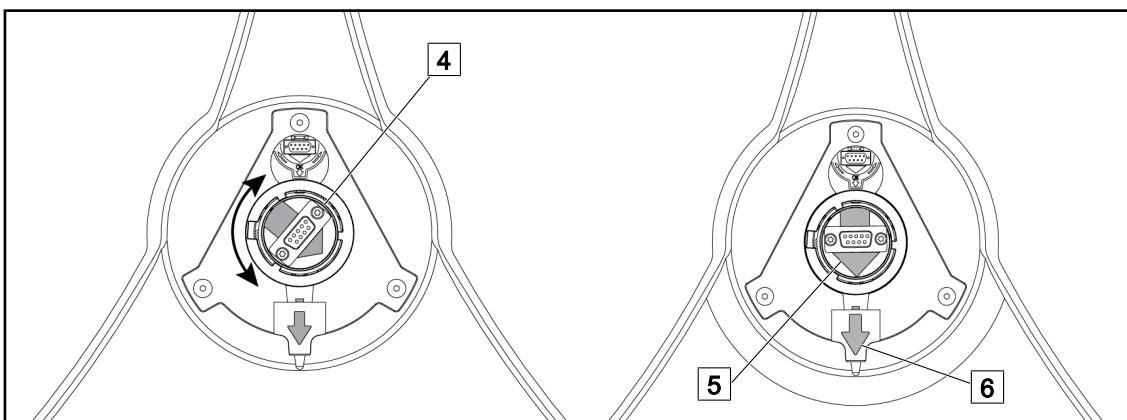

Sl. 85: Predhodna postavitev kupole


1. Na sredini kupole, usmerite konektor **4** tako, da se zeleni puščici **5** in **6** poravnata.
➤ Kupola je pripravljena, da nanjo namestite kamero.

4.4.2 Montaža naprave na kupolo

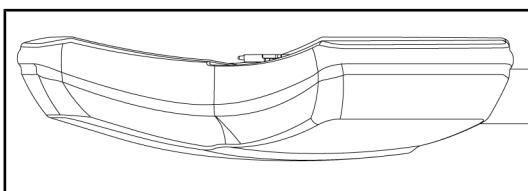

Sl. 86: Postavitev kupole


1. Postavite kupolo, tako da je spodnja stran obrnjena v strop.
➤ Kamero zdaj enostavneje namestite na kupolo.

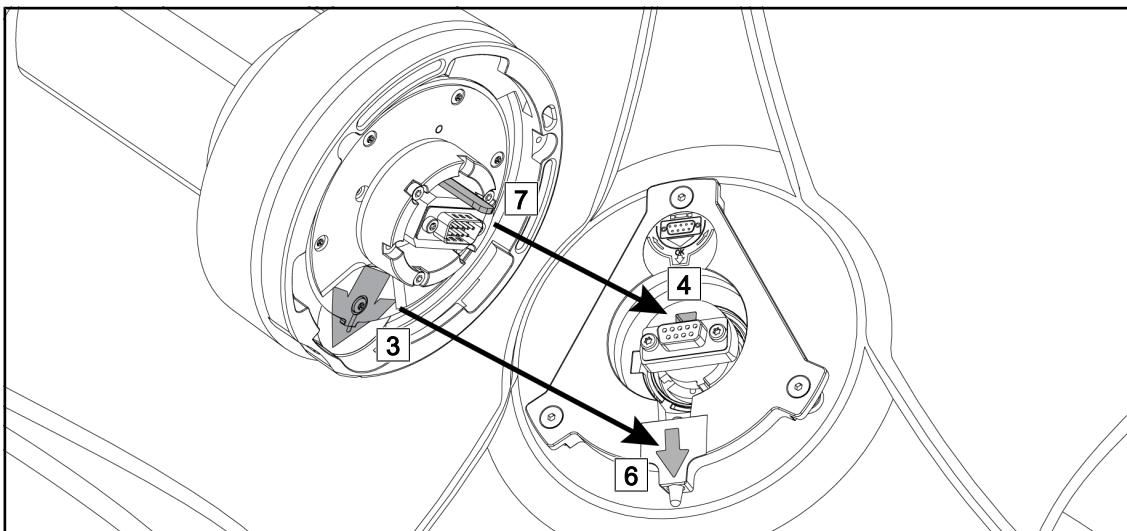

Sl. 87: Navodila za montažo naprave za hitro zaklepanje „Quick Lock“


1. Namestite kamero z zatičem **7** pred ohišje **4**.
2. Postavite puščici **3** in **6** spredaj.

Montirati/demontirati sistem za hitro zaklepanje „Quick Lock“ naprave (kamera ali nosilec za ročice)

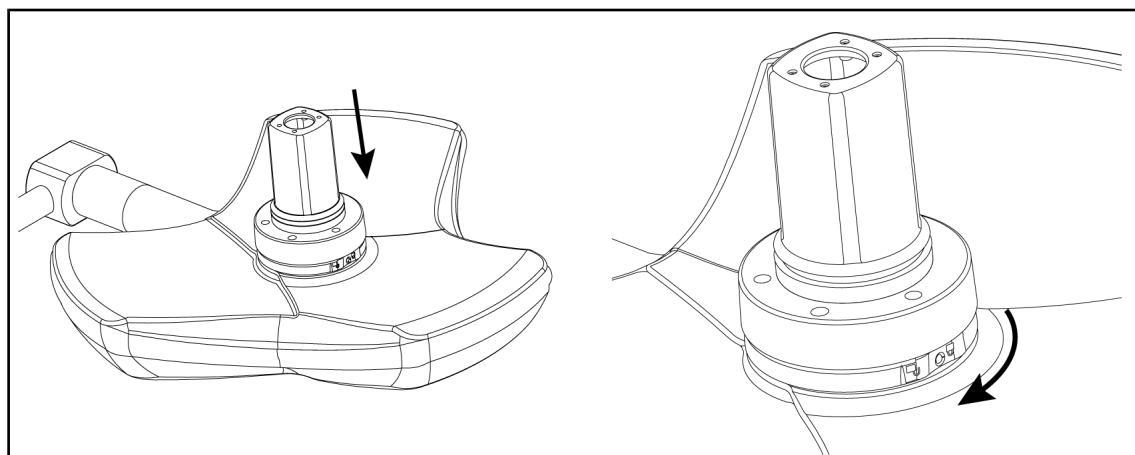

Sl. 88: Forma kamere na kupoli


1. Vstavite kamero v kupolo, tako da spodnji sestav kamere pravilno sede na spodnjo stran.
2. Z obema rokama zavrite spodnji sestav kamere v smeri urnega kazalca, tako da klikne.

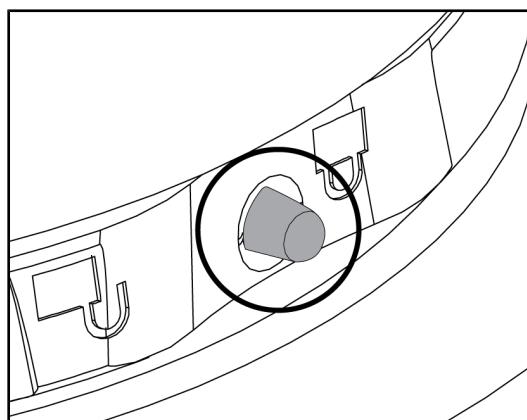

Sl. 89: Zaklepanje kamere na kupolo

1. Preverite in potrdite, da kamera stoji dobro na mestu in da je gumb za zaklepanjem pravilno izstopil iz ohišja.
2. Premaknite kupolo s kamero, tako da preverite in potrdite, da naprava stoji na pravem mestu.
3. Preverite in potrdite, da se sestav kamere neovirano zavrti za 330° .
➤ Naprava je nameščena.


4.4.3 Demontaža naprave

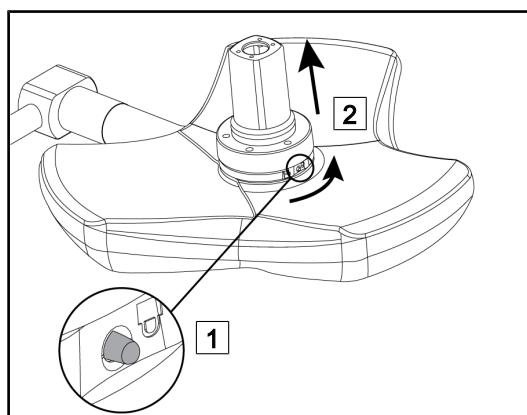

Sl. 90: Demontaža kupole


1. Pritisnite na gumb za zaklepanje.
2. Pritisnite in zadržite gumb [1], z obema roka zavrite osnovno enoto naprave v nasprotni smeri urnega kazalca.
3. Odklopite napravo za hitro zaklepanje kamere "Quick Lock" tako, da jo povlečete gor [2].
➤ Naprave je demontirana.

4.4.4 Nosilec za ročico na „Quick Lock“

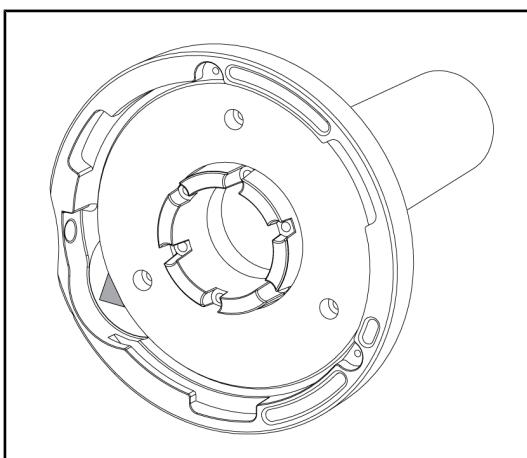

Sl. 91: Nosilec za ročico „Quick Lock“

1. Veljajo enaka navodila za namestitev kot za kamero.
2. Poravnajte zelene puščice in pravilno postavite konektor.

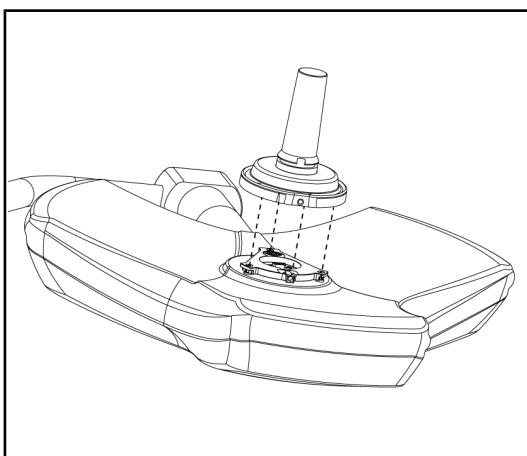

Sl. 92: Forma ročice

1. Vstavite ročico tako, da poravnate zelene puščice (ročica nima zatiča).
2. Enako kot velja za kamero, zavrtite osnovno enoto ročice v smeri urnega kazalca; preverite in potrdite, da se je zaklep pravilno vklopil.
➤ Nosilec za ročico je nameščen.

4.5 Uporabljati kamero



NAPOTEK

Potem ko namestite kamero OHDII VP01 QL FHD na kupolo (glej Montirati/demontrirati sistem za hitro zaklepanje „Quick Lock“ naprave (kamera ali nosilec za ročice) [► Stran 73]), ni dodatnih navodil. To kamero je treba konfigurirati za video in povezati s sprejemnikom VP01.



NAPOTEK

Kamero OHDII AIR03 QL FHD z brezžičnim sistemom je treba upariti pred prvo uporabo; vmesno fazo med vsemi naslednjimi uporabami. Getinge ima v ponudbi kamero, ki je predhodno opremljena s ključem za brezžični prenos GEFEN®; glejte priložena navodila ali Brezžični videosistem [► Stran 77].

4.5.1 Brezžični videosistem



POZOR!

Nevarnost nepravilnega delovanja pripomočka
Brezžične naprave v bližini lahko negativno učinkujejo na kakovost prenosa slike.

Uporabnik mora prebrati navodila za brezžični sistem, v katerih so opisani pogoji za uporabo takšnega sistema.




POZOR!

Nevarnost nepravilnega delovanja pripomočka
Uporaba dodatne opreme ali drugih kablov, ki jih ne dobavi ali odobri proizvajalec, lahko negativno vpliva na delovanje pripomočka.

Uporabljajte samo brezžične sisteme, ki jih odobri Getinge.

4.5.1.1 Uparjenje kamere

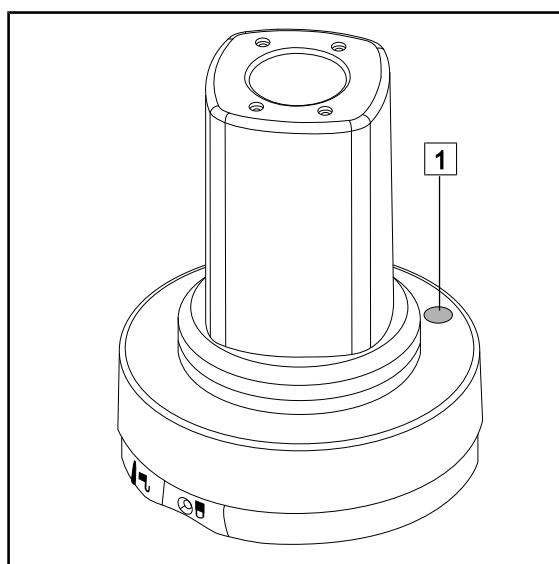

Sl. 93: Brezžična kamera


Kamero uparite z ustreznim brezžičnim sistemom po navodilih proizvajalca, ki so priloženi brezžični napravi. Med uparjenjem pritisnite na gumb prenosne kamere 1, da zaženete začevanje kamere med fazo iskanja signala.

4.5.1.2 Zagon uparjenega sistema

Ko se kamera vključi, se sprejemnik samodejno poveže s kamero, s katero je upарjen. Ko je povezava izpostavljena, sistem izpiše sporočilo o kanalu in ločljivosti.

4.5.2 Upravljanje kamero

4.5.2.1 S tipkovnico kupole ali stenske nadzorne plošče (samo zum)

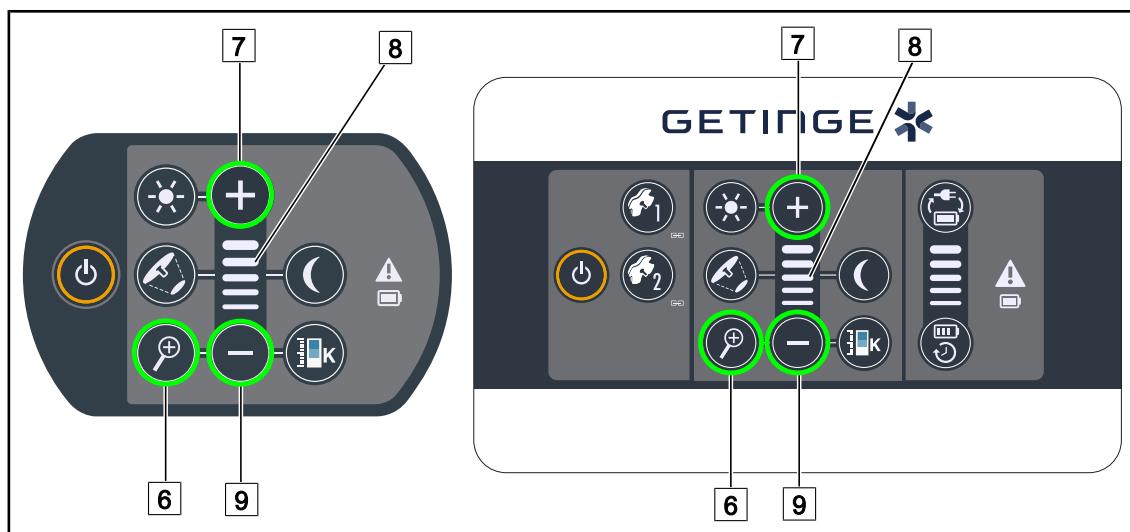

Sl. 94: Tipkovnica za upravljanje kamere

Nastaviti zum kamere


1. Pritisnite na **Zum kamere** [6].
2. Pritisnite na **Plus** [7] ali **minus** [9], da povečate oziroma pomanjšate sliko.
➤ Zum kamere se spreminja glede na indikator stopnje izbrane funkcije [8].

4.5.2.2 Z zaslona na dotik



NAPOTEK

Na zaslolu na dotik lahko kamero vključite ali izključite neodvisno od svetilk.

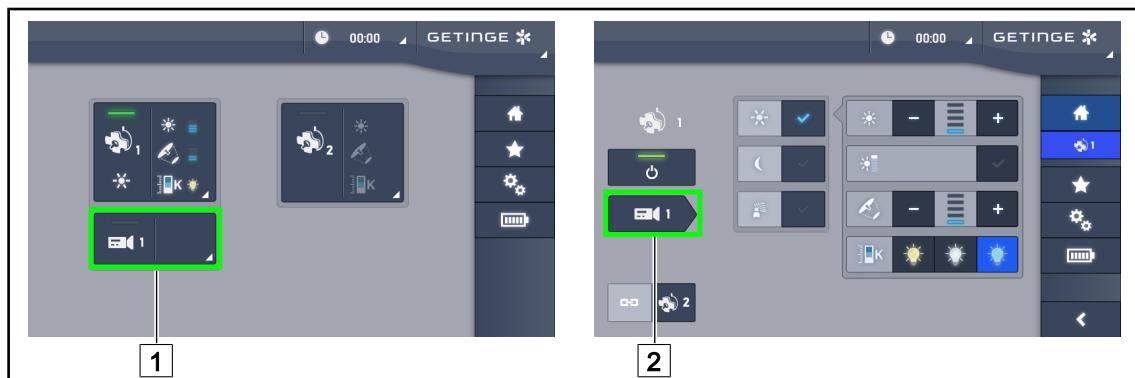


Sl. 95: Vključitev kamere

Vključiti kamero na vhodni strani

- Pritisnite na **Aktivno območje kamere** [1].
➤ Tipka zasveti zeleno in na zaslolu se prikaže slika.
- Znova pritisnite na **Aktivno območje kamere** [1], da dostopite do strani kamere.

Vključiti kamero na strani kupole

- Na strani kupole pritisnite na **Bližnjico kamere** [2].
➤ Odpre se stran kamere, kamera je vključena.

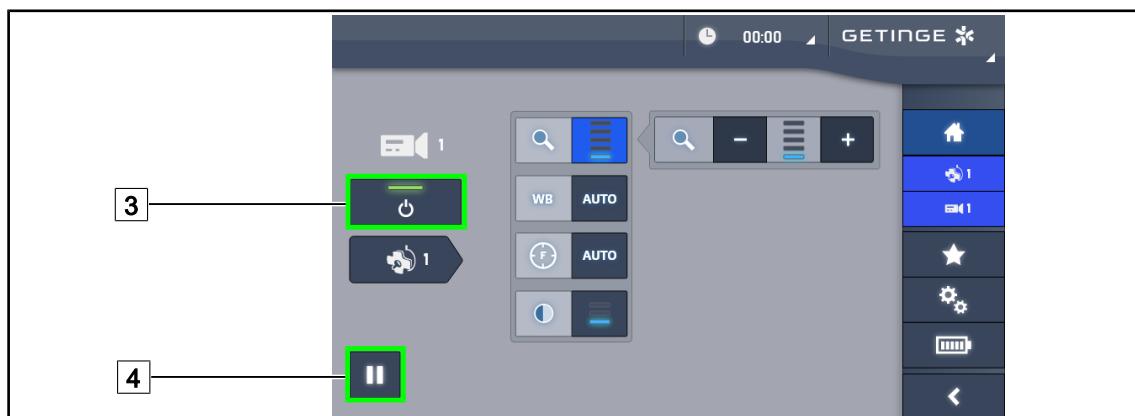

Sl. 96: Stran kamere

Izklučiti kamero

- Odprite stran kamere, pritisnite na **Vkl./izk. (ON/OFF) kamero** [3], da izključite kamero.
➤ Tipka in kamera se izključita.

Zaustaviti kamero

- Pritisnite na **Zaustavi kamero** [4], da zaustavite začasno kamero.
➤ Tipka se vključi modro in slika prenosa zmrzne.
- Znova pritisnite na **Zaustavi kamero** [4], da znova zaženete videosnemanje.



Sl. 97: Nastavitev zuma

Povečati/pomanjšati sliko (zumirati)

1. Pritisnite na **Zoom** [5], da dostopite do menija za nastavitev zooma.
2. Pritisnite na **Povečaj zumb** [6] ali na **Zmanjšaj zumb** [7], da nastavite v resničnem času velikost slike na zaslonu .




Sl. 98: Ravnovesje beline

Avtomatična nastavitev ravnovesja beline

1. Pritisnite na **Ravnovesje beline** [8].
2. Pritisnite na **Ravnovesje avtom.** [9], da se ravnovesje beline nastavi avtomatično; pritisnite na **Umetna svetloba** [10], da se ravnovesje beline nastavi na 3200 K; pritisnite na **Dnevna svetloba** [11], da se ravnovesje beline nastavi na 5800 K.
➤ Izbrana tipka zasveti modro in ravnovesje beline deluje.

Ročno nastaviti ravnovesje beline

1. Pritisnite na **Ravnovesje beline** [8].
2. Namestite enakomerno belo površino pod kamero.
3. Pritisnite na **Ravnovesje ročno** [12], da se ravnovesje beline uravna po označeni točki pod kamero.
➤ Izbrana tipka zasveti modro in ravnovesje beline deluje.

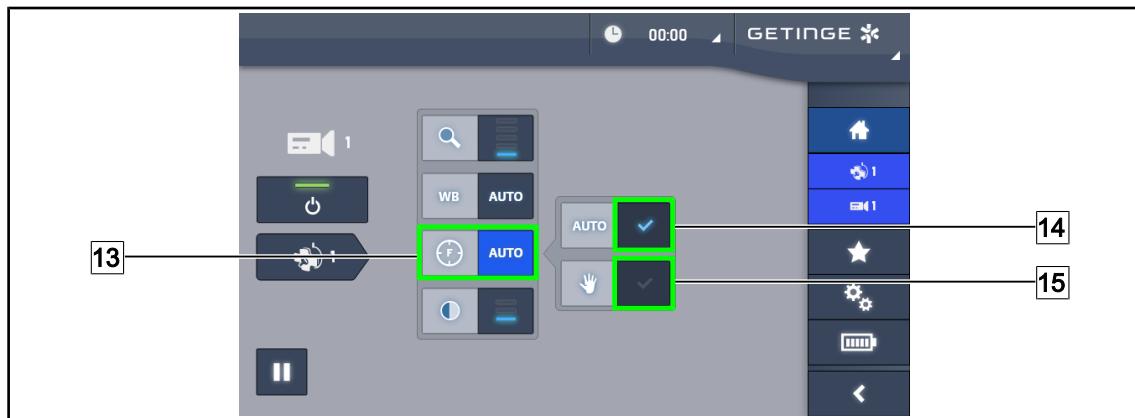

Sl. 99: Nastaviti fokusiranje

Nastaviti avtom. fokusiranje

1. Pritisnite na **Fokusiraj** [13], da dostopite do menija za nastavitev fokusiranj.
2. Pritisnite na **Fokusiraj avtom.** [14].
 - Tipka zasveti modro in sistem avtomatično fokusira.

Ročno nastaviti fokusiranje

1. Pritisnite na **Fokusiraj** [13], da dostopite do menija za nastavitev fokusiranj.
2. Pritisnite na **Fokusiraj avtom.** [14].
 - Tipka zasveti modro in sistem avtomatično fokusira.
3. Postavite kamero na želeno oddaljenost.
4. Pritisnite na **Fokusiraj ročno** [15].
 - Tipka zasveti modro in fokus kamere zmrzne.




Sl. 100: Nastavitev kontrasta

Nastaviti kontrast

1. Pritisnite na **Kontrast** [16], da dostopite do menija za nastavitev kontrasta.
2. Pritisnite na **Povečaj kontrast** [17] ali **Zmanjšaj kontrast** [18], da nastavite eno od treh stopenj kontrasta.

4.5.3 Usmeriti kamero

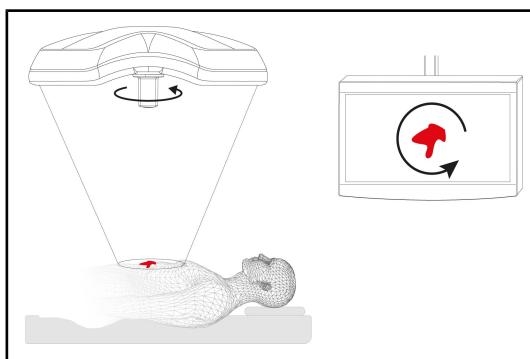

Sl. 101: Usmeritev kamere

Usmeriti sliko najbolje za opazovalca

1. Pritrdite ročico na kamero.
 2. Z ročico zavrtite kamero.
- Na zaslonu se zavrti slika.

4.6 Določiti položaj nosilca zaslona

4.6.1 Uporabite in namestite podporo zaslona



OPOZORILO!

Nevarnost okužbe

Sterilizabilna ročica je edini element pripomočka, ki ga je mogoče sterilizirati. Zaslon, podpora zaslona in dodatna oprema zaslona niso sterilni, zato ob stiku s sterilno opremo lahko pride do nevarnosti okužbe za pacienta.

Med operacijo se zaslona, podpore zaslona in dodatne opreme zaslona v nobenem primeru ne smete dotikati s sterilno opremo, ročice pa v nobenem primeru ne smejo uporabljati nesterilno osebje.



OPOZORILO!

Nevarnost infekcije/tkvne reakcije

Pri trku naprave ob drugo opremo lahko delci padejo v operativno polje.

Napravo postavite na mesto pred prihodom pacienta. Opremo prestavite previdno, prepričte se, da ne pride do trke.




OPOZORILO!

Nevarnost poškodb

Neustrezna uporaba podpore zaslona XHD1 lahko povzroči poškodbo roke.

Upoštevajte varnostne indikacije na izdelku.


Manipulirajte z nosilcem zaslona za sterilno osebje

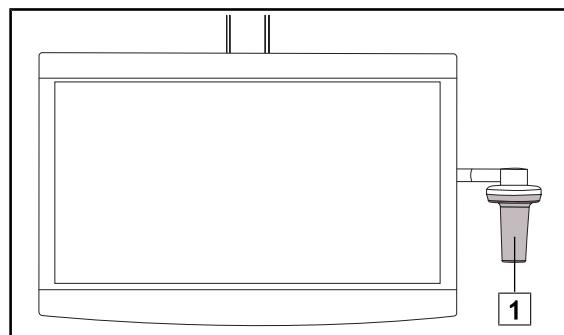

Sl. 102: Manipuliranje sterilnega osebja

- Premaknite pripomoček tako, da primete sterilizabilno ročico **1** ali sterilno ročico tipa DEVON/DEROYAL.


Minuplirajte z nosilcem zaslona za nesterilno osebje

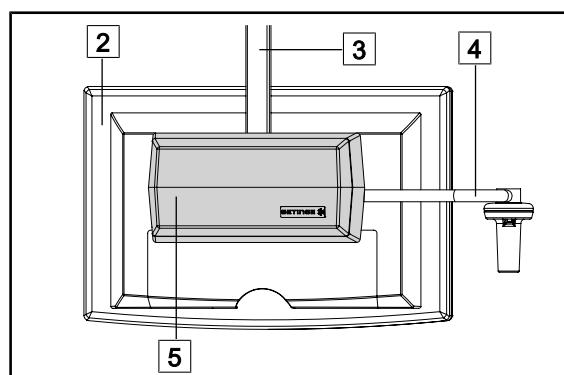

Sl. 103: Manipuliranje za nesterilno osebje

- Premaknite pripomoček tako, da primete ploski zaslon **2**, okvir nosilca zaslona **3**, lok ročice **4** ali kaseto Rear Box **5**.


Namestite nosilec zaslona

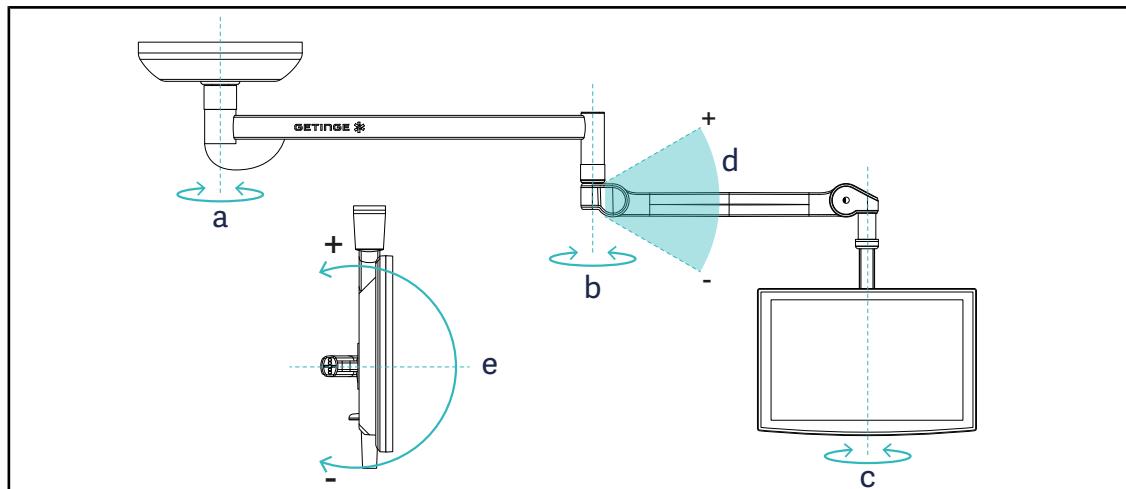

Sl. 104: Vrtenje, mogoče pri stropnem nosilcu SAX

Nosilec zaslona	a	b	c	d	e
FHS0 / MHS0	330°	330°	315°	+45° / -70°	-
XHS0	330°	330°	315°	+45° / -70°	-45° / +90°
XHD1	330°	330°	330°	+45° / -70°	-60° / +10°
XO	360°	360°	360°	+45° / -50°	-

Tab. 15: Velikost kota vrtanja pri vzmetni roki SAX

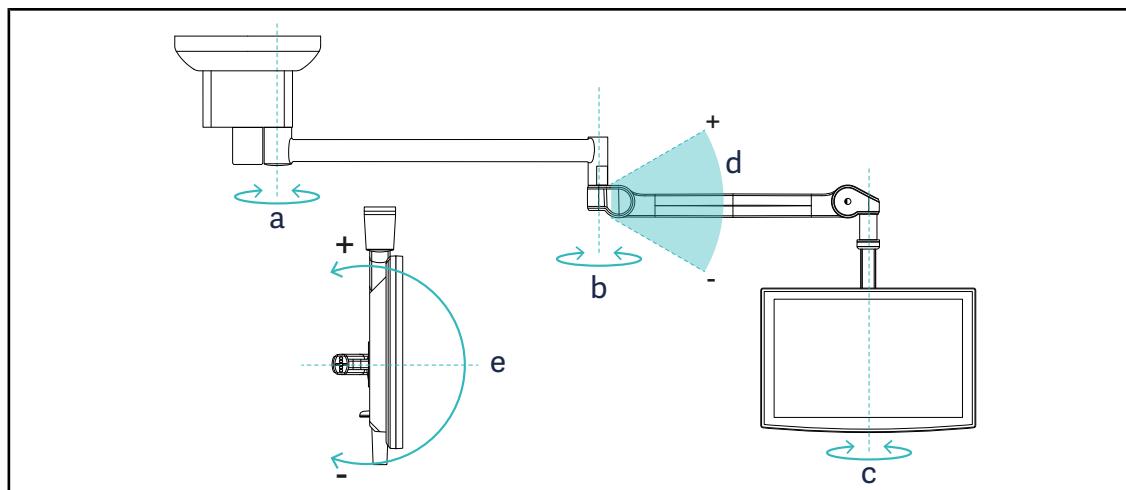


Sl. 105: Možno obračanje pri vzmetni roki SATX

Nosilec zaslona	a	b	c	d	e
FHS0 / MHS0	270°	330°	315°	+45° / -70°	-
XHS0	270°	330°	315°	+45° / -70°	-45° / +90°
XHD1	270°	330°	330°	+45° / -70°	-60° / +10°


Tab. 16: Stopnje obračanja pri vzmetni roki SATX

4.6.2 Primeri preddoločitve položaja nosilcev zaslonov

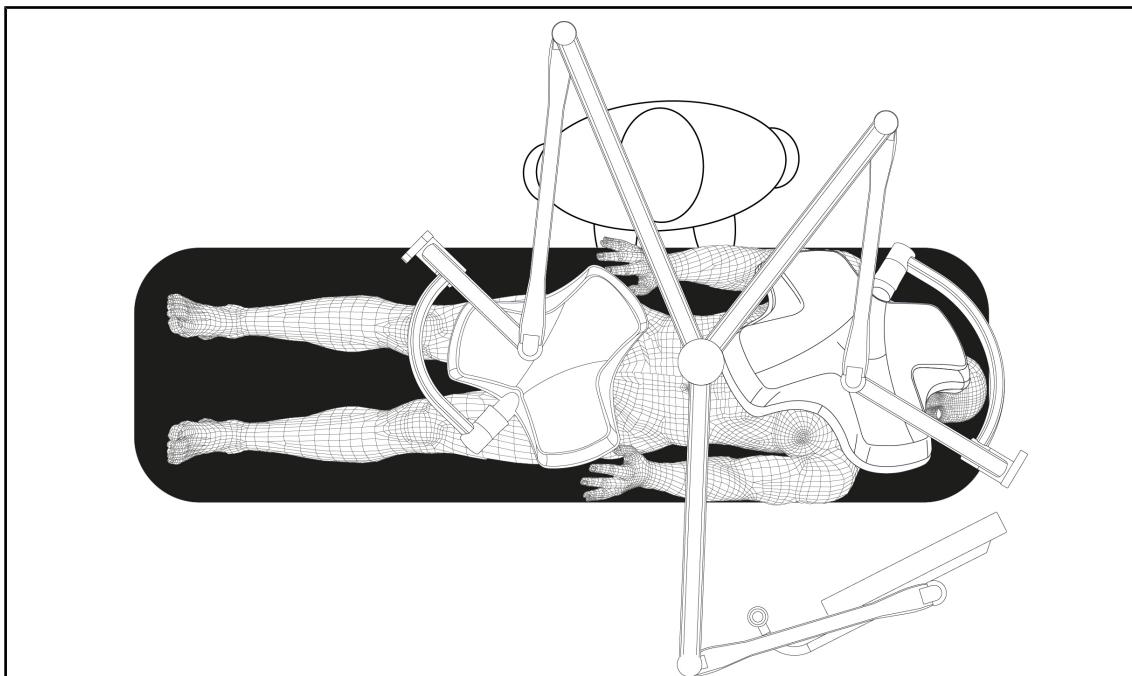

Sl. 106: Primer preddoločitve položaja pri trojni konfiguraciji z nosilcem zaslona

- Postavitev zaslona je odvisna od vrste kirurškega posega in kirurškega osebja.
- Namestiti je treba tako, da kirurško osebje vidi in lahko bere vse informacije.
- Postaviti je treba dovolj umaknjeno, da ni mogoč stik s sterilnim osebjem.

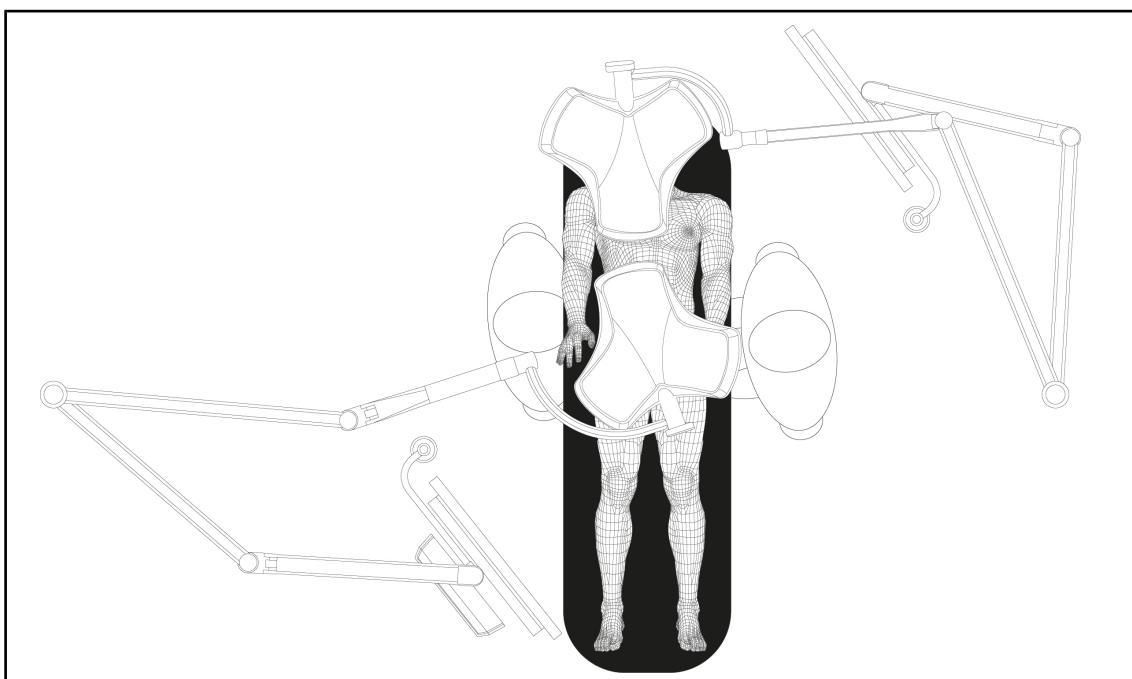

Sl. 107: Primer preddoločitve položaja pri dvojnih konfiguracijah z dvema nosilcema zaslonov

- Določitev položaja zaslona je odvisna od vrste kirurškega posega in kirurškega osebja.
- Namestiti je treba tako, da kirurško osebje vidi in lahko bere vse informacije.
- Postaviti je treba dovolj umaknjeno, da ni mogoč stik s sterilnim osebjem.


4.7 Določiti položaj nosilca kamere

4.7.1 Namestite kamero na podporo kamere SC



NAPOTEK

Na to podporo lahko namestite le medicinske videokamere, ki so v skladu s standardi IEC 60601-1 in ki so opremljene z oblikovanimi konektorji, ki jih je mogoče odstraniti, z navojem 1/4". Za izbiro kamere, kablov in načina napeljave kablov na podporo je odgovorna stranka.

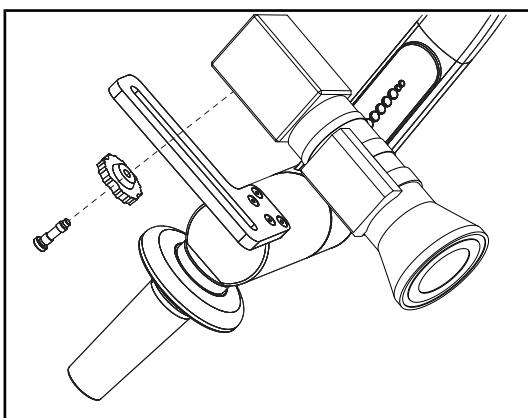

Sl. 108: Namestite kamero na podporo SC

1. Vstavite vijak v odprtino na pritrdilno ploščo.
2. Namestite kamero na pritrdilno ploščo in jo privijte do konca.
3. Pravilno namestite ohišje kamere v odnosu do pritrdilne plošče.
4. Zavrtite zaporno matico v smeri urinega kazalca, da se kamera zaskoči.
5. Priklučite kable, ki ste jih prej speljali skozi vzmetenje na modulu kamere.

4.7.2 Uporaba podpore kamere



OPOZORILO!

Nevarnost infekcije/tkivne reakcije

Pri trku naprave ob drugo opremo lahko delci padejo v operativno polje.

Napravo postavite na mesto pred prihodom pacienta. Opremo prestavite previdno, preprečite trke.




OPOZORILO!

Tveganje prenosa okužbe

Te ročice so edini elementi opreme, ki se lahko sterilizirajo. Vsak stik sterilne ekipe z drugo površino pomeni tveganje prenosa okužbe. Vsak stik nesterilnega osebja z ročicami, ki se lahko sterilizirajo, pomeni tveganje prenosa okužbe.

Med kirurškim posegom mora sterilna ekipa upravljati opremo samo z ročicami, ki se lahko sterilizirajo. Na ročicah HLX gumb za zaklepanje ni sterilen. Nesterilno osebje se ne sme dotakniti ročic, ki se lahko sterilizirajo.

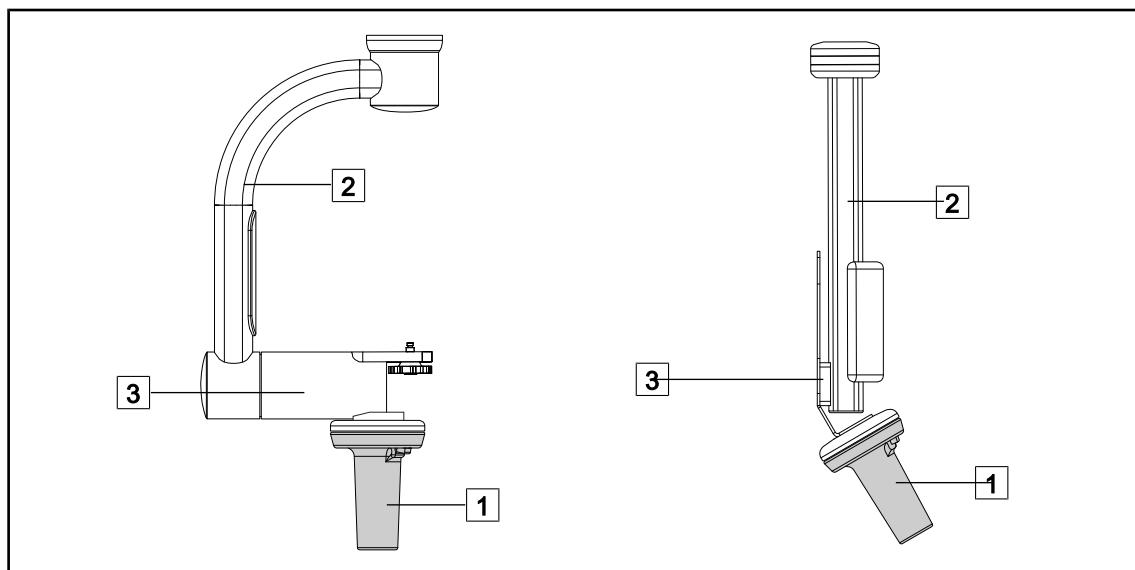


Sl. 109: Uporaba podpore kamere

Podporo kamere lahko premikate na različne načine:

- za sterilno osebje: s temu namenjeno sterilno ročico [1].
- za nesterilno osebje: s fiksнимi ročicami [2] ali s pomočjo podpore [3].

Koti vrtenja

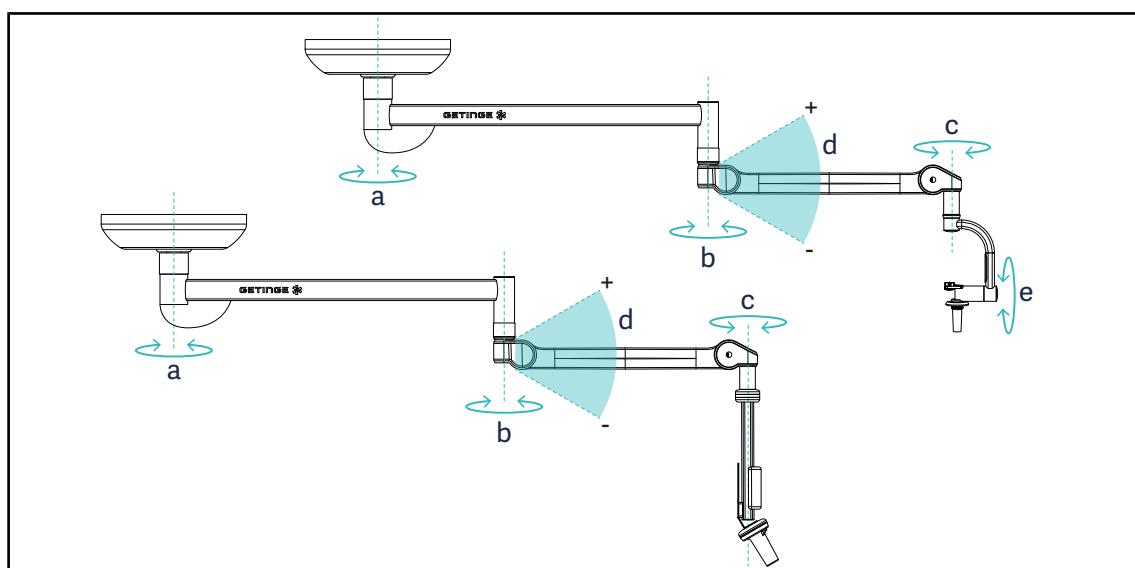


Sl. 110: Koti vrtenja podpore kamere

	a	b	c	d	e
SC05	SAX: 360°	360°	360°	+45° / -70°	120°
DRŽALO ZA KAMERO FH	SATX: 270°				-

4.8

Nastavitev in funkcije

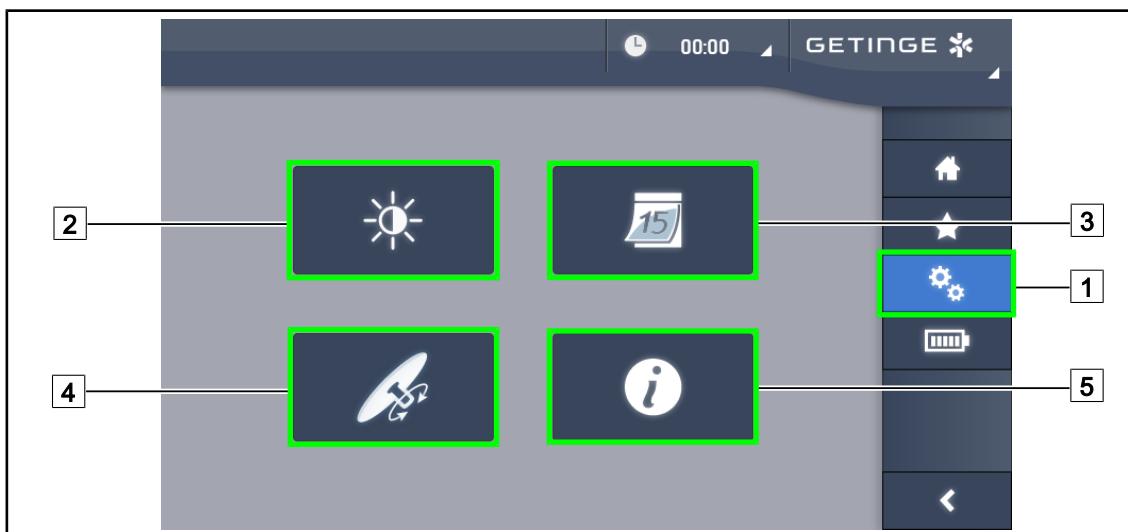

Sl. 111: Stran za nastavitev zaslona na dotik

Dostopiti do nastavitev svetlosti zaslona

1. Pritisnite na **Parametri** [1] v menijski vrstici.
➤ Odpre se stran parametrov (glej zgoraj).
2. Pritisnite na **Svetlost zaslona** [2].
➤ Odpre se stran za nastavitev svetlosti.

Dostopiti do nastavitev datuma in ure ter funkcij kronometra/merilnika časa

1. Pritisnite na **Parametri** [1] v menijski vrstici.
➤ Odpre se stran parametrov (glej zgoraj).
2. Pritisnite na **Datum/ura** [3].
➤ Odpre se stran za nastavitev datuma in ure ter funkcij kronometra/merilnika.


Dostopiti do nastavitev ročice Tilt

1. Pritisnite na **Parametri** [1] v menijski vrstici.
➤ Odpre se stran parametrov (glej zgoraj).
2. Pritisnite na **Ročica Tilt** [4].
➤ Odpre se stran za nastavitev ročice Tilt.

Dostopiti do informacij o konfiguraciji

1. Pritisnite na **Parametri** [1] v menijski vrstici.
➤ Odpre se stran parametrov (glej zgoraj).
2. Pritisnite na **Informacije** [5].
➤ Odpre se stran z informacijami o konfiguraciji.

4.8.1 Svetlost zaslona

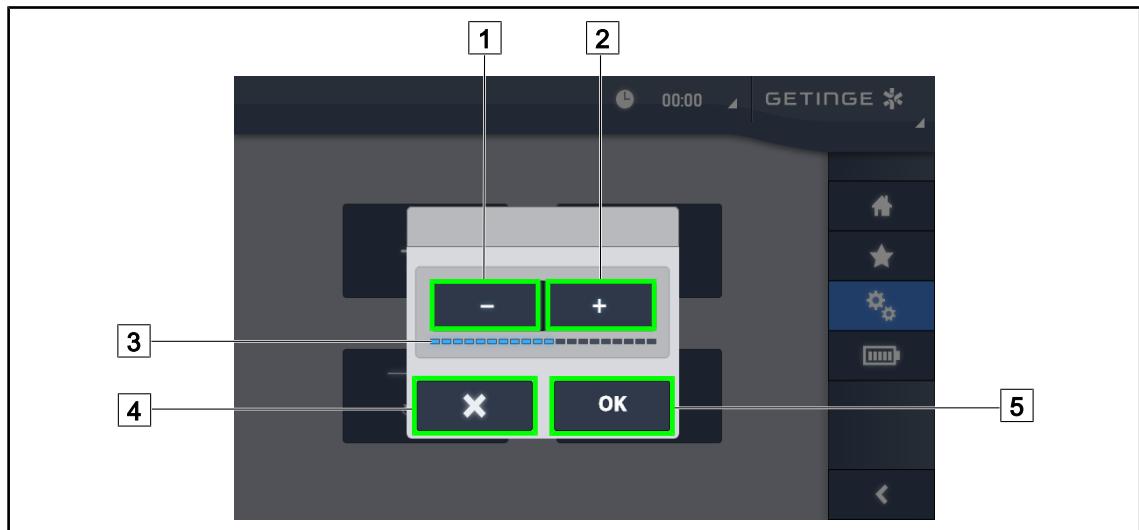


Sl. 112: Nastavitev svetlosti zaslona

1. Pritisnjte na **plus** [2], da povečate svetlost zaslona na dotik, ali na **minus** [1], da zmanjšate svetlost zaslona.
 - Svetlost zaslona ustreza vrednosti na indikatorju svetlosti [3].
2. Pritisnite na **V redu** [5], da potrdite spremembe svetlosti, ali na **Prekliči** [4], da prekličete spremembe v teku.
 - Nastavljeni vrednosti sistem shrani in uporabi.

4.8.2

Datum, ura in funkcije kronometra/merilnika časa

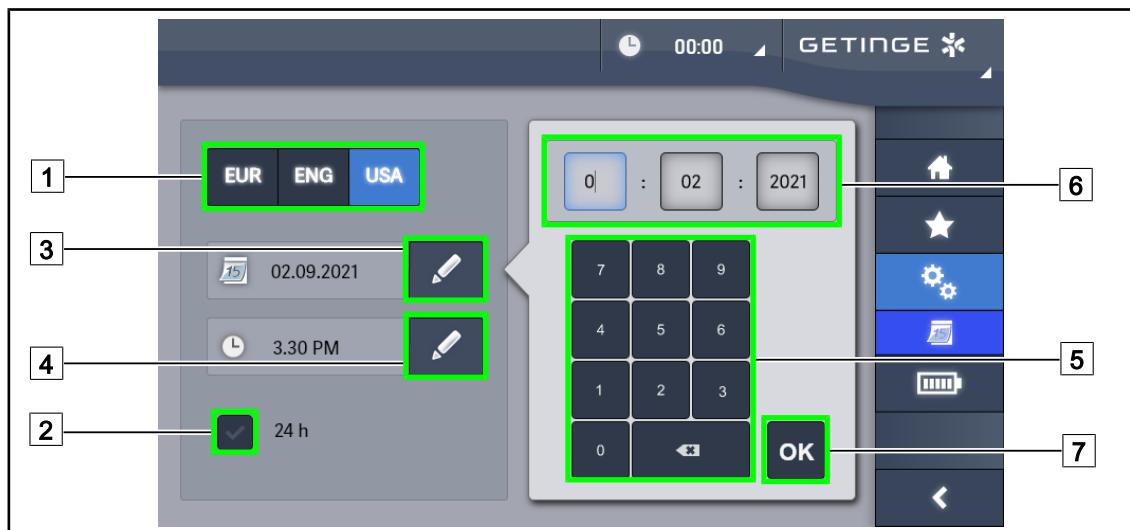

Sl. 113: Nastavitev datuma in ure

Določiti format datuma in ure

- Pritisnite na **Format datum** [1], da nastavite želen format prikaza datuma. Konfigurirate lahko formate, ki jih uporabljajo v Evropi, Angliji in Ameriki.
➤ Ozadje izbranega formata se obarva modro.
- Pritisnite na **Format ure** [2], da nastavite želen format prikaza ure.
➤ Ko vključite tipko, je nastavljen 24-urni format, v drugem primeru je izbran 12-urni format.

Spremeniti datum

- Pritisnite na **Uredi datum** [3].
➤ Odpre se okno za vnos.
- Pritisnite na polje, ki ga želite spremeniti: dan, mesec ali leto [6].
➤ Izbrano polje se obarva modro.
- Vtipkajte vrednost na tipkovnic [5], nato pritisnite na **V redu** [7], da potrdite spremembe.
➤ Okno za vnos se zapre in sistem nastavi spremembe.

Spremeniti uro

- Pritisnite na **Uredi uro** [4].
➤ Odpre se okno za vnos.
- Pritisnite na polje, ki ga želite spremeniti: ure ali minute [6].
➤ Izbrano polje se obarva modro.
- Vtipkajte vrednost na tipkovnic [5], nato pritisnite na **V redu** [7], da potrdite spremembe.
➤ Okno za vnos se zapre in sistem nastavi spremembe.

4.8.3 Funkcija kronometer/merilnik časa (samo na zaslonu na dotik)



Sl. 114: Stran s funkcijami

Dostopiti do kronometra

1. Pritisnite na **Kronometer1** v menijski vrstici.
 - Odpre se stran kronometra.

Dostopiti do merilnika časa

1. Pritisnite na **Merilnik časa [2]** v menijski vrstici.
 - Odpre se stran merilnika časa.

4.8.3.1 Kronometer

Sl. 115: Stran kronometra


Sprožiti/ponastaviti kronometer

1. Pritisnite na **Zaustavi/zaženi** [2], da sprožite kronometer.
 - Kronometer se sproži.
2. Pritisnite na **Ponastavi** [1], da nastavite števec na nič.
 - Kronometer se nastavi na nič.

Zaustaviti/znova zagnati kronometer

1. Ko se kronometer sproži, pritisnite na **Zaustavi/zaženi** [2], da ga začasno zaustavite.
 - Števec začne utripati.
2. Pritisnite na **Zaustavi/zaženi** [2], da znova zaženete kronometer.
 - Števec preneha utripati in nadaljuje.

4.8.3.2 Merilnik časa

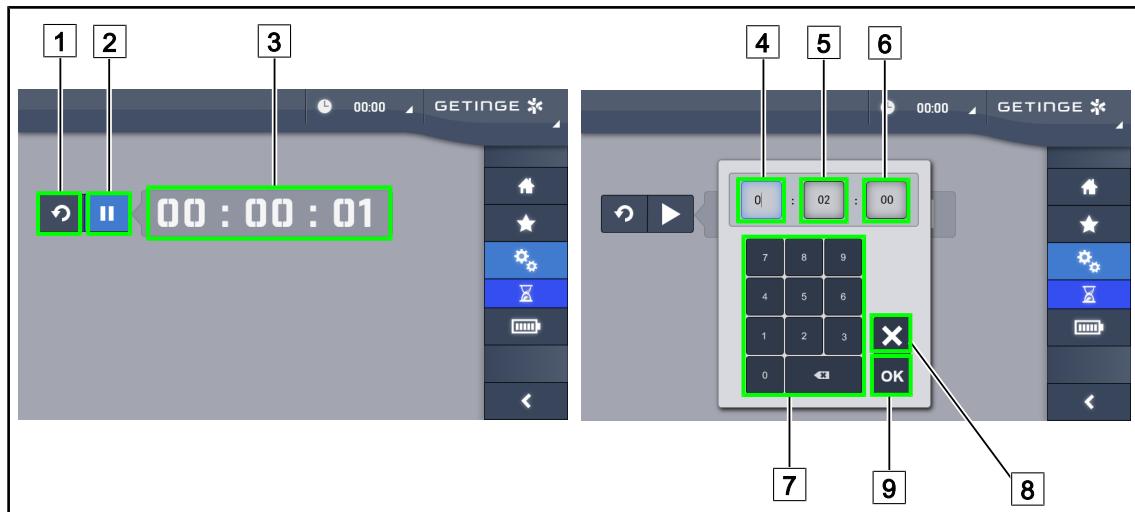

Sl. 116: Stran merilnika časa

Sprožiti/ponastaviti merilnik časa

- Pritisnite na **Zaustavi/zaženi** [2], da sprožite merilnik časa.
➤ Merilnik časa se sproži.
- Pritisnite na **Ponastavi** [1], da nastavite števec na nič.
➤ Merilnik časa se ponastavi na predhodno nastavljeno vrednost.

Zaustaviti/znova zagnati merilnik časa

- Ko se merilnik časa sproži, pritisnite na **Zaustavi/zaženi** [2], da začasno zaustavite merilnik časa.
➤ Števec začne utripati.
- Pritisnite na **Zaustavi/zaženi** [2], da znova zaženete merilnik časa.
➤ Števec preneha utripati in nadaljuje.


**NAPOTEK**

Po preteku nastavljenega časa, števec merilnika časa utripa oranžno.

Nastaviti merilnik časa

- Pritisnite na **Števec merilnika časa** [3].
➤ Odpre se okno za nastavitev merilnika časa (glej zgoraj).
- Izberite polje, ki ga želite nastaviti: **Ure** [4], **Minute** [5] ali **Sekunde** [6].
➤ Izbrano polje se označi modro.
- Vtipkajte vrednost na tipkovnici [7].
- Ko vnesete vrednost pritisnite na **Potrdi** [9], da shranite. Spremembe prekličete tako, da pritisnete na **Prekliči** [8].
➤ Okno za nastavitev merilnika časa se zapre in merilnik časa je pripravljen; sprožil se bo za vneseno vrednost.


4.8.4 Ročica TILT

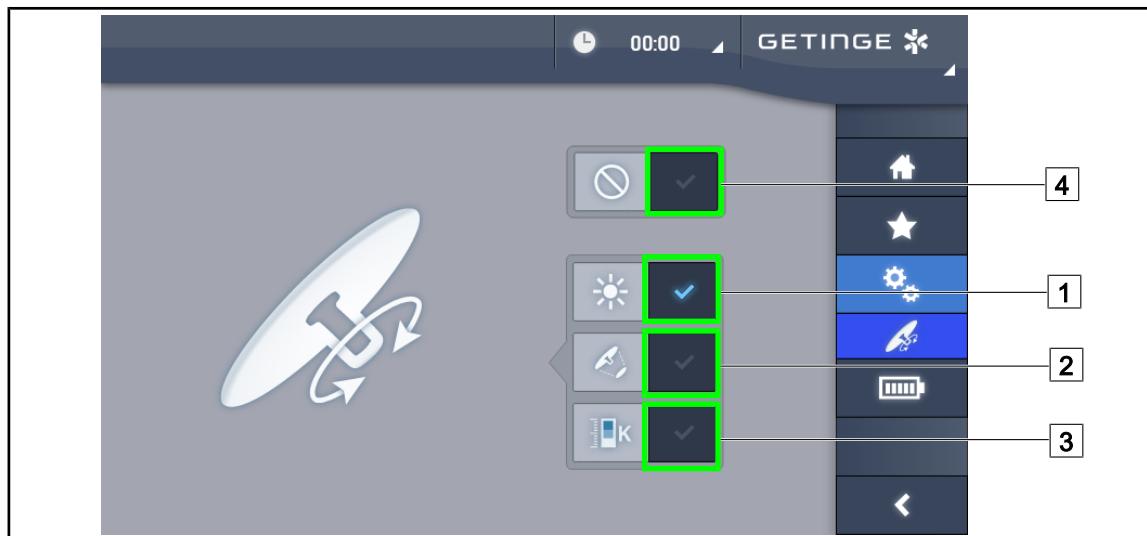

Sl. 117: Nastavitev ročice Tilt

Nastaviti ročico Tilt

- Pritisnite na **Osvetlitev** [1], da ročica Tilt nastavi intenzivnost svetlobe kupole.
- Pritisnite na **Premer snopa** [2], da ročica Tilt nastavi premer svetlobnega snopa kupole.
- Pritisnite na **Barvna temperatura** [3], da ročica Tilt nastavi temperaturo svetlobe kupole ali kupol.
- Pritisnite na **Neaktivno** [4], da izključite ročico Tilt in ne nastavite osvetljenosti.

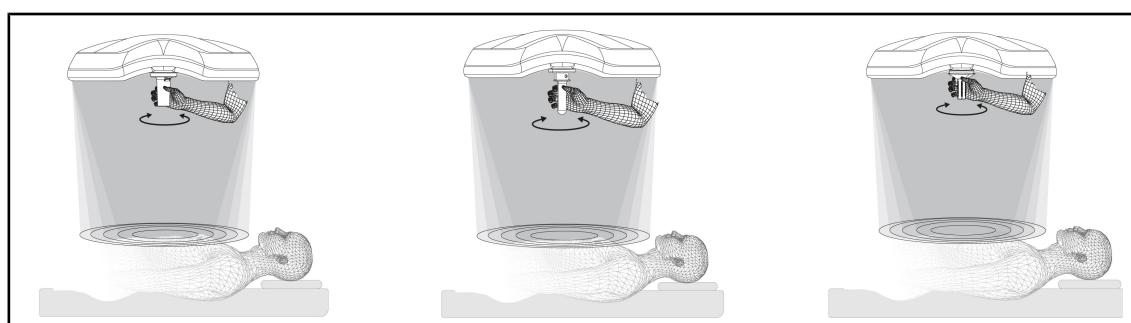

Sl. 118: Sestav ročic TILT

Nastaviti osvetlitev z ročico TILT


- Vrtite ročico, da nastavite intenzivnost svetlobe, premer snopa ali barvno temperaturo izbrane nastavitev.



NAPOTEK

Ročica TILT nima točke zaustavitve.

4.8.5 Informacije

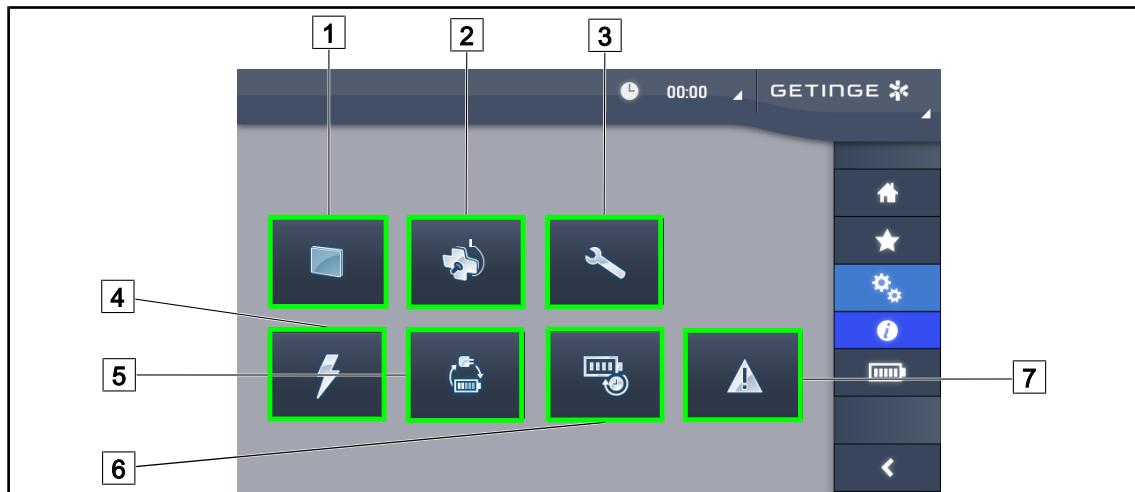

Sl. 119: Stran Informacije

- | | |
|---------------------|---------------------------------|
| [1] Zaslonski dotik | [5] Preklop na varnostni sistem |
| [2] Kupole | [6] Avtonomija baterij |
| [3] Vzdrževanje | [7] Napake |
| [4] Napajanje | |

Št.	Možno dejanje
1	Pritisnite na Zaslonski dotik , da dostopite do različice programja in datuma posodobitve programja, referenčne oznake zaslona na dotik, serijske številke in datuma namestitve.
2	Pritisnite na Kupole , da dostopite do informacij o nameščeni kupoli ali kupolah, in sicer: referenčna oznaka, serijska številka, možnosti, ki so na voljo, in ure obratovanja.
3	Pritisnite na Vzdrževanje , da dostopite do datumov opravljenih vzdrževalnih delih in podatkov o stiku Getinge.
4	Pritisnite na Napajanje , da dostopite do zgodovine izpadov.
5	Pritisnite na Preklop na pomožno napajanje , da dostopite do zgodovine testov preklopa na zunanjji sistem pomožnega napajanja.
6	Pritisnite na Avtonomija baterij , da dostopite do zgodovine testov avtonomije baterij.
7	Pritisnite na Napake , da dostopite do zgodovine napak.

Tab. 17: Meniji informacij

4.9 Pomožne baterije



NAPOTEK

Baterije se polnijo, samo ko je svetilka izključena.

4.9.1 Svetlobni indikatorji

Signalne svetilke	Ime	Pomen
	Oranžna signalna svetilka za baterijo	Preklop na zunanji sistem za pomožno napajanje
	Utripajoča rdeča signalna svetilka	Skorajšnja prekinitev (samo na sistemu za pomožno napajanje Getinge)

Tab. 18: Signalne svetilke delovanja sistema za pomožno napajanje tipkovnice kupole

Signalne svetilke	Ime	Pomen
	1 rdeča LED	Zelo nizka stopnja zunanjega sistema (samo na sistemu za pomožno napajanje Getinge)
	2 rdeči LED svetila	Nizka stopnja zunanjega sistema (samo na sistemu za pomožno napajanje Getinge)
	3 oranžne LED svetilo	Dokaj nizka stopnja zunanjega sistema (samo na sistemu za pomožno napajanje Getinge)
	4 zelene LED svetilo	Dobra stopnja zunanjega sistema (samo na sistemu za pomožno napajanje Getinge)
	5 zelene LED svetilo	Zelo dobra stopnja zunanjega sistema (s sistemom za pomožno napajanje Getinge) ali opreme na sistemu za pomožno napajanje (s sistemom kupca)
	Zelene LED zasvetijo ena za drugo	Način lovilnika: polnjenje baterij v teku (samo na sistemu za pomožno napajanje Getinge)

Tab. 19: Signalne svetilke delovanja sistema za pomožno napajanje stenske tipkovnice

Signalne svetilke	Ime	Pomen
	Oranžna baterija polna	Preklop na zunanji sistem za pomožno napajanje
	Oranžna baterija ni polna	Preostala avtonomija (samo na sistemu za pomožno napajanje Getinge)
	Utripajoča rdeča signalna svetilka	Skorajšnja prekinitev (samo na sistemu za pomožno napajanje Getinge)

Tab. 20: Signalne svetilke za delovanje sistema za pomožno napajanje zaslona na dotik

4.9.2 Opravite teste baterij



OPOZORILO!

Nevarnost poškodb

Test avtonomije baterij popolnoma izprazni baterije.

Po testu avtonomije baterij počakajte nekaj časa, preden nadaljujete z operacijo. Počakajte, dokler se baterije ne napolnijo.

4.9.2.1 Preko stenske upravljalne tipkovnice (samo na VCSII)



Sl. 120: Test baterij preko stenske tipkovnice

Zagnati test samodejnega preklopa na pomožno napajanje

1. Izključite osvetljevanje.
2. Pritisnite na **Test preklopa** [12].
 - Če test uspe, začne utripati zelena signalna svetilka stopnje napolnjenosti baterij [13]. Če test ne uspe, začne utripati rdeča signalna svetilka stopnje napolnjenosti baterij [13].
3. Če test ne uspe, pokličite servis Getinge.
4. Pritiskajte na **Test preklopa** [12], dokler se ta gumb ne izključi.
 - Osvetlitev ostane na ravni 3 in je pripravljena za uporabo.

Zagnati test avtonomije baterij (samo na sistemu pomožnega napajanja Getinge)

1. Izključite osvetljevanje.
2. Pritiskajte na **Test avtonomije** [14], dokler ne zasveti ozadje tipke.
 - Če test uspe, začne utripati zelena signalna svetilka stopnje napolnjenosti baterije [13]. Če test ne uspe, začne utripati rdeča signalna svetilka stopnje napolnjenosti baterij [13].
3. Če test ne uspe, pokličite servis Getinge.
 - Ko je test končan, se osvetljevanje izključi.
4. Pritiskajte na **Test avtonomije** [14], dokler se gumb ne izključi.



NAPOTEK

Test avtonomije lahko kadarkoli prekinete tako, da pritisnete na **Test avtonomije** [14].

4.9.2.2 Z zaslona na dotik



Sl. 121: Test baterij

Zaženi test preklopa na pomožno napajanje

1. Izključi osvetlitev
2. Pritisnite na **Testi baterij** [1] v menijski vrstici.
➤ Odpre se stran za test baterij.
3. Pritisnite na **Test samodejnega preklopa** [2], da zaženete test.
➤ Sistem posodobi datum zadnjega samodejnega preklopa na pomožno napajanje [6], zasveti zeleno okence, če je test uspešen. Nasprotno se pri neuspelem testu označita rdeč križec in tipka **Informacije o vzdrževanju** [4].
4. Če test ne uspe, pritisnite na **Informacije o vzdrževanju** [4], da dostopite do strani Informacij o vzdrževanju, preden pokličite servis Getinge.

Zaženi test avtonomije baterij (samo na sistemu pomožnega napajanja Getinge)

1. Izključi osvetlitev
2. Pritisnite na **Testi baterij** [1] v menijski vrstici.
➤ Odpre se stran za test baterij.
3. Pritisnite na **Test avtonomije** [3], da zaženete test.
➤ Sistem posodobi zadnji test avtonomije baterij [7] in trajanje avtonomije baterij [8]; zasveti zeleno okence, če je test uspešen. Nasprotno se pri neuspelem testu označita rdeč križec in tipka **Informacije o vzdrževanju** [4].
4. Če test ne uspe, pritisnite na **Informacije o vzdrževanju** [4], da dostopite do strani Informacij o vzdrževanju, preden pokličite servis Getinge.



NAPOTEK

Test avtonomije je mogoče kadarkoli prekiniti s pritiskom na rdeči križec [5].

5 Okvare in nepravilnosti v delovanju

5.1 Alarmne signalne svetilke

5.1.1 Signalne svetilke so na tipkovnici kupole in na stenski tipkovnici.

Signalna ikona	Ime	Pomen
	Signalna ikona ugasne.	Ni napake
	Oranžna signalna ikona	Konfiguracija z okvaro (primeri: okvarjena kartica, napaka komunikacije, druge napake); stopnja sistema pomožnega napajanja prenizka.

Tab. 21: Opozorilne signalne svetilke

Signalna ikona	Ime	Pomen
	Signalna ikona ugasne.	Konfiguracija območja
	Oranžna signalna ikona	Konfiguracije zunanje napajalne naprave
	Utrijajoča rdeča signalna ikona (samo s sistemom za pomožno napajanje Getinge)	Konfiguracije zunanje napajalne naprave Baterije so skoraj izpraznjene; v nekaj minutah se konfiguracija lahko izključi.

Tab. 22: Signalne svetilke za baterijo

5.1.2 Signalne oznake na zaslonu na dotik

Signalna ikona	Ime	Pomen
—	Signalna ikona ugasne.	Ni napake
	Opozorilna signalna ikona	Konfiguracija z okvaro

Tab. 23: Opozorilne signalne svetilke

Signalna ikona	Ime	Pomen
—	Signalna ikona ugasne.	Dnevno vzdrževanje
	Signalna ikona za vzdrževanje	Načrtovano letno vzdrževanje

Tab. 24: Vzdrževalne svetilke

5.2 Možne okvare in nepravilnosti

Mehanika

Nepravilnost	Možni vzrok	Popravni ukrep
Sterilizabilna ročica se ne zaskoči pravilno	Prekoračitev parametrov sterilizacije (temperatura, čas)	Preveriti in potrdite, da delujejo pravilno mehanizem zaklepanja (klik) in ročice
	Najdaljša tehnična življenska doba je presežena/ročice je deformirana	Zamenjajte ročico
Odmik kupole	Nepravilna navpičnost nosilne cevi	Preverite navpičnost in strukturo stropa
	Nosilna struktura nestabilna	Pokličite tehnični servis Getinge.
	Zavora ni dobro nastavljena	Zavoro nastavi strokovno usposobljen delavec
S kupolo ni mogoče rokovati; kupole se premika premehko ali pretrdo	Zavora ni dobro nastavljena	Zavoro nastavi strokovno usposobljen delavec
	Ni dovolj podmazano	Pokličite tehnični servis Getinge.

Tab. 25: Okvare in nepravilnosti v mehanskem delovanju

Optika

Nepravilnost	Možni vzrok	Popravni ukrep
Kupola ne zasveti	Prekinitev omrežnega napajanja polja	Preverite, ali se morda napaja v istem omrežju druga naprava
	Ni preklopa na sistem pomožnega napajanja	Pokličite tehnični servis Getinge.
	Drugi vzrok	Pokličite tehnični servis Getinge.
Kupola ne ugasne	Težava s komunikacijo med napajanjem in kupolo	Pokličite tehnični servis Getinge.
Ne svetijo vse kupole	Posamezno kupolo upravlja ločeno stikalo	Preverite in potrdite stanje svetilke, ki sveti na plošči Lexan na posamezni kupoli
Polje svetilk LED ali LED ne zasveti.	Kartica LED ali LED je v okvari	Pokličite tehnični servis Getinge.
	Elektronska kartica ne komunicira s kartico LED	Pokličite tehnični servis Getinge.
Svetilke migetajo	Namestitev ni skladna	Pokličite tehnični servis Getinge.

Tab. 26: Okvare in nepravilnosti v optičnem delovanju

Nepravilnost	Možni vzrok	Popravni ukrep
Način ambientalne osvetljnosti se ne vključi	Tipka je v okvari	Pokličite tehnični servis Getinge.
	Težava s komunikacijo med napajanjem in kupolo	Pokličite tehnični servis Getinge.
Način AIM se ne vključi	Ta funkcija ne obstaja za to kupolo	Preverite in potrdite, da je naveden AIM na etiketi na izdelku
	Tipka je v okvari	Pokličite tehnični servis Getinge.

Tab. 26: Okvare in nepravilnosti v optičnem delovanju

Drugo

Nepravilnost	Možni vzrok	Popravni ukrep
Kupoli hkrati upravlja napaka	Težava s komunikacijo med napajanjem in kupolami	Pokličite tehnični servis Getinge.
Ni slike po vključitve kamere OHDII AIR03 QL FHD	Težava s komunikacijo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Preverite in potrdite, da je vključena kamera na zaslonu na dotik 2. Izključite in ponovno priključite vtič napajalnega kabla za sprejemnik 3. Ponovno uparite kamero 4. Pokličite tehnični servis Getinge.
Slika izgine za več kot 20 sekund	Motnje z drugim sistemom	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem se mora znova inicIALIZIRATI v 20 sekundah 2. Spremeniti stopnjo zuma 3. Pokličite tehnični servis Getinge.

Tab. 27: Druge okvare in nepravilnosti v delovanju

6 Čiščenje/razkuževanje/steriliziranje



OPOZORILO!

Tveganje prenosa okužbe

Postopki čiščenja in steriliziranja so zelo razlikujejo, odvisno od zdravstvene ustanove in lokalnih predpisov.

Uporabnik se je dolžen posvetovati s sanitarnimi strokovnimi delavci v svoji ustanovi. Upoštevajte priporočila v povezavi s postopki in izdelki.

6.1 Čiščenje in razkuževanje sistema



OPOZORILO!

Nevarnost uničenja opreme

Če vdre tekočina med čiščenjem v napravo, lahko naprave začne delovati nepravilno.

Naprave ne spirajte z vodo ali škropite raztopine neposredno na napravo.



OPOZORILO!

Nevarnost okužbe

Določeni izdelki ali postopki čiščenja lahko poškodujejo barvo naprave, da se ta razprši v delce in pade v operativno polje med posegom.

Izdelki za razkuževanje vsebujejo glutaraldehid; ne uporablajte fenola ali joda. Metode parnega razkuževanja niso primerne in zato niso dovoljene.



OPOZORILO!

Nevarnost opeklín

Določeni deli opreme se med uporabo segrejejo.

Pred vsakim čiščenjem se prepričajte, da je naprava izključena in hladna.

Splošna navodila za čiščenje, razkuževanje in varnost

Za standardno uporabo velja nizka raven čiščenja in razkuževanja pripomočka. Pripomoček je razvrščen v razred nekritičnih pripomočkov z nizko ravnjo nevarnosti okužbe. Vseeno je raven razkuževanja odvisna od tveganja za okužbo: srednje do visoko.

Pristojni organ je dolžen spremljati in upoštevati lokalne predpise (standarde in direktive) o higiени in razkuževanju.

6.1.1 Čiščenje naprave

- Odstranite sterilizabilno ročico.
- Opromo čistite s krpo, namočeno v čistilo za površine, in pri tem upoštevajte proizvajalčeva priporočila za pripravo raztopine, trajanje nanosa in temperaturo. Čistite z univerzalnim čistilom, blago alkalnim (milnica), ki vsebuje osnovne učinkovine, kot so detergenti in fosfati. Ne čistite z abrazijskimi izdelki, saj lahko s takšnimi izdelki poškodujete površine.
- Z vlažno krpo odstranite čistilo in s suho krpo obrišite do suhega.

6.1.2 Razkuževanje naprave

S krpou, namočeno z razkužilno raztopino, enakomerno nanesite razkužilo na napravo in upoštevajte navodila proizvajalca.

6.1.2.1 Razkužila, ki jih lahko uporabite

- Razkužila niso tudi sterilizacijska sredstva. Kvalitativno in kvantitativno zmanjšajo obstoječe mikroorganizme.
- Uporabljajte le površinska razkužila, ki vsebujejo kombinacijo aktivnih snovi:
 - kvaterne amonijeve spojine (bakteriostatične na gram – in bakteriocid na gram +, različne aktivne snovi na virus z ovojnico, nič na virus, fungistatično, ni sporicidne učinkovine)
 - derivati gvanidina
 - alkoholi

6.1.2.2 Dovoljene aktivne snovi

Razred	Aktivne snovi
Nizka raven razkuževanja	
kvaterne amonijeve spojine	<ul style="list-style-type: none"> ▪ didecildimetilamonijev klorid ▪ alkil-benzil-demetilamonijev klorid ▪ dioktildimtilamonijev klorid
bigvanidi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ hidroklorid poliheksameten bigvanid
Srednja raven razkuževanja	
Alkoholi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PROPAN-2-OL
Visoka raven razkuževanja	
Kislinae	<ul style="list-style-type: none"> ▪ sulfaminska kislina (5 %) ▪ jabolčna kislina (10 %) ▪ etilendiamintetra ocetna kislina (2,5 %)

Tab. 28: Seznam aktivnih snovi, ki jih je dovoljeno uporabiti

Primeri izdelkov, preizkušenih za komercialno uporabo

- Pripravek ANIOS®** : Surfa'Safe®**
- Drugi pripravki: izopropilni alkohol 20 do 45 %

6.2 Čiščenje in steriliziranje ročic Maquet Sterigrip

6.2.1 Priprava za čiščenje

Po končani uporabi, ročice namočite v čistilo-razkužilo, ki ne vsebuje aldehida, da se umazanija ne sprime.

6.2.2 Ročno čiščenje

1. Ročice potopite v raztopino detergenta¹ za 15 minut.
2. Očistite z mehko krtačo in krpo, ki ne pušča kosmov.
3. Preglejte ročice, če so čiste in niso onesnažene. V nasprotnem primeru opravite postopek čiščenja z ultrazvokom.
4. Dobro sperite s čisto vodo, tako da popolnoma odstranite sledi raztopine detergenta.
5. Pustite ročico na zraku, da se posuši, ali jo obrišite s krpo.

6.2.3 Čiščenje v pralno razkuževalni napravi

Ročice lahko čistite v pralno razkuževalni napravi in sperete na temperaturi maks. 93 °C. Primer priporočenih ciklusov:

Raven	Temperatura	Trajanje
Predpranje	18–35 °C	60 s
Pranje	46–50 °C	5 min
Nevtraliziranje	41–43 °C	30 s
Pranje 2	24–28 °C	30 s
Spiranje	92–93 °C	10 min
Sušenje	na zraku	20 min

Tab. 29: Primeri ciklusov čiščenje v pralno razkuževalni napravi

¹ Priporočamo, da uporabite čistilno sredstvo, ki ni encimsko. Encimska čistila lahko poškodujejo material. Teh čistil ne uporablajte za daljše namakanje in jih temeljito sperite.

6.2.4 Sterilizacija ročic Maquet Sterigrip



OPOZORILO!

Nevarnost okužbe:

Sterilizabilna ročica po priporočenem številu ciklov sterilizacije lahko pade z nosilca.

Z določenimi nastavtvami sterilizacije velja jamstvo za sterilizabilne ročice STG PSX do 50 uporab in za ročice STG HLX do 350 uporab. Upoštevajte priporočeno število ciklusov.



NAPOTEK

Sterilizabilne ročice Maquet Sterigrip sterilizirate v avtoklavu.

1. Ročico preglejte, če je onesnažena ali razpokana.
 - Če je ročica onesnažena, ponovite ciklus čiščenja.
 - Če je na ročici ena ali več razpok, ročica ni uporabna in jo je treba zavreči po veljavnih protokolih.
2. Ročice položite na pladenj sterilizatorja na enega od naslednjih načinov:
 - Ovito v embalažo za steriliziranje (dvojna embalaža ali enakovredno).
 - Ovito v vrečo za steriliziranje iz papirja ali plastike.
 - Brez embalaže in brez vreče, gumb za zaklepanje na dol.
3. Nastavite biološke in/ali kemične kazalnike, ki omogočajo nadzor postopka sterilizacije v skladu z veljavnimi predpisi.
4. Cikel sterilizacije zaženite po navodilih proizvajalca sterilizatorja.

Ciklus steriliziranja	Temperatura (°C)	Trajanje (min)	Sušenje (min)
ATNC (Prion) Predvakuum	134	18	–

Tab. 30: Primer ciklusa steriliziranja s paro

7

Vzdrževanje

Za pravilno in zanesljivo delovanje svetilk enkrat na leto opravite redno vzdrževanje in servis opreme. V garancijskem obdobju mora opremo vzdrževati in servisirati serviser Getinge ali serviser, ki ga odobri Getinge. Po izteku tega obdobja lahko opremo vzdržuje in servisira serviser Getinge, pooblaščeni zastopnik Getinge ali bolnišnični serviser, ki se ustreznou sposobi pri Getinge. Za ustrezen tehnično usposabljanje se obrnite na prodajalca.

Preventivno vzdrževanje	Izvesti vsako leto
-------------------------	--------------------

Določene sestavne dele je treba zamenjati v tehničnem življenju pripomočka; za časovni načrt zamenjav glejte navodila za vzdrževanje. V navodilu za vzdrževanje so določeni redni pregledi električnih, mehanskih in optičnih delov ter potrošni deli, ki jih je treba redno menjati, da kirurške svetilke deluje zanesljivo in varno.



NAPOTEK

Navodilo za vzdrževanje dobite pri lokalnemu zastopniku Getinge. Podatke o stiku lokalnega zastopnika Getinge najdete na:

<https://www.getinge.com/int/contact/find-your-local-office>.

8 Tehnične lastnosti

8.1 Optične lastnosti kupol VSTII



NAPOTEK

Meritve, izvedene po standardu, na majhnem snopu in na 4500 K pri kupolah s spremenljivo barvno temperaturo.

Lastnosti	Kupola VSTII 600 in 400	Dovoljeno odstopanje
Osvetljenost	Od 10 000 lx do 160 000 lx	—
Imenska osvetljenost (stopnja 5)	130 000 lx	±10 %
Osvetljenost z načinom povečanja „boost“ (stopnja 6)	160 000 lx	0/-10 %
Premer d10	20–25 cm	±15 %
Premer d50/d10	0,55	± 0,05
Globina osvetlitve L1+L2 pri 60 %	50 cm	±10 %
Barvna temperatura ²	Stalna: 3900 K Spremenljiva: 3900 K / 4500 K / 5100 K	± 400 K
Indeks barvnega videza (Ra)	95	± 5
Oznaka določenega opravila (R9)	90	+10/-20
Oznaka določenega opravila (R15)	95	± 5
Sevalna energija	3,3 mW/m ² /lx	± 0,5
Obsevanje (Ee) ³	<500 W/m ²	—
UV svetloba	≤0,7 W/m ²	—
Sistem FSP	Da	—
Osvetljenost v prostorskem načinu	<500 lx	—

Tab. 31: Podatki o optiki kupol VSTII po standardu EN 60601-2-41

Preostala osvetlitev	VSTII 600	VSTII 400	Dovoljeno odstopanje
Pri eni maski	55 %	40 %	± 10
Pri dveh maskah	50 %	45 %	± 10
Na dnu cevi	100 %		± 10
Pri eni maski, na dnu cevi	55 %	40 %	± 10
Pri dveh maskah, na dnu cevi	50 %	45 %	± 10

Tab. 32: Preostala osvetlitev kupol Volista po standardu EN 60601-2-41

² 5300 K pri vkl. možnosti VisioNIR.

³ V nominalnem načinu

Lastnosti	VSTII 600	Dovoljeno odstopanje	Predstavitev
Imenska osvetljenost Ec (AIM vključen)	130 000 lx	±10 %	
Izenačevanje senc pri dveh maskah	86 %	± 10	
Izenačevanje senc pri dveh maskah	58 %	± 10	

Tab. 33: Lastnosti načina AIM na VSTII 600

Lastnosti	VSTII 400	Dovoljeno odstopanje	Predstavitev
Imenska osvetljenost Ec (AIM vključen)	130 000 lx	±10 %	
Izenačevanje senc pri dveh maskah	77 %	± 10	
Izenačevanje senc pri dveh maskah	50 %	± 10	

Tab. 34: Lastnosti načina AIM na VSTII 400

**NAPOTEK**

R9 velja samo za zunanji del spektra, večji od 650 nm, na katerem je občutljivost očesa zmanjšana. Zato od vrednosti 50 točk kirurg nima učinka na razlikovanje barv. Povečanje R9 spremišča povečanje radiana.

Obsevanje v polju fluorescenčnega slikanja v območju bližnje infrardeče svetilke

	VSTII Način imensko	VSTII Način VisionNIR
Obsevanje v območju 710–800 nm	≤35 W/m ²	≤1,25 W/m ²
Obsevanje v območju 800–870 nm	≤2,1 W/m ²	≤0,03 W/m ²

Tab. 35: Obsevanje v območju bližnje infrardeče svetilke

8.2

Optične lastnosti kopol VCSII

Lastnosti	Kupole VCSII 600 in 400	Dovoljeno odstopanje
Osvetljenost	Od 10 000 lx do 160 000 lx	—
Imenska osvetljenost (stopnja 5)	130.000 lx	± 10 %
Osvetljenost z načinom povečanja „boost“ (stopnja 6)	160.000 lx	0/-10 %
Premer d10	20–25 cm	±15 %
Premer d50/d10	0,55	±0,05
Globina osvetljenosti L1+L2 pri 60 % ⁴	52 cm	± 10 %
Barvna temperatura	Stalna: 4200 K Spremenljiva: 3900 K/4200 K/4500 K	± 400 K
Indeks barvnega videza (Ra)	95	±5
Oznaka določenega opravila (R9)	90	+10 /-20
Oznaka določenega opravila (R15)	95	±5
Sevalna energija	3,3 mW/m ² /lx	± 0,5
Sevalna svetilka (Ee) ⁵	<500 W/m ²	—
UV svetloba	≤ 0,7 W/m ²	—
Sistem FSP	Da	—
Osvetljenost v prostorskem načinu	<500 lx	—

Tab. 36: Optični podatki kopol Volista VCSII po standardu EN 60601-2-41

Preostala osvetljenost	VCSII 600	VCSII 400	Dovoljeno odstopanje
V prisotnosti ene maske ⁴	60 %	55 %	±10
V prisotnosti dveh mask ⁴	50 %	45 %	±10
Na dnu cevi ⁴	100 %		±10
V prisotnosti ene maske, na dnu cevi ⁴	60 %	55 %	±10
V prisotnosti dveh mask, na dnu cevi ⁴	50 %	45 %	±10

Tab. 37: Preostala osvetljenost s kopol Volista po standardu EN 60601-2-41

⁴ Izmerjeno na 4200 K na majhnem snopu

⁵ V imenskem načinu

8.3 Električne lastnosti

8.3.1 Električne lastnosti VSTII

Električne lastnosti	VSTII 400	VSTII 600
Vhodna napetost WPS	100–240 V AC, 50/60 Hz	
Vhodna napetost WPSXXX24	24 VAC, 50/60 Hz, 24 VDC	
Moč	Enostavna konfiguracija: 200 VA Dvojna konfiguracija: 400 VA	
Poraba kupole	65 W	90 W
Vhod kupole	20–28 V DC	
Povprečna življenska doba LED	60 000 ur po standardu TM-21:2012 55 000 ur po standardu TM-21:2016	
Čas napajanja baterij	14 ur (komplet 3H)/7 ur (komplet 1H)	

Tab. 38: Preglednica električnih lastnosti napajanja WPS

Električna združljivost z drugimi pripomočki

Združljivi električni pripomočki	Združljivost
Zunanja naprava za upravljanje	RS232 (samo na WPS z možnostjo RS232)
Vodenje zunanjih informacij	Suhi stik

Tab. 39: Preglednica električne združljivosti

8.3.2 Električne lastnosti VCSII

Električne lastnosti	VCSII 400	VCSII 600
Vhodna napetost WPS	100–240 V AC, 50/60 Hz	
Vhodna napetost WPSXXX24	24 VAC, 50/60 Hz, 24 VDC	
Moč	Enostavna konfiguracija: 200 VA Dvojna konfiguracija: 400 VA	
Poraba kupole	70 W	70 W
Vhod kupole	20–28 V DC	
Povprečna življenska doba LED	60 000 ur po standardu TM-21:2012 55 000 ur po standardu TM-21:2016	
Čas napajanja baterij	14 ur (komplet 3H)/7 ur (komplet 1H)	

Tab. 40: Preglednica električnih lastnosti napajanja WPS

Električne lastnosti	VCSII 400	VCSII 600
Vhodna napetost EPS	100–240 V AC, 50/60 Hz	
Vhodna napetost EPSXXX24	24 VAC, 50/60 Hz, 24 VDC	
Moč	Enostavna konfiguracija: 110 VA Dvojna konfiguracija: 220 VA	
Poraba kupole	70 W	70 W
Vhod kupole	20–28 V DC	
Povprečna življenska doba LED	60 000 ur po standardu TM-21:2012 55 000 ur po standardu TM-21:2016	
Čas napajanja baterij	14 ur (komplet 3H)/5 ur (komplet 1H)	

Tab. 41: Preglednica električnih lastnosti napajanja EPS

Električna združljivost z drugimi pripomočki

Združljivi električni pripomočki	Združljivost
Zunanja naprava za upravljanje	RS232 (samo na WPS z možnostjo RS232)
Vodenje zunanjih informacij	Suhi stik

Tab. 42: Preglednica električne združljivosti

8.4 Mehanske lastnosti

8.4.1 Svetilke

Za Volista VSTII

Lastnosti	VOLISTA VSTII 600	VOLISTA VSTII 400
Masa dvojne kupole na vilicah	15,5 kg	14,5 kg
Masa enojne kupole na vilicah	14 kg	13 kg
Premer kupole	700 mm	630 mm

Tab. 43: Mehanske lastnosti svetilke VSTII

Za Volista VCSII

Lastnosti	VOLISTA VCSII 600	VOLISTA VCSII 400
Masa dvojne kupole na vilicah	15,5 kg	13,5 kg
Masa enojne kupole na vilicah	13,5 kg	11,5 kg
Premer kupole	700 mm	630 mm

Tab. 44: Mehanske lastnosti svetilke VCSII

Mehanska združljivost svetilke

Pripomoček	Združljivost
Ročica ali navojni nosilec ročice	DEVON®/DEROYAL®

Tab. 45: Mehanska združljivost svetilke

8.4.2 Moč

Lastnosti	VOLISTA 600 in 400
Mere ohišja WPS Power Supply (v x d x š)	311 x 400 x 145 mm
Mere ohišja WPS Battery Pack (v x d x š)	311 x 400 x 145 mm
Masa ohišja WPS Power Supply	6,1 kg
Masa ohišja WPS Battery Pack	21,1 kg

Tab. 46: Mehanske lastnosti napajanja WPS

Lastnosti	VOLISTA 600 in 400
Mere ohišja EPS stensko (v x d x š)	310 x 400 x 145 mm
Mere ohišja Battery Pack (EPS MB) (v x d x š)	310 x 400 x 145 mm
Masa EPS 10	3,5 kg
Masa EPS 20	4 kg
Masa Battery Pack 3H – 240 V (EPS MB3) (z baterijami)	20 kg

Tab. 47: Mehanske lastnosti napajanja EPS

8.4.3 Podpora zaslona(-ov)

Nosilec zaslona	Nosilnost podstavka	Največje dovoljene velikosti zaslona
FHS019	19 kg	809 × 518 mm (32")
MHS019	19 kg	
XHS016	16 kg	
XHS021	21 kg	
XHD127	27 kg	

Tab. 48: Mehanske lastnosti nosilcev zaslona

8.4.4 Mehanska združljivost

Pripomoček	Združljivost
Kamera za SC05	Kamera z navojem 1/4", ki tehta manj kot 5 kg
Zaslon za nosilec zaslona	Vmesnik VESA

Tab. 49: Seznam združljivih pripomočkov

8.5 Videolastnosti

8.5.1 Tehnične lastnosti kamer in sprejemnikov

Tehnične lastnosti kamere

Lastnosti	OHDII FHD QL VP01	OHDII FHD QL AIR03 E/U
Senzor	1/3" Cmos	
Število pikslov	~2,48 megapikslov	
Standardni video	1080i	1080p
Frekvenca osveževanja slike	50 / 60 Hz	
Format	16:9	
Hitrost zaklopa	1/30 do 1/30.000 s	
Kot širokega vidnega polja (diagonalno)	68°	
Kot gledanja tel. (diagonalno)	6,7°	
Signal/hrup	>50 dB	
Optični zoom (glede na fokus)	× 10	
Digitalni zoom	× 6	
Zoom skupaj	× 60	
Fokalno (širokokotni do oddaljeni)	f = 5,1 do 51 mm	
Vidno polje (šxv) na 1 m pod obrazom (širokokotni do oddaljeni)	865 × 530 mm do 20 × 12 mm	
Filter proti utripanju in bleščanju („Antiflicker“)	Da	
Aktivni gradnik („Focus“) ⁶	Avtom. / Fokus zmrzne („freeze“)	
Ravnovesje beline ⁶	Avtom. / Notranjost / Zunanjost / Ročno	
Izboljšanje beline ⁶	Da (3 stopnje)	
„Freeze“ (zmrzni sliko) ⁶	Da	
Prednastavi ⁶	6	
Tip prenosa	Ožičeno	Brez žice
Vmesnik RS32	Da	
Teža brez sterilne ročice	820 g	790 g
Mere brez sterilne ročice (Ø × v)	129 × 167 mm	132 × 198 mm

Tab. 50: Tehnične lastnosti kamere

⁶ samo preko zaslona na dotik

Tehnične lastnosti SPREJEMNIK VP01

Lastnosti	SPREJEMNIK VP01
Videovhod	RJ45 (lastnik)
Videoizhod	3G-SDI
Teža (brez/s podstavkom)	230 g/260 g
Mere s podstavkom (d × š × v)	143 × 93 × 32 mm

Tab. 51: Tehnične lastnosti SPREJEMNIK VP01

Tehnične lastnosti SISTEMA AIR03 E/U

Lastnosti	SISTEM AIR03 E/U
Videoizhod	HDMI 1,4
Teža (brez/s podstavkom)	220 g / 340 g
Mere s podstavkom (d × š × v)	156 × 117 × 61 mm
Frekvenca prenosa	glejte v nadaljevanju

Tab. 52: Tehnične lastnosti SISTEMA AIR03 E/U

Frekvence prenosa AIR03 SYSTEM E/U:

Območje EU: Centralna frekvenca kanalov je v skladu s standardom ETSI EN 301 893: 5,190 GHz in 5,230 GHz
Območje ZDA: Centralna frekvenca kanalov je v skladu z določilom čl. 15.407 standarda FCC: 5,190 GHz, 5,230 GHz, 5,755 GHz in 5,795 GHz**Radijska združljivosti pripomočka**

Pripomoček	Ime	Dobavitelj
Brezžični sistem za videoprenos HDMI	EXT-WHD-1080P-SR	GEFEN**

**NAPOTEK**

Tehnične lastnosti brezžičnega sistema AIR03 so opisane v dokumentih na spletišču proizvajalca GEFEN.

8.6**Druge lastnosti**

Zaščita pred električnim udarom	Razred I
Razvrstitev medicinskih pripomočkov Evropa, Kanada, Koreja, Japonska, Brazilija in Avstralija	Razred I
Razvrstitev medicinskih pripomočkov ZDA, Kitajska in Tajvan	Razred II
Raven zaščite celotne naprave	IP 20
Raven zaščite kupol	IP 44
Koda EMDN	Z12010701
Koda GMDN	12 282
Leto oznake CE	2013

Tab. 53: Normativne in predpisane lastnosti

8.7 Izjava o elektromagnetni združljivosti



Pozor!

Nevarnost nepravilnega delovanja naprave

Če uporabljate to opremo skupaj z drugimi napravami, lahko to negativno vpliva na delovanje in delovne učinke opreme.

Ne uporabljajte opreme v bližini drugih naprav in ne zložite opreme med druge naprave, ne da bi najprej preverili, če oprema in druge naprave normalno delujejo.



Pozor!

Nevarnost nepravilnega delovanja naprave

Če uporabljate prenosno RF komunikacijsko napravo (tudi antenske kable in zunanje antene) v bližini naprave ali določenih kablov, to lahko negativno vpliva na delovanje in rezultate opreme.

Prenosno RF komunikacijsko opremo uporabljajte najmanj 30 cm stran od naprave.



Pozor!

Nevarnost nepravilnega delovanja naprave

Če uporabljate visokofrekvenčni generator (npr. elektrokavter) v bližini naprave, to lahko negativno vpliva na delovanje in rezultate opreme.

Če oprema neprekinjeno deluje nepravilno, prestavljajte kupole, dokler motnje ne prenehajo.



Pozor!

Nevarnost uničenja opreme

Če uporabite to opremo v neprimerenem okolju, lahko to negativno vpliva na delovanje in delovne učinke opreme.

Opremo uporabljajte samo v zdravstvenih ustanovah.



Pozor!

Nevarnost nepravilnega delovanja pripomočka

Zaradi uporabe dodatne opreme ali kablov, ki jih ne dobavi ali odobri proizvajalec, se lahko povečajo elektromagnetne emisije ali zmanjša odpornost in ustvari nevarnost nepravilnega delovanja pripomočka.

Uporabljaljajte samo dodatno opremo in kable, ki jih dobavi ali odobri proizvajalec.



Napotek

Zaradi elektromagnetnih motenj lahko oprema preneha svetiti začasno ali nekaj časa utripa. Oprema ponastavi normalne nastavitev, ko motnje izginejo.

Tip testa	Metoda testa	Frekvenčno območje	Mejne vrednosti
Prevod emisij na glavnih vratih	EN 55011 GR1 CL A ⁷	0,15–0,5 MHz	66 dBµV–56 dBµV QP 56 dBµV–46 dBµV A
		0,5–5 MHz	56 dBµV QP 46 dBµV A
		5–30 MHz	60 dBµV QP 50 dBµV A
Elektromagnetno polje	EN 55011 GR1 CL A ⁷	30–230 MHz	40 dBµV/m QP 10 m
		230–1000 MHz	47 dBµV/m QP 10 m

Tab. 54: Izjava o elektromagnetni združljivosti

Tip testa	Metoda testa	Raven testa: zdravstveno okolje
Imunost proti elektrostaticični razelektritvi	EN 61000-4-2	Stik: ±8 kV Zrak: ± 2; 4; 8; 15 kV
Imunost proti RF elektromagnethetnem polju	EN 61000-4-3	80 MHz 2,7 GHz 3 V/m mod AM 80 %/1 kHz
		Frekvence RF brezščično 9 do 28 V/m Mod AM 80 %/1 kHz
Imunost proti hitrim električnim prehodom/razpokom	EN 61000-4-4	AC: ± 2 kV–100 kHz IO >3 m: ± 1 kV–100 kHz
Imunost proti prenapetosti na napajanju	EN 61000-4-5	± 0,5; 1 kV Dif. ± 0,5 kV, ± 1 kV, ± 2 kV normalni način
Imunost proti prevodnim motnjam zaradi elektromagnetnega polja	EN 61000-4-6	150 kHz 80 MHz 3 Veff Mod AM 80 %/1 kHz
		ISM 6 Veff Mod AM 80 %/1 kHz
Imunost proti izpadu napetosti in kraši prekinitvi	EN 61000-4-11	0 % Ut, 10 ms (0°; 45°; 90°; 135°; 180°; 225°; 270°; 315°) 0% Ut, 20 ms 70% Ut, 500 ms 0 % Ut, 5 s

Tab. 55: Izjava o elektromagnetni združljivosti

8.7.1 FCC DEL 15 (Ie za ZDA)

Ta material je bil preizkušen in rezultati preizkusa so pokazali, da izpolnjuje zahteve v zvezi z omejitvami, ki veljajo za digitalne merilne naprave razreda A, 15. del pravil FCC. Te omejitve so zasnovane, da nudijo razumno zaščito pred škodljivimi motnjami, če napravo uporabljate v komercialnem okolju. Ta naprava oddaja, uporablja in lahko seva energijo radijskih frekvenc, in če je ne uporabljate po navodilih priročnika o namestitvi in uporabi, lahko povzroči škodljive motnje na sistemih radijske komunikacije. Ta naprava lahko v stanovanjskih okoljih povzroči škodljive motnje; v tem primeru uporabnik odpravi motnje na lastne stroške.

⁷ Zaradi svojih emisijskih značilnosti je ta naprava primerena za uporabo v industrijskem in bolnišničnem okolju (razred A po CISPR 11). Če jo uporabite v stanovanjskem območju (za kar je praviloma primeren razred B po CISPR 11), ta enota ne zagotovi zadostne zaščite pred RF komunikacijskimi storitvami. V določeni situacijah je treba izvesti popravljalne ukrepe: prestaviti opremo ali jo preusmeriti.

9 Ravnanje z odpadki

9.1 Odlaganje embalaže

Embalažo naprave je treba zavreči okolju prijazno, reciklirati.

9.2 Izdelek

Te opreme ni dovoljeno zavreči med gospodinjske odpadke. Odpadke ločeno zavrzite za poznejsko obdelavo, ponovno uporabo ali recikliranje.

Za vse informacije o odlaganju izrabljene naprave glejte navodilo za demontažo Volista (ARD01785). Ta dokument dobite pri lokalnem zastopniku Getinge.

9.3 Električni in elektronski sestavni deli

Vse električne in elektronske sestavne dele, ki jih izdelek uporabi v času svoje tehnične življenjske dobe, je treba zavreči okolju prijazno v skladu z veljavnimi lokalnimi standardi.

Zapiski

* VOLISTA, Volista VisioNIR, STANDOP, AIM, LMD, FSP, SATELITE, MAQUET, GETINGE in GETINGE GROUP so registrirane znamke ali znamke v lasti Getinge AB, njenih enot ali podružnic.

**DEVON je registrirana znamka ali znamka v lasti družbe Covidien LP, njenih enot ali podružnic.

**DEROYAL je registrirana znamka ali znamka v lasti družbi Covidien LP, njenih enot ali podružnic.

**SURFA'SAFE je registrirana znamka ali znamka v lasti družbe Laboratoires ANIOS, njenih enot ali podružnic.

**ANIOS je registrirana znamka ali znamka v lasti družbe Laboratoires ANIOS, njenih enot ali podružnic.

** GEFEN je registrirana znamka ali znamka v lasti družbe NORTEK SECURITY & CONTROL LLC, njenih enot ali podružnic.

